



ACTA DE REPREGUNTAS Y CIERRE DE LA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-T-66-2024, SALA DE HEMODINAMIA 2024 EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA, (BIENES DE INVERSIÓN) EJERCICIO 2024; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN II, 29 FRACCIÓN III, 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

En el Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, siendo las **15:00** horas del día **22 de mayo de 2024**, se reúne en el aula de usos múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat número 327, código postal 71230 en el Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; el servidor público representante del área contratante, el que suscribe y firma, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como a lo establecido en el punto **4** de la Convocatoria antes mencionada.

En uso de la palabra el **Lic. Ernesto Antonio Hooper Arvizu, Jefe del Departamento Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios**, quien es autoridad competente para presidir el presente acto, de conformidad con los Artículos 134 párrafos 6 y 7 Constitucional, 9 y 37 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación al Artículo 3 Fracción II del Reglamento de la referida Ley, Artículo 8 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en correlación con el numeral 5.3.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y quien preside este evento, dio la bienvenida e hizo la presentación de los servidores públicos, declarando formalmente iniciado el mismo.

Se comunica a los interesados que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero y cuyas **REPREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO A MÁS TARDAR A LAS 15:00 HORAS DEL PRESENTE**, se darán por recibidas caso contrario se procederá a su desechamiento.

Quien preside el acto, fue asistido por el servidor público facultado como representante del Área Técnica de la presente convocatoria.

Una vez efectuado lo anterior, se procedió a apertura de la bóveda de CompraNet a fin de verificar el envío y en su caso la recepción de preguntas presentadas por este medio de comunicación electrónica; **CONSTATÁNDOSE EXISTENCIA DE REPREGUNTAS POR ESTE MEDIO**, formando parte de esta acta el reporte emitido por dicho sistema y que forma parte de esta acta.



ACTA DE REPREGUNTAS Y CIERRE DE LA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-T-66-2024, SALA DE HEMODINAMIA 2024 EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA, (BIENES DE INVERSIÓN) EJERCICIO 2024; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN II, 29 FRACCIÓN III, 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

cedimiento LA-50-GYR-050GYR013-T-66-2024

go del expediente	Número de procedimiento de contratación ?	Estatus del procedimiento de contratación ?
024-00046606	LA-50-GYR-050GYR013-T-66-2024	EN ACLARACIONES
go interno del procedimiento	Nombre del procedimiento de contratación	
024-00044388	LA-50-GYR-050GYR013-T-66-2024 EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA 2024	

ntes que han presentado proposición:

atos Generales Requerimientos **Solicitudes de aclaración** Proposiciones Evaluación Fallo Datos relevantes del contrato Bitacora de acciones

untas de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones *	Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de CompraNet *	Fecha y hora de repreguntas *
21/05/2024 08:30	20/05/2024 08:30	22/05/2024 15:00

Empresas que han manifestado interés en participar

Q BUSCAR

Exportar listado

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
1	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	17/05/2024 12:31	17/05/2024 13:02			
2	ARELI MIREYA RUIZ DUARTE	18/05/2024 18:40	18/05/2024 22:26			
3	AUG SA DE CV	18/05/2024 21:17	19/05/2024 17:18			
4	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	17/05/2024 12:54	17/05/2024 12:55			
5	BROKER MEDICAL SA DE CV	17/05/2024 17:44	17/05/2024 17:46			
6	CONDUIT LIFE SA DE CV	21/05/2024 09:49	22/05/2024 11:57			
7	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	17/05/2024 20:19	17/05/2024 20:19			



ACTA DE REPREGUNTAS Y CIERRE DE LA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-T-66-2024, SALA DE HEMODINAMIA 2024 EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA, (BIENES DE INVERSIÓN) EJERCICIO 2024; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN II, 29 FRACCIÓN III, 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
8	DEWIMED SA	17/05/2024 20:10	17/05/2024 20:10			
9	DISPOSITIVOS Y TECNOLOGIA MEDICA S DE RL DE CV	17/05/2024 11:21	17/05/2024 16:27			
10	FRANCISCO ALEJANDRO ARIAS HERNANDEZ	18/05/2024 21:11				
11	GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE SA DE CV	21/05/2024 16:06				
12	GRUPO FAYX SA DE CV	17/05/2024 08:46	17/05/2024 08:47			
13	GRUPO INSOMA S A P I DE CV	20/05/2024 14:34				
14	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	17/05/2024 10:42	17/05/2024 10:43			
15	INDUSTRIAS RODA MOBILIARIO SAS DE CV	21/05/2024 11:53				
16	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV	19/05/2024 22:59	20/05/2024 07:28			
17	MERSY CORP SA DE CV	21/05/2024 11:52				
18	MINARIC SA DE CV	17/05/2024 17:03	17/05/2024 17:08			
19	NOVATEC MEDICAL SA DE CV	17/05/2024 15:02				
20	QUANTUM MEDICAL GROUP SA DE CV	17/05/2024 11:43	17/05/2024 11:50			
21	SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV	20/05/2024 09:44				
22	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	17/05/2024 15:46	17/05/2024 15:46			
23	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	17/05/2024 14:48	17/05/2024 14:49			
24	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	17/05/2024 15:25	17/05/2024 15:26			



ACTA DE REPREGUNTAS Y CIERRE DE LA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-T-66-2024, SALA DE HEMODINAMIA 2024 EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA, (BIENES DE INVERSIÓN) EJERCICIO 2024; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN II, 29 FRACCIÓN III, 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
25	VITER MEDICAL SA DE CV	17/05/2024 08:00	17/05/2024 09:54			
26	ZENTILIA LAB S A P I DE CV	20/05/2024 21:30	20/05/2024 21:31			

<< < 1 > >>

100 ▾

← Regresar

Solicitudes de aclaración

ACLARACIONES GENERALES

La convocante con fundamento en el artículo 33 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, realiza las siguientes precisiones a las bases de la Convocatoria.

ESTA CONVOCANTE EFECTUARA LAS SIGUIENTES PRECISIONES

ANEXO 1 “B” CEDULAS
“CEDULA DE ESPECIFICACIONES ÉCNICAS”.
Partida 5.- ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR.;
CLAVE SAI: 531.055.0024.03.01. PREI: 21452



ACTA DE REPREGUNTAS Y CIERRE DE LA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-T-66-2024, SALA DE HEMODINAMIA 2024 EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA, (BIENES DE INVERSIÓN) EJERCICIO 2024; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN II, 29 FRACCIÓN III, 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

DICE:

...


DEBE DECIR:

...

Se anexan planos de la sala de hemodinamia en PDF e imagen:



A-AS-00-A-AL-01_08
3119.pdf

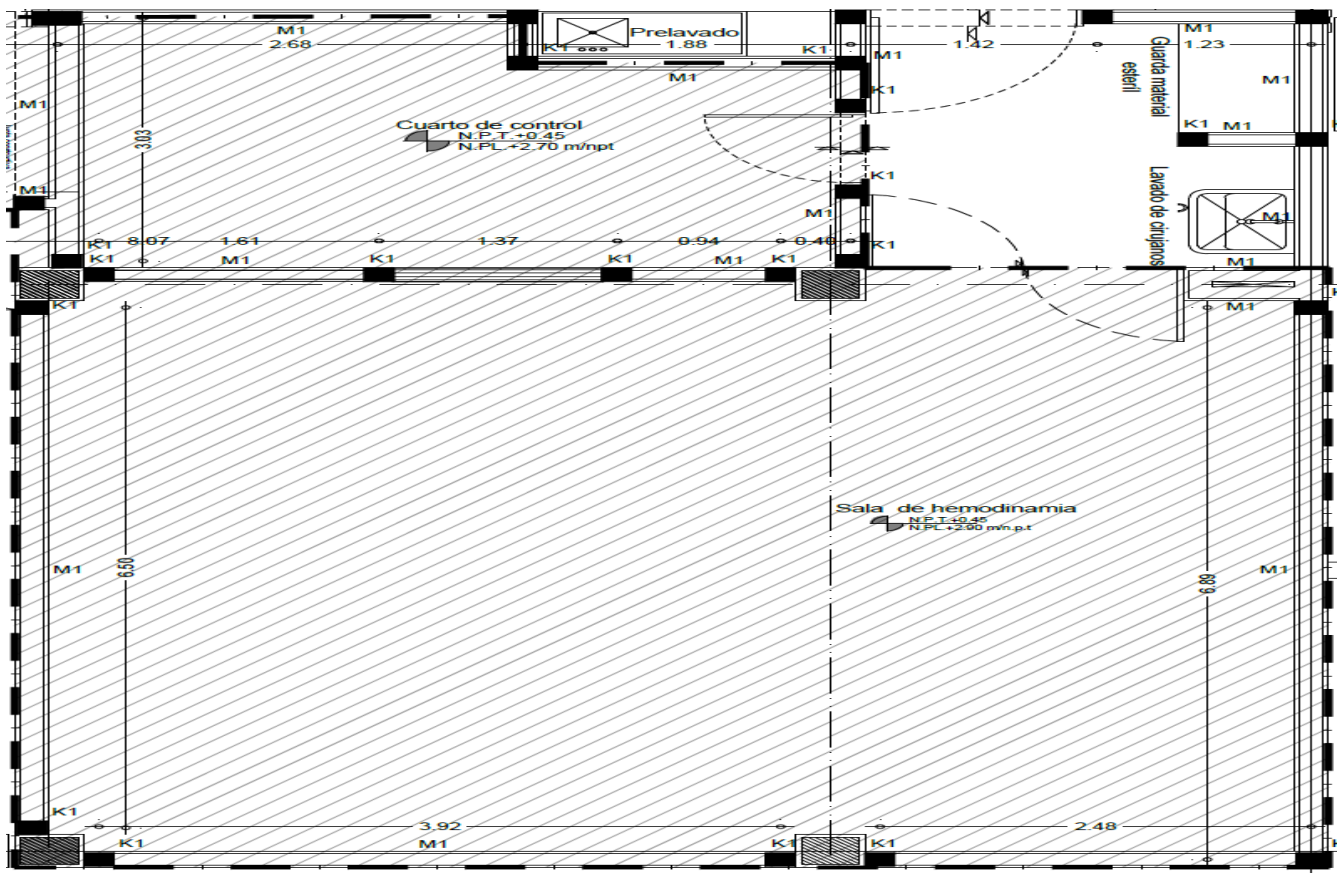

-----OoO-----



ACTA DE REPREGUNTAS Y CIERRE DE LA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-T-66-2024, SALA DE HEMODINAMIA 2024 EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA, (BIENES DE INVERSIÓN) EJERCICIO 2024; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN II, 29 FRACCIÓN III, 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 34 cuarto párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al punto 4 de la Convocatoria, se procedió a dar respuesta a todas y cada una de las **REPREGUNTAS** presentadas en tiempo y forma por el licitante participante, las cuales se transcriben íntegramente con el nombre del licitante que las manifiesta, y sus respectivas respuestas, anexándose al expediente de esta licitación, los escritos presentados por los licitantes que contienen éstas, rubricada por los servidores Públicos presentes en este acto.

LICITANTE QUE MANIFESTO REPREGAUNTAS A LAS ACLARACIONES GENERALES A TRAVES DE COMPRANET:

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
46533	GRUPO FAYX SA DE CV	PUNTO 2.3.- LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES	PARTIDA 5. ENTENDEMOS QUE, PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, ES NECESARIO PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ DE INCLUIR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN LA CUAL DEBERÁ DE RESPALDAR LA PROPUESTA DEL LICITANTE, ESPECIFICANDO QUE SE COMPROMETE, EN CASO DE RESULTAR GANADOR EL LICITANTE, A PROPORCIONAR SIN COSTO ADICIONAL AL INSTITUTO TODOS LOS REQUERIMIENTOS EN ACABADOS Y SUGERENCIAS DE OBRA PARA LAS ÁREAS DE SALA DE HEMODINAMIA, CUARTO DE CONTROL Y CUARTO DE EQUIPOS, ACORDE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y QUE PERMITAN CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD NACIONALES Y NORMAS VIGENTES PARA UNA SALA DE HEMODINAMIA DE INTERVENCIONISMO. SE ACLARA QUE TODOS LOS REQUERIMIENTOS EN ACABADOS QUE EMITA EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, DEBERÁN DE SER REALIZADOS POR EL LICITANTE GANADOR DEL EQUIPO SIN COSTO ADICIONAL AL INSTITUTO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE DENTRO DE LOS ALCANCES DEL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CIVIL NO SE CONSIDERAN LOS ACABADOS DE LAS ÁREAS DE SALA DE HEMODINAMIA, CUARTO DE CONTROL Y CUARTO DE EQUIPOS, SOLO SE CONSIDERA LA OBRA GRIS PARA DICHAS ÁREAS, POR LO CUAL DEBE SER CONSIDERADO POR EL LICITANTE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
46534	GRUPO FAYX SA DE CV	PUNTO 3.2 DE LAS BASES "VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES DEL IMSS"	PARTIDA 5. ENTENDEMOS QUE EL ÁREA DE PACIENTE (ANGIOGRAFO) SE ENTREGARÁ CON PISO Y PARED CON CURVAS SANITARIAS Y CON ACABADO TIPO GLASLINER. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL ÁREA DE PACIENTE (ANGIOGRAFO) SERA ENTREGADA EN OBRA GRIS, YA QUE NO SE TIENE PREVIAMENTE CONSIDERADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA CIVIL, POR LO CUAL EL LICITANTE QUE OFERTE EL EQUIPO DEBERÁ DE CONSIDERAR TODOS LOS ACABADOS FINALES COMO SON CURVAS SANITARIAS, ACABADO GLASLINER, PISO, ILUMINACIÓN, AMBIENTACIÓN, PUERTAS, MUROS, PLAFONES, VENTANAS, EMPLOMADOS, MUROS ANTIBACTERIALES, DADOS DE CONCRETO, ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE EQUIPO Y ACABADOS FINALES, TODO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS QUE VALIDE EL INSTITUTO Y QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA VIGENTE, LOS CUALES DEBEN SER EMITIDOS DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO. ASÍ MISMO SE ACLARA QUE DEBERÍA DE TENER EN CONSIDERACIÓN TODOS LOS DEMAS PUNTOS DEFINIDOS Y ESTABLECIDOS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
46535	MINARIC SA DE CV	LICITANTE MINARIC, PÁGINA 32	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR PARA EL PUNTO 2.4.2 DE LA PARTIDA 3 SE OFERTE CABLE TRONCAL CON CABLE PARA	NO SE ACEPTA, SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS. ASÍ MISMO



ACTA DE REPREGUNTAS Y CIERRE DE LA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-T-66-2024, SALA DE HEMODINAMIA 2024 EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA, (BIENES DE INVERSIÓN) EJERCICIO 2024; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN II, 29 FRACCIÓN III, 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
			PACIENTE DE ECG, SIN DEMERITAR EL FUNCIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE PARA EL PUNTO 2.4.2 PUEDE OFERTAR UN CABLE TRONCAL CON CABLE PARA PACIENTE PARA ECG DE 5 PUNTAS, CÓDIGO AMERICANO, SIEMPRE Y CUANDO LA LONGITUD OFERTADA SEA DE AL MENOS 2.5M +/- 10% O EL EQUIVALENTE EN LONGITUD DE UN CABLE TRONCAL EN CONJUNTO CON UN CABLE PARA PACIENTE.
46536	MINARIC SA DE CV	LICITANTE MINARIC, PÁGINA 32	EN EL CASO DE SER POSITIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR QUE EL PUNTO 2.4.1 PARTIDA 3 SE OFERTE COMO "SE OFERTA CABLE COMPLETO EN EL PUNTO 2.4.2"	NO SE ACEPTA, SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS. ASÍ MISMO SE ACLARA AL LICITANTE QUE PARA EL PUNTO 2.4.1 PUEDE OFERTAR UN CABLE TRONCAL CON CABLE PARA PACIENTE PARA ECG DE 5 PUNTAS, CÓDIGO AMERICANO, SIEMPRE Y CUANDO LA LONGITUD OFERTADA SEA DE AL MENOS 2.5M +/- 10% O EL EQUIVALENTE EN LONGITUD DE UN CABLE TRONCAL EN CONJUNTO CON UN CABLE PARA PACIENTE.
46537	MINARIC SA DE CV	LICITANTE MINARIC, PÁGINA 32	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL PUNTO 1.8.7, PARTIDA 111 ACEPTAR LA OFERTA DE ESTE PUNTO COMO "ASA Y SOPORTE PARA CAMILLA" YA QUE EL EQUIPO ES LIGERO, Y SERÁ POSIBLE CARGAR EL EQUIPO CON UNA MANO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.
46540	DEWIMED SA	JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA 3 DEWIMED, S.A.	DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES SOBRE AUMENTAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 60 DÍAS NATURALES, SOLICITAMOS SE TOME EN CUENTA PARA LAS PARTIDAS: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 99, 107, 109, 110, 113, 114, 115 Y 116, DEBIDO A QUE LOS BIENES QUE ESTAMOS OFERTANDO SON DE IMPORTACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL TIEMPO DE ENTREGA SERA CONTEMPLADO A PARTIR DE LA FECHA DEL FALLO.
46558	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	1	RESPECTO A LA RESPUESTA A LA ULTIMA PREGUNTA DE LA PAG 27 DE 44 DE HEALTHCARE SYSTEMS PARA EL PUNTO 1.5.2 Y LA RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA PAG 39 DE 44 A SIEMENS PARA EL PUNTO 1.5.2. ENTENDEMOS QUE LO MINIMO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE ES UNA CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN TÉRMICA DEL ANODO DE AL MENOS 5 MHU O MAYOR ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
46561	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	2	RESPUESTA DADA A HEALTHCARE SYSTEMS EN LA SEGUNDA PREGUNTA DE LA PAGINA 26 DE 44 PARA LOS PUNTOS 1.8.11 AL 1.8.11.9 Y 1.9.10 AL 1.9.10.8. ENTENDEMOS QUE DEMOSTRAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN FORMA DOCUMENTAL MEDIANTE FICHAS TÉCNICAS, MANUALES, CATÁLOGOS O SIMILAR, SIN SER NECESARIA LA CARTA DEL FABRICANTE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE ACLARA AL LICITANTE QUE PODRÁ DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE DICHS NUMERALES MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE CARTA DEL FABRICANTE EN DONDE MANIFIESTE EL CUMPLIMIENTO DE DICHS PUNTO O DE FORMA DOCUMENTAL REFERENCIANDO EN FICHAS TÉCNICAS, MANUALES, CATÁLOGOS O SIMILAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS.
46563	DISPOSITIVOS Y TECNOLOGIA MEDICA S DE RL DE CV	LEGAL-ADMINISTRATIVA, PUNTO 2.3.- LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES, PÁGINA 24 DE 44, PENÚLTIMA PREGUNTA (LICITANTE: GRUPO FAX S.A. DE C.V.)	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA A ESTA PREGUNTA, TODA VEZ QUE AL TRATARSE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, LOS LICITANTES PODEMOS OFERTAR BIENES DE IMPORTACIÓN, POR LO QUE CUMPLIR CON EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO DEL "FABRICANTE" SERÁ IMPOSIBLE PARA ALGUNOS DE LOS BIENES QUE OFERTEMOS, YA QUE ES UN TRÁMITE QUE SE REALIZA EN MÉXICO, ADEMÁS DE QUE EN EL ENTENDIDO DE QUE SE DEBERÁ INCLUIR AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y RESPONSABLE SANITARIO POR PARTIDA Y POR FABRICANTE.	SE HACE LA ACLARACIÓN AL LICITANTE QUE PODRÁ PRESENTAR AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIÓN DEL RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE Y/O DISTRIBUIDOR Y/O FABRICANTE, SEGÚN APLIQUE PARA CADA CASO O PARTIDA OFERTADA.
46585	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	PART 3 MONITOR SIGNOS VITALES CEDULA DESCRIPCION ART CLAVE 16398 SE ACLARA AL LICITANTE QUE EN	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OTORGAR UNA AMPLIACION DE 30 DIAS PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS	SE ACLARA AL LICITANTE QUE SE ACEPTA UN TIEMPO DE ENTREGA MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO, A EXCEPCIÓN DE LAS PARTIDAS QUE SE CONTEMPLAN EN JUNTA DE ACLARACIONES Y



ACTA DE REPREGUNTAS Y CIERRE DE LA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-T-66-2024, SALA DE HEMODINAMIA 2024 EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA, (BIENES DE INVERSIÓN) EJERCICIO 2024; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN II, 29 FRACCIÓN III, 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
		REPREGUNTAS DEBERA DE ESPECIFICAR PARA QUE PARTIDAS REQUIERE DICHO PLAZO DE ENTREGA		REPREGUNTAS CON UN TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA MAYOR.
46586	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	PART 3 MONITOR SIGNOS VITALES CEDULA DESCRIPCION ART CLAVE 16398 SE ACLARA AL LICITANTE QUE EN REPREGUNTAS DEBERA DE ESPECIFICAR PARA QUE PARTIDAS REQUIERE DICHO PLAZO DE ENTREGA	EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, CUAL SERIA EL PLAZO OTORGADO?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE SE ACEPTA UN TIEMPO DE ENTREGA MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO, A EXCEPCIÓN DE LAS PARTIDAS QUE SE CONTEMPLAN EN JUNTA DE ACLARACIONES Y REPREGUNTAS CON UN TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA MAYOR.
46587	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	PARTIDA 111 VENT DE TRASLADO PED-ADUL CEDULA DESCRIPCION ART CLAVE 12190 SE ACLARA AL LICITANTE QUE EN REPREGUNTAS DEBERA DE ESPECIFICAR PARA QUE PARTIDAS REQUIERE DICHO PLAZO DE ENTREGA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OTORGAR UNA AMPLIACION DE 30 DIAS PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS	SE ACLARA AL LICITANTE QUE SE ACEPTA UN TIEMPO DE ENTREGA MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO, A EXCEPCIÓN DE LAS PARTIDAS QUE SE CONTEMPLAN EN JUNTA DE ACLARACIONES Y REPREGUNTAS CON UN TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA MAYOR.
46588	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	PARTIDA 111 VENT DE TRASLADO PED-ADUL CEDULA DESCRIPCION ART CLAVE 12190 SE ACLARA AL LICITANTE QUE EN REPREGUNTAS DEBERA DE ESPECIFICAR PARA QUE PARTIDAS REQUIERE DICHO PLAZO DE ENTREGA	EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, CUAL SERIA EL PLAZO OTORGADO?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE SE ACEPTA UN TIEMPO DE ENTREGA MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO, A EXCEPCIÓN DE LAS PARTIDAS QUE SE CONTEMPLAN EN JUNTA DE ACLARACIONES Y REPREGUNTAS CON UN TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA MAYOR.
46589	CONDUIT LIFE SA DE CV	LICITANTE: GRUPO FAYX SA DE CV, PÁGINA 24 DE 44, FILA 7, PREGUNTA: LEGAL-ADMINISTRATIVA, REFERENTE A LICENCIAS, PERNISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES	DE ACUERDO A LO CONTESTADO AL LICITANTE. POR TRATARSE DE UNA LICITACIÓN INTERNACIONAL Y DEBIDO A QUE EL FABRICANTE DE LOS BIENES QUE OFERTAREMOS ES EXTRANJERO, NO ESTÁ SOMETIDO U OBLIGADO A TENER AVISO DE FUNCIONAMIENTO EMITIDO POR AUTORIDAD MEXICANA; SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE PERMITA PRESENTAR AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL LICITANTE Y/O DISTRIBUIDOR, ¿SE ACEPTA?	SE HACE LA ACLARACIÓN AL LICITANTE QUE PODRÁ PRESENTAR AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIÓN DEL RESPONSABLE SANITARIO DEL LICITANTE Y/O DISTRIBUIDOR Y/O FABRICANTE, SEGÚN APLIQUE PARA CADA CASO O PARTIDA OFERTADA.
46613	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTAS PARA LOS PUNTOS TÉCNICOS 1.3,1.8.11 AL 1.8.11.9, 2.3, 2.2.1, 1.8.7, 1.9.3, 1.8.5, 1.8.4, 2.2.7, 2.2.3 Y 2.2.2 DE LA PARTIDA 5 DE LA LICITANTE GRUPO FAYX SA DE CV	ENTENDEMOS QUE LOS PUNTOS DONDE SE DIO RESPUESTA "SE ACEPTA SU PROPUESTA" Y "ES CORRECTA SU APRECIACIÓN" ES SIN SER LIMITATIVO U OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES, DADO QUE SON CARACTERÍSTICAS O NOMENCLATURA PROPIA DE SU FABRICANTE. ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE CUANDO LAS PREGUNTA HACE REFERENCIA A LA NOMENCLATURA O REFERENCIACIÓN PROPIA DE CADA FABRICANTE, LA RESPUESTA ES DE CARÁCTER VALIDATIVO RESPECTO A COMO SERÁ REFERENCIADO, SIN SER LIMITATIVO U OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LICITANTES, SIN EMBARGO NO SE CONSIDERA CON DICHA RESPUESTA EL CUMPLIMIENTO PER SE DEL PUNTO DE LA CEDULA A LA QUE SE HACE REFERENCIA, POR LO CUAL EL LICITANTE DEBERÁ DE DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO EN EL CONTEXTO PROPIO DEL MANUAL, CATALOGO O FICHA TÉCNICA, PUDIENDO UTILIZAR LA REFERENCIA O NOMENCLATURA APROBADA. POR OTRA PARTE, SI LA PREGUNTA HACE REFERENCIA A UNA CARACTERÍSTICA TÉCNICA ESPECIFICA, COMO LA SOLICITUD DE MONTAJE A TECHO PARA LA PARTIDA 5, LA RESPUESTA HACE REFERENCIA A UNA CARACTERÍSTICA OBLIGATORIA QUE DEBE SER CONSIDERADA POR TODOS LOS LICITANTES.
46614	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTAS PARA LOS PUNTOS TÉCNICOS 1.3,1.8.11 AL 1.8.11.9, 2.3, 2.2.1, 1.8.7, 1.9.3, 1.8.5, 1.8.4, 2.2.7, 2.2.3 Y 2.2.2 DE LA PARTIDA 5 DE LA LICITANTE GRUPO FAYX SA DE CV	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA NOMENCLATURA O CARACTERÍSTICAS SON ÚNICAS DE LOS FABRICANTES NO DEBEN LIMITAR LA LIBRE CONCURRENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES PARA UNA PARTICIPACIÓN JUSTA Y TRANSPARENTE PARA TODOS LOS LICITANTES ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PODRÁ UTILIZAR LA NOMENCLATURA PROPIA DE SU FABRICANTE PARA HACER LAS REFERENCIAS TÉCNICAS DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE, LAS CUALES DEBE DE DEMOSTRAR DE FORMA DOCUMENTAL LA EQUIVALENCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA MISMA, POR LO CUAL SI EXISTE UN CAMBIO DE NOMENCLATURA Y DICHA REFERENCIA NO CORRESPONDE A LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA, NO SERIA POSIBLE LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA POR NO SER CORRESPONDIENTE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, POR LO CUAL SE SUGIERE QUE SEAN ANEXADOS EN SU PROPUESTA TÉCNICA TODOS LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPIOS



ACTA DE REPREGUNTAS Y CIERRE DE LA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-T-66-2024, SALA DE HEMODINAMIA 2024 EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA, (BIENES DE INVERSIÓN) EJERCICIO 2024; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN II, 29 FRACCIÓN III, 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
				DEL EQUIPO OFERTADO, COMO SON FICHAS TÉCNICAS, MANUALES DE OPERACIÓN, MANUALES DE SERVICIO, DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADICIONAL EMITIDA POR EL FABRICANTE, EN LA CUAL SE APRECIE Y SE DESCRIBA LA CARACTERÍSTICA REFERENCIADA CON LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE Y QUE DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA ENTRE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE Y LO OFERTADO POR EL LICITANTE.
46615	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTAS PARA LOS PUNTOS TÉCNICOS 2.2.3, 2.2.7, 1.8.4, 1.8.5, 1.5.4, 2.2.3, 2.2.2, 2.2.1, 1.8.7, 1.9.3, 1.9.6 Y 1.5.2 DE LA PARTIDA 5 DEL LICITANTE HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	ENTENDEMOS QUE LOS PUNTOS DONDE SE DIO RESPUESTA "SE ACEPTA SU PROPUESTA" Y "ES CORRECTA SU APRECIACIÓN" ES SIN SER LIMITATIVO U OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES, DADO QUE SON CARACTERÍSTICAS O NOMENCLATURA PROPIA DE SU FABRICANTE. ¿ES CORRECTO?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE CUANDO LAS PREGUNTA HACE REFERENCIA A LA NOMENCLATURA O REFERENCIACIÓN PROPIA DE CADA FABRICANTE, LA RESPUESTA ES DE CARÁCTER VALIDATIVO RESPECTO A COMO SERÁ REFERENCIADO, SIN SER LIMITATIVO U OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LICITANTES, SIN EMBARGO NO SE CONSIDERA CON DICHA RESPUESTA EL CUMPLIMIENTO PER SE DEL PUNTO DE LA CEDULA A LA QUE SE HACE REFERENCIA, POR LO CUAL EL LICITANTE DEBERÁ DE DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO EN EL CONTEXTO PROPIO DEL MANUAL, CATALOGO O FICHA TÉCNICA, PUDIENDO UTILIZAR LA REFERENCIA O NOMENCLATURA APROBADA. POR OTRA PARTE SI LA PREGUNTA HACE REFERENCIA A UNA CARACTERÍSTICA TÉCNICA ESPECIFICA, COMO LA SOLICITUD DE MONTAJE A TECHO PARA LA PARTIDA 5, LA RESPUESTA HACE REFERENCIA A UNA CARACTERÍSTICA OBLIGATORIA QUE DEBE SER CONSIDERADA POR TODOS LOS LICITANTES.
46616	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTAS PARA LOS PUNTOS TÉCNICOS , 2.2.3, 2.2.7, 1.8.4, 1.8.5, 1.5.4, 2.2.3, 2.2.2, 2.2.1, 1.8.7, 1.9.3, 1.9.6 Y 1.5.2 DE LA PARTIDA 5 DEL LICITANTE HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA NOMENCLATURA O CARACTERÍSTICAS SON ÚNICAS DE LOS FABRICANTES NO DEBEN LIMITAR LA LIBRE CONCURRENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES PARA UNA PARTICIPACIÓN JUSTA Y TRANSPARENTE PARA TODOS LOS LICITANTES ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE ACLARA AL LICITANTE QUE PODRÁ UTILIZAR LA NOMENCLATURA PROPIA DE SU FABRICANTE PARA HACER LAS REFERENCIAS TÉCNICAS DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE, LAS CUALES DEBE DE DEMOSTRAR DE FORMA DOCUMENTAL LA EQUIVALENCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA MISMA, POR LO CUAL SI EXISTE UN CAMBIO DE NOMENCLATURA Y DICHA REFERENCIA NO CORRESPONDE A LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA, NO SERIA POSIBLE LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA POR NO SER CORRESPONDIENTE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, POR LO CUAL SE SUGIERE QUE SEAN ANEXADOS EN SU PROPUESTA TÉCNICA TODOS LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPIOS DEL EQUIPO OFERTADO, COMO SON FICHAS TÉCNICAS, MANUALES DE OPERACIÓN, MANUALES DE SERVICIO, DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADICIONAL EMITIDA POR EL FABRICANTE, EN LA CUAL SE APRECIE Y SE DESCRIBA LA CARACTERÍSTICA REFERENCIADA CON LA NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE Y QUE DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA ENTRE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE Y LO OFERTADO POR EL LICITANTE.
46617	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA PARA EL PUNTO TÉCNICO1.5.4 DE LA PARTIDA 5 DEL LICITANTE HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	AL SOLICITAR EL SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE EJE DUAL EN UNA SOLA INYECCIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE PARA LA VISUALIZACIÓN DEL ÁRBOL CORONARIO, SE ESTA FAVORECIENDO A UNA SOLA CASA COMERCIAL, SITUACIÓN QUE ESTA PROHIBIDA POR LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y LA LEY FEDERAL DE BIENES Y ADQUISICIONES DEL SECTOR PUBLICO, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PERMITA LA LIBRE COMPETENCIA Y NO SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES EL OFERTAR ESTE SOFTWARE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE EN LA PREGUNTA PARA EL PUNTO TÉCNICO1.5.4 DE LA PARTIDA 5 DEL LICITANTE HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO SA DE CV, EL LICITANTE HACE REFERENCIA A UNA CARACTERÍSTICA DE CRECIMIENTO A FUTURO, LA CUAL PUEDE SER OFERTADA, SIN EMBARGO NO IMPLICA QUE DEBA SER OBLIGATORIA PARA EL RESTO DE LICITANTES.
46618	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA PARA EL PUNTO TÉCNICO1.5.4 DE LA PARTIDA 5 DEL LICITANTE HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE JUSTIFICAR LA PERMANENCIA DEL PUNTO.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR FUE POSITIVA.
46619	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA PARA TODOS LOS PUNTOS TÉCNICOS DE LA PARTIDA 5 DEL LICITANTE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR EL PUNTO 1.6.6. CON RANGO DE PIVOTE SOBRE EL EJE DE LA COLUMNA CENTRAL COMO ROTACIÓN DE LA MESA TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON	SE ACEPTA SU PROPUESTA.



ACTA DE REPREGUNTAS Y CIERRE DE LA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-T-66-2024, SALA DE HEMODINAMIA 2024 EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA, (BIENES DE INVERSIÓN) EJERCICIO 2024; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN II, 29 FRACCIÓN III, 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	REFERENCIA, A LA PREGUNTA	PREGUNTA A LA RESPUESTA EMITIDA POR EL LICITANTE	RESPUESTA
			ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	
46620	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA PARA TODOS LOS PUNTOS TÉCNICOS DE LA PARTIDA 5 DEL LICITANTE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	ENTENDEMOS QUE DAMOS CUMPLIMIENTO AL PUNTO 1.9.4 SUPERPOSICIÓN DEL MODELO 3D EN LA FLUOROSCOPIA EN TIEMPO REAL. SI CONTAMOS CON EL SOFTWARE QUE PERMITE FUSIONAR VOLUMENES 3D DE OTRAS MODALIDADES DE IMAGEN PARA LA GUÍA DE IMAGEN EN VIVO. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE ACLARA AL LICITANTE QUE DEBE DE DEMOSTRAR QUE EL SOFTWARE AL QUE HACE REFERENCIA, PERMITE FUSIONAR VOLUMENES 3D EN FORMA SUPERPUESTA A LA IMAGEN DE FLUOROSCOPIA EN TIEMPO REAL, POR LO CUAL SI UTILIZA UNA NOMENCLATURA DIFERENTE A LA ESPECIFICADA EN LA CONVOCATORIA, DEBERÁ DE DEMOSTRAR QUE DICHA NOMENCLATURA CORRESPONDE A UNA SUPERPOSICIÓN DEL MODELO 3D SOBRE LA IMAGEN DE FLUOROSCOPIA EN TIEMPO REAL, DEBIENDO DE SEÑALAR LAS REFERENCIAS DOCUMENTALES QUE PERMITAN VALIDAR LA CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA DE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE Y LO OFERTADO POR EL LICITANTE.
46621	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA PARA TODOS LOS PUNTOS TÉCNICOS DE LA PARTIDA 5 DEL LICITANTE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	DEBIDO A LA RESPUESTA DE LA CONVOCANTE, ENTENDEMOS ENTONCES QUE SI LA REFERENCIA ES ACORDE A LA NOMENCLATURA DEL FABRICANTE Y ESTA ES EQUIVALENTE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA SI SE PUEDE PONER UNA NOTA DE FORMA INDICATIVA AL CUMPLIMIENTO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE ACLARA AL LICITANTE QUE SI USAN UNA REFERENCIA ACORDE A LA NOMENCLATURA DEL FABRICANTE Y ESTA ES EQUIVALENTE A LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA, DEBERÁN DE DEMOSTRAR DE FORMA DOCUMENTAL DICHA EQUIVALENCIA, ASÍ COMO LA CORRESPONDENCIA Y CONGRUENCIA DE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE Y LO REFERENCIADO U OFERTADO POR EL LICITANTE.
46622	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA PARA EL PUNTO TÉCNICO 1.5.2 DE LA PARTIDA 5 DEL LICITANTE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	CON BASE A LA RESPUESTA DADA POR LA CONVOCANTE ENTENDEMOS QUE DAMOS CUMPLIMIENTO AL PUNTO AL OFERTAR UNA CAPACIDAD TÉRMICA DE ALMACENAMIENTO DEL ÁNODO 5MHU O MAYOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
46623	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA PARA EL PUNTO TÉCNICO 1.6.3 DE LA PARTIDA 5 DEL LICITANTE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER REFERENCIAR MOVIMIENTO TRANSVERSAL O LATERAL COMO RECORRIDO TRANSVERSAL TODA VEZ QUE EN EL MANUAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA CON ESTA TERMINOLOGÍA DADO QUE ESTO REPRESENTA LA MISMA CARACTERÍSTICA SOLICITADA SIN QUE LO ANTERIOR LIMITE LA LIBRE COMPETENCIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL RECORRIDO TRANSVERSAL QUE OFERTE DEBE SER DE +- 14CM O MAYOR.
46624	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA PARA EL PUNTO TÉCNICO 2.1 DE LA PARTIDA 5 DEL LICITANTE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	DADA LA RESPUESTA POR LA CONVOCANTE PARA LA TERMINOLOGÍA INTERFASADO O SINCRONIZADO AL EQUIPO, SE ENTIENDE QUE SE DEBE DE DEMOSTRAR A TRAVÉS DE MANUALES QUE EL INYECTOR OFERTADO ES COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE ANGIOGRAFÍA ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA DEMOSTRACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD ENTRE EL INYECTOR OFERTADO Y EL SISTEMA DE ANGIOGRAFÍA DEBE DE ESPECIFICAR Y DEMOSTRAR LA SINCRONICIDAD ENTRE AMBOS O QUE COMPARTAN LA MISMA INTERFASE PARA SU CONTROL O QUE PUEDA SER OPERADO EL INYECTOR EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL SISTEMA DE ANGIOGRAFÍA QUE REQUIERAN DE CONTRASTE.
46625	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA PARA EL PUNTO TÉCNICO 2.7 DE LA PARTIDA 5 DEL LICITANTE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	DEBEMOS ENTENDER QUE AL OFERTAR UNA UPS DE 160 KVA CON 30 MINUTOS DE RESPALDO Y FACTOR DE POTENCIA DE ENTRADA DE 0.99 A PLENA CARGA, TANTO PARA EL POLÍGRAFO COMO PARA EL SISTEMA DE ANGIOGRAFÍA SE DA CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIO ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. LO ANTERIOR SIN SER OBLIGATORIO O LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.
46626	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA 1 DEL LICITANTE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV REFERENTE A LA INSTALACIÓN Y GUÍAS MECÁNICAS	ENTENDEMOS DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA AL SITIO DE INSTALACIÓN QUE LA CONVOCANTE NOS DEJARÁ UN ÁREA LIBRE DE MÍNIMO 7.10 METROS X 7.10 METROS (APROX 49 METROS CUADRADOS) PARA ADECUARLA A SALA DE EXPLORACIÓN, ADICIONAL A LOS ESPACIOS COMPLEMENTARIO DEL ANGIOGRAFO. DICHAS MEDIDAS NO COINCIDEN CON EL ANEXO 1. QUE SE COMPARTIÓ A INTRANET. FAVOR DE CONFIRMAR.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LOS PLANOS REALES DEL ÁREA SE SUBIERON A LA JUNTA DE ACLARACIONES, ASÍ MISMO SE COMPARTEN EN ACLARACIONES GENERALES LA IMAGEN DEL PLANO CON LAS MEDIDAS ESPECÍFICAS DE LOS ESPACIOS CON LOS QUE SE CONTARA EN TODAS LAS ÁREAS, LOS CUALES NO SON POSIBLE MODIFICAR Y DEBERÁ DE REALIZAR SU GUÍA MECÁNICA EN CONSIDERACIÓN DE DICHAS MEDIDAS.



ACTA DE REPREGUNTAS Y CIERRE DE LA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-T-66-2024, SALA DE HEMODINAMIA 2024 EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA, (BIENES DE INVERSIÓN) EJERCICIO 2024; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN II, 29 FRACCIÓN III, 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

De conformidad con el inciso d) del numeral 4 de las bases y al penúltimo párrafo del artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se informa a los licitantes que las aclaraciones a la Convocatoria, así como las modificaciones derivadas del acta de junta de aclaraciones, serán consideradas como parte integrante de la convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de sus propuestas.

Por la importancia que reviste el foliado de las propuestas Técnico-Económicas, se reitera a los Licitantes foliar todas y cada una de las hojas que conformen su propuesta Técnico-Económica.

Se hace la observación que por parte del Área de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejoras de la Gestión Pública; de Quejas, Denuncias e Investigaciones se tuvo conocimiento y participación de la presente acta de manera virtual. Así mismo, se informa que no hubo participación por parte de la Jefatura de Servicios Jurídicos.

Para firmar el contrato, el representante legal de la empresa deberá presentar la documentación que se especifica en el punto **7.2** de la Convocatoria y que deberá corresponder a los datos protestados en el **Anexo número 04 (CUATRO)**, presentado en el acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de la presente licitación. Así como lo solicitado en el numeral 8.1 de la misma, relacionado con la entrega al Instituto de la "Opinión de cumplimientos de obligaciones en materia de Seguridad Social" vigente y positiva y la constancia de situación fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Amortizaciones.

Sin menoscabo de lo anterior, el licitante que resulte adjudicado **deberá apersonarse a firmar el contrato respectivo en la fecha y hora señalada** para tal efecto dentro del evento de Fallo de este procedimiento de conformidad con el artículo número 46 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Asimismo, se **Rectifica** que el **Acto de Presentación y Apertura de Propositiones** se llevará a cabo el **día 28 de mayo de 2024**, en el Aula de Usos Múltiples de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, en el domicilio arriba mencionado, a las **10:30** horas, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social, de conformidad con el Artículo **39** del Reglamento de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta, y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el acto de Cierre a la Junta de Aclaraciones a las bases de la **LICITACIÓN**




ACTA DE REPREGUNTAS Y CIERRE DE LA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-T-66-2024, SALA DE HEMODINAMIA 2024 EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA, (BIENES DE INVERSIÓN) EJERCICIO 2024; DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN II, 29 FRACCIÓN III, 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO.

PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR013-T-66-2024, SALA DE HEMODINAMIA 2024 EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE HEMODINAMIA, (BIENES DE INVERSIÓN) EJERCICIO 2024; siendo las **15:10** horas del mismo día y año, levantando la presente acta para los efectos legales conducentes y para debida constancia, con fundamento en el artículo 33 Bis último párrafo y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, firmando al margen y al calce del presente documento, las personas que en ella participaron, informándoles que podrán consultarla a través del sistema electrónico de compras gubernamentales <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx>.

**RÚBRICAS
POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**


LIC. ERNESTO ANTONIO HOOPER ARVIZU
JEFE DEL DPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS


C. DARIO FRANCISCO LÓPEZ ALDERETE
ADSCRITO A LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS


ING. JUAN ALBERTO TORRES BAUTISTA
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS