



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA
LA-050-GYR-050GYR041-T-396-2023

ADQUISICIÓN DE BIENES DE SUMINISTRO CLAVES 379, 526 Y 531 PARA LOS
SERVICIOS CLÍNICOS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL OOAD IMSS EN TLAXCALA

En Tlaxcala, Tlaxcala, siendo las 11:00 horas, del 26 de octubre de 2023, en la sala de juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, con con ubicación en Av. Libramiento Poniente I.P.N. S/N, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala. C.P. 90110; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento) así como del numeral 4 de la convocatoria a la licitación.

De conformidad con el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el acto es presidido por **Dr. Oscar Rolando Ávila Galván**, Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento del IMSS en Tlaxcala, servidor público designado por la convocante del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social Estatal Tlaxcala, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El Presidente del acto, fue asistido por el representante del área requirente, IBM Carlos Joel Barrera Velazquez, Coordinador Biomédico Delegacional y Mtra. María de Lourdes Sánchez Delgado, Supervisor de Enfermería en Atención Médica los cuales solventaron las preguntas de carácter técnico y el representante del área contratante del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, el cual solventó las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar de las siguientes personas a través portal de Compra Net:

Se otorga el presente a las 11:00 horas del día 26 de octubre de 2023 en Tlaxcala, Tlaxcala.



FO
CONOS/ 1

4
8
6

Código del Expediente: E-2023-00099477
Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR041-T-396-2023
Número de junta: 1

Empresas interesadas

Num.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Acuse de solicitud de aclaración	Acuse de repreguntas
1	ABASTO Y SUMINISTRO EN FARMACOS GADG SA DE CV	20 de Octubre de 2023 a las 09:50		NO	NO
2	ATO DEL NOROESTE SA DE CV	23 de Octubre de 2023 a las 11:25		NO	NO
3	CARDIOPACE SA DE CV	24 de Octubre de 2023 a las 12:49		NO	NO
4	CIRQUEMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	24 de Octubre de 2023 a las 11:02	24 de Octubre de 2023 a las 11:00	SI	NO
5	COMERCIALIZADORA SARMUA SA DE CV	23 de Octubre de 2023 a las 13:39	23 de Octubre de 2023 a las 10:31	NO	NO
6	COOPERATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA SA DE CV	23 de Octubre de 2023 a las 08:20		NO	NO
7	MEDICO TECNOMED SA DE CV	19 de Octubre de 2023 a las 17:27	19 de Octubre de 2023 a las 17:28	NO	NO
8	DRPRO MED SA DE CV	23 de Octubre de 2023 a las 16:24	23 de Octubre de 2023 a las 16:27	NO	NO
9	EQUIPOMEK SA DE CV	20 de Octubre de 2023 a las 11:24		NO	NO
10	FARMACUTICOS MAYPO SA DE CV	19 de Octubre de 2023 a las 17:34	23 de Octubre de 2023 a las 14:06	NO	NO
11	IDEM MEDICAL SA DE CV	24 de Octubre de 2023 a las 15:36	24 de Octubre de 2023 a las 15:57	NO	NO
12	MARIA GUADALUPE LANDAVERDE VILLAGRAN	20 de Octubre de 2023 a las 08:24	20 de Octubre de 2023 a las 08:25	NO	NO
13	MIGUEL ANGEL VILLANUEVA PONCE	20 de Octubre de 2023 a las 10:35		NO	NO
14	SUMINISTROS ESPECIALIZADOS DE MEDICAMENTOS SA DE CV	25 de Octubre de 2023 a las 08:36		NO	NO
15	TAG SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	23 de Octubre de 2023 a las 16:41		NO	NO
16	TECNO COMERCIAL PARTI SA DE CV	20 de Octubre de 2023 a las 10:18	23 de Octubre de 2023 a las 12:04	SI	NO
17	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	24 de Octubre de 2023 a las 13:51	24 de Octubre de 2023 a las 13:51	NO	NO
18	VICTOR MANUEL MELO SERRANO	20 de Octubre de 2023 a las 22:51	20 de Octubre de 2023 a las 22:52	NO	NO
19	VITER MEDICAL SA DE CV	24 de Octubre de 2023 a las 09:58	24 de Octubre de 2023 a las 09:58	NO	NO



No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS
1	CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	Electrónica	06
2	TECNO COMERCIAL PAKTLI, S.A. DE C.V.	Electrónica	25

Así mismo se hace constar que se reciben en tiempo escrito de interés en participar de los siguientes licitantes, sin presentar preguntas:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL
1	COMERCIALIZADORA SARHUA, S.A. DE C.V.
2	DISTRIBUIDOR MÉDICO TECNOMED, S.A. DE C.V.
3	DRPRO MED, S.A. DE C.V.
4	FARMACÉUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.
5	IDEM MEDICAL, S.A. DE C.V.
6	MARÍA GUADALUPE LANDAVERDE VILLAGRAN
7	TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
8	VÍCTOR MANUEL MELO SERRANO
9	VITER MEDICAL, S.A. DE C.V.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

Licitante: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V

PREGUNTA	PUNTO O NUMERAL	ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS
1	PARTIDA 59:	DEBIDO A LA MEJORA EN EL DISEÑO DE ESTOS BRAZALETES Y POR CONSIGUIENTE LA MANGUERA NECESARIA PARA CONECTAR ESTOS AL EQUIPO, SOLICITAMOS A ESA H. INSTITUCION NOS PERMITA OFERTAR DICHA INDISPENSABLE PARA CONECTAR DICHOS BRAZALETES AL EQUIPO, SE ACEPTA?	SE SOLICITA SE APEGUE A LA OSLICITUD DE LA PARTIDA 59 DONDE SE HACE LA PETICION DE QUE EL BRAZALETES SEA DE TUBERIA DE DOS VÍAS CON UN LONGITUD AL MENOS DE 50CM .
2	PARTIDAS 68, 69, 381, 382 Y 383	DEBEMOS ENTENDER QUE SOLO REQUIERE EL BRAZALETE A PACIENTE ESPECIFICADO Y QUE NO REQUIERE LA MANGUERA NECESARIA PARA CONECTAR ESTE BRAZALETE AL EQUIPO, ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS PARTIDAS 68, 69, 381, 382, Y 383.

FO
CON08/ 3



3	PARTIDAS 88, 89 Y 93	DEBEMOS ENTENDER QUE SOLO REQUIERE EL CABLE DE ECG A PACIENTE ESPECIFICADO Y QUE NO REQUIERE EL CABLE TRONCAL NECESARIO PARA CONECTAR ESTE CABLE AL EQUIPO, ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
4	PARTIDA 91	DEBEMOS ENTENDER QUE SOLO REQUIERE EL CABLE TRONCAL DE ECG ESPECIFICADO Y QUE NO REQUIERE EL CABLE DE ECG A PACIENTE, ES CORRECTO? EN CASO DE REQUERIR EL CABLE DE ECG A PACIENTE, FAVOR DE ESPECIFICAR LA CANTIDAD DE PUNTAS REQUERIDAS, 3 Ó 6 PUNTAS	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
5	PARTIDA 92:	DEBEMOS ENTENDER QUE SOLO REQUIERE EL CABLE TRONCAL DE SPO2 ESPECIFICADO Y QUE NO REQUIERE EL SENSOR DE SPO2 A PACIENTE, ES CORRECTO? EN CASO DE REQUERIR EL SENSOR DE SPO2 A PACIENTE, FAVOR DE PRECISAR QUE TIPO DE SENSOR REQUIEREN EL DE DEDO O MULTISITIO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
6	PARTIDAS 352, 352 Y 420:	DEBEMOS ENTENDER QUE SOLO REQUIERE EL SENSOR DE SPO2 A PACIENTE ESPECIFICADO Y QUE NO REQUIERE EL CABLE TRONCAL NECESARIO PARA CONECTAR ESTE SENSOR AL EQUIPO, ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO EL SENSOR QUE SE OFERTE EN LA PARTIDA 352 DEBERA SER COMPATIBLE CON EL CABLE TRONCAL DEL EQUIPO UNIDAD ANESTESIA MODELO PLARRE 9500 Y LA PARTIDA 420 DEBERA SER COMPATIBLE CON EL CABLE TRONCAL DEL EQUIPO MODELO TEC5531E.

Licitante: TECNO COMERCIAL PAKTLI, S.A. DE C.V

PREGUNTA	PUNTO O NUMERAL	ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS
1	PARTIDA 9	FAVOR DE ESPECIFICARNOS EL TIPO DE TOMA MURAL (MARCA) Y LA PROPORCION (NUMERO DE PIEZAS DE AIRE Y NUMERO DE PIEZAS DE OXIGENO)	SE SOLICITA SE SUMINISTRE 2 ADAPTADORES DE OXIGENO TIPO AGA, 2 ADAPTADORES DE AIRE AGA Y 1 ADAPTADOR DE OXIGENO INFRA Y 1 ADAPTADOR DE AIRE INFRA.



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

2	PARTIDA 56	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DOS VIAS, ¿REQUIERE DE CONECTORES? SI ES ASI FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR QUE DEBERA LLEVAR EL BRAZALETE.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VIA.
3	PARTIDA 61	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DOS VIAS, ¿REQUIERE DE CONECTORES? SI ES ASI FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR QUE DEBERA LLEVAR EL BRAZALETE.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VIA.
4	PARTIDA 62	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DOS VIAS, ¿REQUIERE DE CONECTORES? SI ES ASI FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR QUE DEBERA LLEVAR EL BRAZALETE.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VIA.
5	PARTIDA 68	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DOS VIAS, ¿REQUIERE DE CONECTORES? SI ES ASI FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR QUE DEBERA LLEVAR EL BRAZALETE.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VIA.
6	PARTIDA 70	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DOS VIAS, ¿REQUIERE DE CONECTORES? SI ES ASI FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR QUE DEBERA LLEVAR EL BRAZALETE.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VIA.
7	PARTIDA 57	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DOS VIAS, ¿REQUIERE DE CONECTORES? SI ES ASI FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR QUE DEBERA LLEVAR EL BRAZALETE.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VIA.
8	PARTIDA 58	ACEPTAN BRAZALETES DE CIRCUNFERENCIA DE 3 A 6 CM.?	SE ACEPTA SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS OFERTANTES.
9	PARTIDA 64	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DOS VIAS, ¿REQUIERE DE CONECTORES? SI ES ASI FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR QUE DEBERA LLEVAR EL BRAZALETE.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VIA.
10	PARTIDA 69	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DOS VIAS, ¿REQUIERE DE CONECTORES? SI ES ASI FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VIA.



FO
CON08/ 5



		CONECTOR QUE DEBERA LLEVAR EL BRAZALETE.	
11	PARTIDA 131	DEBIDO A QUE LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE 0717 CARECE DE DETALLE Y LA MARCA T-BIRD NO EXISTE YA EN EL MERCADO, ENTENDEMOS QUE SE DEBE OFERTAR CIRCUITO 1.8 M CON PUERTO Y TUBO PARAMONITOREO DE PRESIÓN PROXIMAL Y CON 2 TRAMPAS DE AGUA. ¿ES CORRECTO OFERTARLO DE ESTA MANERA?	SE ACEPTA SOLICITUD.
12	PARTIDA 135	ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A UN CIRCUITO SIMPLE, SIN TRAMPAS DE AGUA NI RAMAL DE HUMIDIFICACIÓN Y QUE ADEMÁS ES DESECHABLE. FAVOR DE CONFIRMAR. FAVOR DE ACLARAR PARA QUE TIPO DE PACIENTE SE USARÁ.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA PARTIDA 135 QUE SE REFIERE A UN CIRCUITO DEL EQUIPO VENTILADOR VENT 201.
13	PARTIDA 132	DEBIDO A QUE LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE 0865 CARECE DE DETALLE, ENTENDEMOS QUE SE DEBE OFERTAR CIRCUITO 1.8 M CON RAMAL DE HUMIDIFICACIÓN Y 2 TRAMPAS DE AGUA. ¿ES CORRECTO OFERTARLO DE ESTA MANERA?	SE SOLICITA QUE EL TIPO DE CIRCUITO VENTILATORIO SEA PARA PACIENTE NEONATAL DEL VENTILADOR CAREFUSION MODELO AVEA.
14	PARTIDA 213	1.- SUPONEMOS QUE DEBEMOS OFERTAR LA CONEXIÓN A LA TOMA MURAL DE AIRE, EN ESTE SENTIDO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUEN EL TIPO DE TOMA MURAL A LA QUE SE CONECTARAN LOS GENERADORES DE SUCCIÓN. 2.-¿ REQUIERE LA CONVOCANTE QUE EL DISPOSITIVO TENGA MANÓMETRO INTEGRADO?	SE SOLICITA SE SUMINISTRE QUE LOS INYECTORES SEAN PARA LAS SIGUIENTES TOMAS MURALES: 8 AGA Y 2 INFRA.
15	PARTIDA 255, 256, 25 Y , 258	¿SERA CORRECTO OFERTAR MASCARILLAS REUSABLES?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SE REQUIERE DE MASCARILLAS REUSABLES.
16	PARTIDA 327	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE EL RANGO QUE DEBE TENER EL MANOMETRO, CONSIDERANDO QUE LOS MANUALES DE RESUCITACION REFIEREN MANEJO DE PRESIONES DE 0 A 60 MMHG. CONSIDERANDO QUE LOS ADITAMENTOS DE SEGURIDAD (MANOMETRO Y VALVULA PEEP) ELEVAN EL PRECIO DEL INSUMO APROXIMADAMENTE EN UN 40%, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE REQUIERE EL INSUMO CON DICHS ADITAMENTOS	APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA PARTIDA 327 PARA PACIENTE NEONATAL CON MANEJO DE PRESIONES DEBERA DE SER DE 0 A 60 MMHG.



17	PARTIDA 192	¿SERÁ CORRECTO OFERTAR UN FILTROFILTRO BACTERIANO VIRAL DE FLUJO PRINCIPAL. MARCA HUDSON RCI DE 22MM I.D. X 15MM I.D./22MM O.D. EFICACIA BACTERIAL 99.999%; EFICACIA VIRAL 99.99% ESPACIO MUERTO DE 42 ML. LA RESISTENCIA DE FLUJO DE APROXIMADA 1,5 CM H2O A 60 LPM.	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS OFERTANTES.
18	PARTIDAS 260 Y 261	¿SERÁ CORRECTO OFERTAR MASCARILLAS REUSABLES?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SE REQUIERE DE MASCARILLAS DESECHABLES.
19	PARTIDA 265	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN NEBULIZADOR PRE-LLENADO DE AGUA ESTERILIZADA "AQUAPAK" DE 760ML, CON ADAPTADORES DE HUMIDIFICADOR INCORPORAN UNA ALARMA AUDIBLE PARA ALERTAR AL MÉDICO SOBRE LA RESTRICCIÓN DEL FLUJO U OCLUSIÓN DEL HUMIDIFICADOR O LA TUBERÍA. , EL CUAL CONSTA DE UN SISTEMA VERSATIL Y ESTÉRIL PARA PROPORCIONAR NEBULIZACIÓN FRÍA O CALIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN L A PARTIDA 265.
20	PARTIDA 266	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN NEBULIZADOR PRE-LLENADO DE AGUA ESTERILIZADA "AQUAPAK" DE 760ML, CON ADAPTADORES DE HUMIDIFICADOR INCORPORAN UNA ALARMA AUDIBLE PARA ALERTAR AL MÉDICO SOBRE LA RESTRICCIÓN DEL FLUJO U OCLUSIÓN DEL HUMIDIFICADOR O LA TUBERÍA. , EL CUAL CONSTA DE UN SISTEMA VERSATIL Y ESTÉRIL PARA PROPORCIONAR NEBULIZACIÓN FRÍA O CALIENTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN L A PARTIDA 266.
21	PARTIDA 326	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE EL RANGO QUE DEBE TENER EL MANOMETRO, CONSIDERANDO QUE LOS MANUALES DE RESUCITACION REFIEREN MANEJO DE PRESIONES DE 0 A 60 MMHG. CONSIDERANDO QUE LOS ADITAMENTOS DE SEGURIDAD (MANOMETRO Y VALVULA PEEP) ELEVAN EL PRECIO DEL INSUMO APROXIMADAMENTE EN UN 40%, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE REQUIERE EL INSUMO CON DICHS ADITAMENTOS	APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA PARTIDA 326, PARA PACIENTE ADULTO CON MANEJO DE PRESIONES DEBERA DE SER DE 0 A 60 MMHG.
22	PARTIDA 411	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DOS VIAS, ¿REQUIERE DE CONECTORES? SI ES ASI FAVOR	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA



		DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR QUE DEBERA LLEVAR EL BRAZALETE.	VÍA.
23	PARTIDA 410	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DOS VIAS, ¿REQUIERE DE CONECTORES? SI ES ASI FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR QUE DEBERA LLEVAR EL BRAZALETE.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE BRAZALETES DE UNA VÍA.
24	PARTIDA 427	1.- SUPONEMOS QUE DEBEMOS OFERTAR LA CONEXIÓN A LA TOMA MURAL, EN ESTE SENTIDO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUEN EL TIPO DE TOMA MURAL A LA QUE SE CONECTARAN LOS FLUJÓMETROS.	SE SOLICITA SE SUMINISTRE PARA CONEXION TIPO AGA.
25	PARTIDA 428	1.- SUPONEMOS QUE DEBEMOS OFERTAR LA CONEXIÓN A LA TOMA MURAL, EN ESTE SENTIDO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUEN EL TIPO DE TOMA MURAL A LA QUE SE CONECTARAN LOS FLUJÓMETROS	SE SOLICITA SE SUMINISTRE PARA CONEXION TIPO AGA.

Se informa a los licitantes que cuentan con un plazo de 6 horas para formular y entregar por Compra Net, las preguntas que considere necesarias en relación con las respuestas emitidas, contadas a partir de la publicación de la presente acta en el portal; mismas a las que se les dará contestación el día 27 del mes de octubre del año 2023 a las 11:00 horas, en el portal CompraNet.

En la Ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 11:00 horas, del 27 de octubre de 2023, en la sala de juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Libramiento Poniente I.P.N., sin número San Diego Metepec, Tlaxcala, C.P. 90110; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de continuar con la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro.

De conformidad con el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el acto es presidido por **Dr. Oscar Rolando Ávila Galván**, Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento del IMSS en Tlaxcala, servidor público designado por la convocante del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social Estatal Tlaxcala.

Se hace de conocimiento que no hubo repreguntas a la convocatoria como se muestra a continuación:




GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

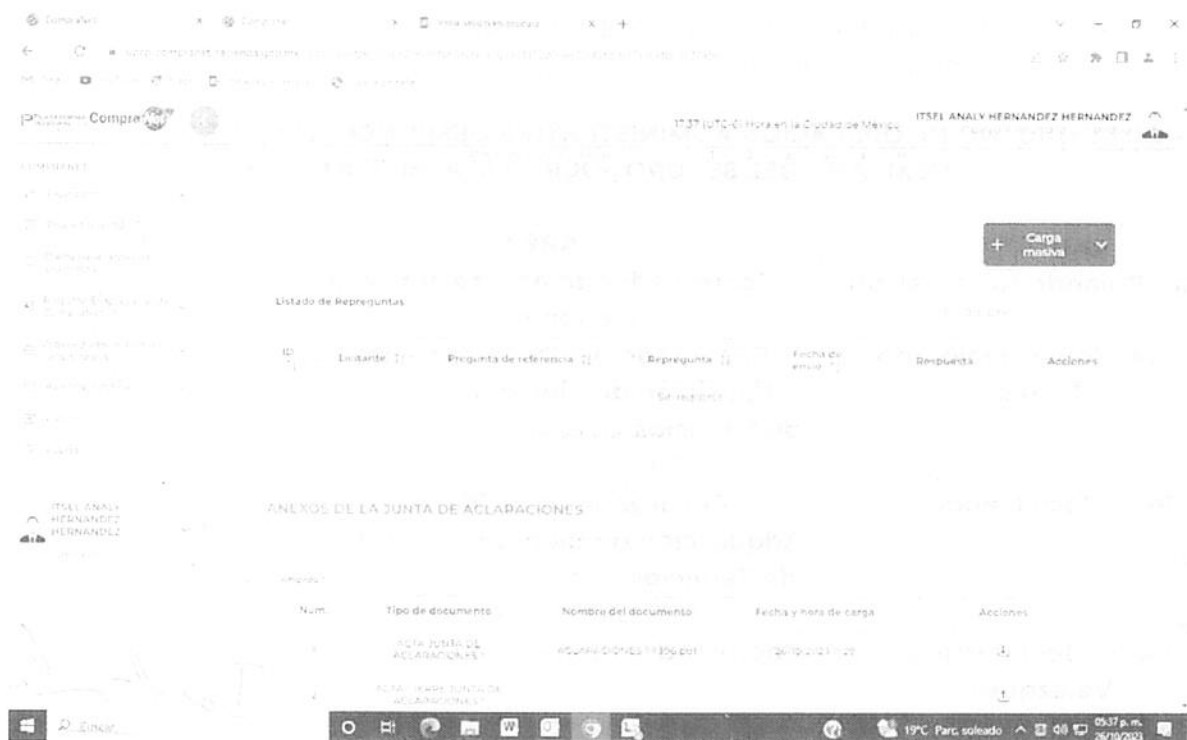

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, en este acto se da a conocer el calendario de los eventos subsecuentes de esta licitación, que a continuación se detalla:

EVENTO	FECHA	HORA
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	03 de noviembre de 2023	11:00 hrs.
Comunicación y entrega de Fallo	09 de noviembre de 2023	11:00 hrs.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley se hace constar que se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: www.upcp-compranet.hacienda.gob.mx para efectos de su notificación. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en: la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Libramiento Poniente I.P.N., sin número San Diego Metepec, Tlaxcala, C.P. 90110; un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta primera y última junta siendo las 11:20 horas del mismo día, mes y año de su inicio.



FO
CONTS 9

Esta Acta consta de 10 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este acto quienes reciben copia de la misma

**POR EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ESTATAL TLAXCALA**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Oscar Rolando Ávila Galván	Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento	
Ángel Hebert Mejorado Torres	Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en términos del Oficio No. 309001050100/537/2023	
Gema José Mendoza	Encargada de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en términos del oficio no. 309001050100/640/2023	
Carlos Joel Barrera Velázquez	Coordinador Biomédico Delegacional	
Itsel Analy Hernández Cortés	Líder de Proyecto	

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
NO ASISTIO REPRESENTACIÓN**

**POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS
NO ASISTIO REPRESENTACIÓN**

----- FIN DEL ACTA -----