



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
LA-050GYR041-E215-2022

ADQUISICIÓN DE BIENES DE SUMINISTRO CLAVES 379, 526, 531, 535 Y 537 PARA LAS
UNIDADES MÉDICAS DEL OOAD IMSS EN TLAXCALA

En la Ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 10:00 horas, del 08 de agosto de 2022, en la sala de juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Libramiento Poniente I.P.N., sin número San Diego Metepec, Tlaxcala, C.P. 90110; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento) así como del numeral 4 de la convocatoria a la licitación.

Este acto fue presidido por **Oscar Rolando Ávila Galván**, Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del IMSS en Tlaxcala, servidor público designado por la convocante del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social Estatal Tlaxcala, quien al inicio de esta junta, hace de conocimiento que derivado de la suspensión temporal del portal de compras gubernamental COMPRANET, el presente procedimiento se retoma de manera presencial, de acuerdo a los "CRITERIOS POR SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SISTEMA COMPRANET" publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el miércoles 20 de julio de la anualidad en curso. Acto seguido comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación de forma presencial en el domicilio de la convocante, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El Presidente del acto, fue asistido por los representantes del área técnica, IBM Carlos Joel Barrera Velazquez, Coordinador Biomédico Delegacional, LEO. Marcela Cuahutle Romano, Enfermera Supervisora en Atención Médica, Dr. Ángel Alberto Olea Rivera, Coordinador Auxiliar de Estomatología quienes solventaron las preguntas de carácter técnico y el representante del área contratante del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, el cual solventó las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, en el domicilio de la convocante, de las siguientes personas:





No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS
1	MALER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y APARATOS MÉDICOS, S.A. DE C.V.	Presencial	6
2	TECNO COMERCIAL PAKTLI, S.A. DE C.V.	Presencial	165
3	CORPORATIVO MS SISTEMAS MÉDICOS, S.A. DE C.V.	Presencial	45

La Convocante realizó las siguientes aclaraciones a la convocatoria a la licitación:

Aclaración número 1.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA, CONDICIONES DE ENTREGA, CALIDAD, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

DICE:

- a) Normas: Oficial Mexicana, Estándar (antes Mexicana), Internacional, de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes o servicios requeridos, conforme a la LIC con base en lo señalado en el numeral 4.28.4 de las presentes POBALINES y, en su caso, el Registro Sanitario correspondiente.

No aplica Normas: Oficial Mexicana para el presente requerimiento.

Para la clave 526.330.0054.00.00 HUMIDIFICADOR FISHER&PAYKEL MR850 se incluya en las propuestas de los participantes se entregue con un Blender (mezclador) para uso neonatal de bajo flujo que permita una mezcla de gases para proporcionar un FiO2 del 21 al 100%, con mangueras de conexión compatibles a las tomas de aire y oxígeno de las unidades médicas y que el blender sea compatible con el sistema de CPAP clave 379.817.0282.00, así mismo deberá de contar con una base rodable, compatible, específico y seguro para montar el humidificador. Por tanto, los participantes deberán de apegarse cabalmente con la descripción anunciada de los bienes, la solicitud anterior no presenta características de alta especialidad técnica, son totalmente estandarizados y no existen diferencias sustanciales entre los existentes en el mercado por lo que no se limita la libre participación, congruencia y competencia económica. Para la clave 379. 817. 0282.00 el Área Técnica determina que la medida será seleccionada por cada unidad médica hospitalaria, derivado a que en la descripción del bien no está anunciada en específico y menciona solo es para paciente lactante.

DEBE DECIR:

- a) Normas: Oficial Mexicana, Estándar (antes Mexicana), Internacional, de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes o servicios requeridos,





conforme a la LIC con base en lo señalado en el numeral 4.28.4 de las presentes POBALINES y, en su caso, el Registro Sanitario correspondiente.

Conforme a lo solicitado en el apartado 2.3. CALIDAD numerales 1, 2, 3 y 4.

Aclaración número 2.

DICE:

2.2. CONDICIONES DE ENTREGA

Entrega de bienes de suministro.- A través de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento (CAE) mediante la verificación, cotejo de las órdenes de remisión y/o reposición en base al calendario de entrega.

Para la clave 526.330.0054.00.00 HUMIDIFICADOR FISHER&PAYKEL MR850 se solicita incluir en la propuesta del participante carta en formato libre hoja membretada y firmada por el representante legal donde el Proveedor se obliga a capacitar para la operación del bien al personal Técnico-médico y de Enfermería sin costo adicional para el Instituto dentro de los 10 días hábiles siguientes al inicio de la entrega del accesorio del equipo médico.

"El proveedor" se coordinará con el Director Médico o Subdirector Administrativo de las Unidades Hospitalarias y/o con el Coordinador Biomédico Delegacional donde serán entregados los accesorios clave 526.330.0054.00.00 a fin de conjuntar acciones encaminadas al cumplimiento a la capacitación solicitada.

DEBE DECIR:

Entrega de bienes de suministro.- A través de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento (CAE) mediante la verificación, cotejo de las órdenes de remisión y/o reposición en base al calendario de entrega.

Para la partida agrupada 1,136 que integra las claves 52633000130001, 37920038440000, 37920038510000, 37920038690000, 52652100380001, 37928801590001, 37960410060001, 37960410140001, 52608105680001, 52676604950001, "El proveedor" adjudicado se obliga hacer la entrega de los bienes en el Hospital General de Zona #1 Tlaxcala donde se coordinará con el Director Médico o Subdirector Administrativo o el Responsable de Bienes de la Unidad Hospitalaria y/o en su caso con el Coordinador Biomédico Delegacional a fin de conjuntar las acciones encaminadas al cumplimiento de la instalación, capacitación y puesta en operación

HGZ#1 Tlaxcala	Av. Universidad s/n Tlaxcala, Tlax CP 90000	Directo 246 46 2 34 24 246 46 2 34 00 Ext. 510	Subdirector Administrativo: Lic. Marco Antonio Ramirez Rodriguez. Jefe de Finanzas: Lic. Gustavo Muñoz Durán
-------------------	---	---	---





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

			Responsable del Control Administrativo de Bienes: Haroldo Contreras García.
--	--	--	--

Aclaración número 3.

DICE:

12.2 GARANTÍA DE LOS BIENES

Se requiere capacitación, solicitar programa para la misma.

Para la clave 526.330.0054.00.00 HUMIDIFICADOR FISHER&PAYKEL MR850 se solicita incluir en la propuesta del participante carta en formato libre hoja membretada y firmada por el representante legal donde el Proveedor se obliga a capacitar para la operación del bien al personal Técnico-médico y de Enfermería sin costo adicional para el Instituto dentro de los 10 días hábiles siguientes al inicio de la entrega del accesorio del equipo médico.

"El proveedor" se coordinará con el Director Médico o Subdirector Administrativo de las Unidades Hospitalarias y/o con el Coordinador Biomédico Delegacional donde serán entregados los accesorios clave 526.330.0054.00.00 a fin de conjuntar acciones encaminadas al cumplimiento a la capacitación solicitada.

DEBE DECIR:

12.2 GARANTÍA DE LOS BIENES

Se requiere capacitación, solicitar programa para la misma.

Para la partida agrupada 1136 que integra las claves 52633000130001, 37920038440000, 37920038510000, 37920038690000, 52652100380001, 37928801590001, 37960410060001, 37960410140001, 52608105680001, 52676604950001, "El proveedor" adjudicado se obliga a proporcionar carta compromiso en formato libre hoja membretada y firmada por el representante legal donde se obliga a capacitar para la operación del sistema conformado por las partidas mencionadas anteriormente, dicha capacitación será proporcionada por personal calificado y dirigido al personal Técnico, Médico, de Enfermería y Conservación del Instituto sin costo adicional la cual se deberá de llevar a cabo dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la entrega de los bienes.

Aclaración número 4.

DICE:

PENAS DEDUCTIVAS.

Concepto u Obligación	Nivel de Servicio	Unidad de medida	Deducción	Límite de Incumplimiento
-----------------------	-------------------	------------------	-----------	--------------------------





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Dpto. De Adquisición de Bienes v Contratación de Servicios

Cuando el proveedor entregue bienes de suministro con fecha de caducidad menor a 12 meses y no realice el canje dentro del plazo establecido.	Entregar los bienes de suministro con un mínimo de 12 meses de caducidad.	Por incumplimiento parcial o total del canje de los bienes de suministro (consumibles) que se encuentren del tiempo establecido de caducidad.	1.0%	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento
Cuando el proveedor entregue bienes de suministro que no corresponden con la especificación técnica o tengan vicios ocultos y no realice el canje dentro del plazo establecido.	Entregar los bienes de suministro que cumplan las especificaciones técnicas.	Por incumplimiento parcial o total del canje de los bienes de suministro (consumibles) que se encuentren del tiempo establecido de caducidad.	1.0%	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento
Cuando no se realice el servicio de mantenimiento preventivo de los bienes de suministro en los que aplique conforme al programa o calendario de mantenimientos preventivos.	Realizar los servicios preventivos conforme al programa o calendario establecido.	Por incumplimiento parcial o total del programa o calendario de mantenimientos preventivos.	1.0%	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento
Cuando el licitante adjudicado no realice las reparaciones necesarias o mantenimientos correctivos de los bienes de suministro que lo requieran.	Realizar los servicios correctivos conforme al plazo de reparación establecido.	Por cada bien de suministro reportado con falla y que no se repare dentro del plazo establecido.	1.0%	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento

DEBE DECIR:

Concepto u Obligación	Nivel de Servicio	Unidad de medida	Deducción	Límite de Incumplimiento
Cuando el proveedor entregue bienes de suministro con fecha de caducidad menor a 12 meses y no realice el canje	Entregar los bienes de suministro con un mínimo de 12 meses de caducidad.	Por incumplimiento parcial o total del canje de los bienes de suministro (consumibles) que se encuentren del tiempo establecido de caducidad.	1.0%	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Dpto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

dentro del plazo establecido.				
Cuando el proveedor no imparta la capacitación de los bienes que aplican instalación, capacitación y puesta en operación conforme a los plazos establecidos.	Efectuar la capacitación para los bienes los bienes que aplican instalación, capacitación y puesta en operación	Por incumplimiento de la impartición de la capacitación requerida.	1.0%	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento
Cuando el proveedor entregue bienes de suministro que no corresponden con la especificación técnica o tengan vicios ocultos y no realice el canje dentro del plazo establecido.	Entregar los bienes de suministro que cumplan las especificaciones técnicas.	Por incumplimiento parcial o total del canje de los bienes de suministro (consumibles) que se encuentren del tiempo establecido de caducidad.	1.0%	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento
Cuando no se realice el servicio de mantenimiento preventivo de los bienes de suministro en los que aplique conforme al programa o calendario de mantenimientos preventivos.	Realizar los servicios preventivos conforme al programa o calendario establecido.	Por incumplimiento parcial o total del programa o calendario de mantenimientos preventivos.	1.0%	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento
Cuando el licitante adjudicado no realice las reparaciones necesarias o mantenimientos correctivos de los bienes de suministro que lo requieran.	Realizar los servicios correctivos conforme al plazo de reparación establecido.	Por cada bien de suministro reportado con falla y que no se repare dentro del plazo establecido.	1.0%	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento





Aclaración número 5

DICE:

2.1. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

Entrega de bienes de suministro.- A través de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento (CAE) mediante la verificación, cotejo de las órdenes de remisión y/o reposición en base al calendario de entrega.

La vigencia del contrato será del día posterior hábil al fallo hasta el 31 de diciembre de 2022.

Primera Entrega.- El 50% de los bienes adjudicados deberán de entregarse en un periodo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de la emisión del fallo.

Segunda Entrega.- El 50% de los bienes adjudicados deberán de entregarse en un periodo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente a la primera fecha de entrega.

DEBE DECIR:

2.1. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

Entrega de bienes de suministro.- A través de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento (CAE) mediante la verificación, cotejo de las órdenes de remisión y/o reposición en base al calendario de entrega.

La vigencia del contrato será del día posterior hábil al fallo hasta el 31 de diciembre de 2022.

Primera Entrega.- El 50% de los bienes adjudicados deberán de entregarse en un periodo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de la emisión del fallo.

Segunda Entrega.- El 50% de los bienes adjudicados deberán de entregarse en un periodo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente a la primera fecha de entrega.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:





Licitante: MALER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y APARATOS MÉDICOS, S.A. DE C.V.

PREGUNTA	PUNTO O NUMERAL	ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS
1	2.3. CALIDAD, NUMERAL 9, 7ª Y 8ª VIÑETA	PUNTO DE REFERENCIA DE LAS BASES: 2.3. CALIDAD, NUMERAL 9, 7ª Y 8ª VIÑETA, EL PROVEEDOR DEBERÁ ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LOS DOS ESCRITOS QUE SE SOLICITAN EN LAS DOS VIÑETAS DE REFERENCIA, LAS PRESENTARÁ EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR? FAVOR DE ACLARAR	LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA A EVALUAR TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL APARTADO 2.3. CALIDAD ESTO INCLUYENDO LO REFERIDO EN EL NUMERAL 9 7ª Y 8ª VIÑETA.
2	2.4. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS, FRACCIÓN II, COPIA DE LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PATRONAL ANTEL EL IMSS E INFONAVIT.	PUNTO DE REFERENCIA DE LAS BASES: 2.4. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS, FRACCIÓN II, COPIA DE LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PATRONAL ANTEL EL IMSS E INFONAVIT. ENTENDEMOS QUE POR TRATARSE DEL MISMO NÚMERO ANTE EL IMSS E INFONAVIT, PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN ÉSTE PUNTO, ES SÓLO UNA TARJETA DE IDENTIFICACION QUE SE PRESENTA Y NO SE TRATA DE DOS DOCUMENTOS DIFERENTES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ ENTREGAR TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PATRONAL ANTE EL IMSS.
3	3.2. FECHA, HORA Y DOMICILIO DE EVENTOS.	PUNTO DE REFERENCIA DE LAS BASES: 3.2. FECHA, HORA Y DOMICILIO DE EVENTOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI SE DARÁ UN TIEMPO RAZONABLE PARA REALIZAR RE-PREGUNTAS A LA PRIMERA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. FAVOR DE ACLARAR.	UNA VEZ QUE LA CONVOCANTE TERMINE DE DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, SE DARÁ INMEDIATAMENTE OPORTUNIDAD A LOS LICITANTES PARA QUE, EN EL MISMO ORDEN DE LOS PUNTOS O APARTADOS DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA EN QUE SE DIO RESPUESTA, FORMULEN LAS PREGUNTAS QUE ESTIMEN PERTINENTES EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS, EN TÉRMINOS DEL TERCER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES,





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

			ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
4	3.2. FECHA, HORA Y DOMICILIO DE EVENTOS.	PUNTO DE REFERENCIA DE LAS BASES: 3.2. FECHA, HORA Y DOMICILIO DE EVENTOS. EN EL CASO DE QUE LA JUNTA DE ACLARACIONES SE POSTERGUE, ENTENDEMOS QUE EL CALENDARIO DE EVENTOS TENDRÁ MODIFICACIÓN EN FECHAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EN CASO DE QUE LA JUNTA DE ACLARACIONES SE EXTIENDA POR LA COMPLEJIDAD Y/O EXTENSIÓN DEL NÚMERO DE PREGUNTAS REALIZADAS POR LOS LICITANTES, SE DARÁ A CONOCER EL CALENDARIO DE EVENTOS SUBSECUENTES.
5	PUNTO 6.2. PROPUESTA TÉCNICA, FRACCIÓN I. ANEXO NÚMERO 2A (DOS A)	PUNTO DE REFERENCIA DE LAS BASES: PUNTO 6.2. PROPUESTA TÉCNICA, FRACCIÓN I. ANEXO NÚMERO 2A (DOS A) ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SÍ EL ANEXO 2A (DOS A) FORMATO EN EXCEL, SE DEBERÁ PRESENTAR COMO COMPLEMENTO PARA LA PROPUESTA TÉCNICA, DEBIDAMENTE REQUISITADO CON LAS PARTIDAS QUE MÍ REPRESENTADA ESTÉ INTERESADA EN PARTICIPAR? FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, COMO PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR EL ANEXO 2A (DOS A) DEBIDAMENTE REQUISITADO PARA LAS PARTIDAS CON LAS QUE PARTICIPARAN.
6	ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ) PROPUESTA ECONÓMICA.	PUNTO DE REFERENCIA DE LAS BASES: ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ) PROPUESTA ECONÓMICA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SÍ ES CORRECTO AGREGAR AL ANEXO DE REFERENCIA, UNA COLUMNA DESPUÉS DE LA PRIMERA COLUMNA "PARTIDA" PARA INDICAR LA CLAVE A 14 DÍGITOS DE BIEN A OFERTAR. ¿FAVOR DE ACLARAR?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

Licitante: TECNO COMERCIAL PAKTLI S.A. DE C.V.

PREGUNTA	PUNTO O NUMERAL	ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS
1	2.1 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA	DE ACUERDO AL PUNTO 2.1 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA QUE MENCIONA: PRIMERA ENTREGA.- EL 50% DE LOS BIENES ADJUDICADOS DEBERÁN DE ENTREGARSE EN UN PERIODO DE 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA	REFERIRSE A LA ACLARATORIA NÚMERO 5 DE LA CONVOCANTE: PRIMERA ENTREGA.- EL 50% DE LOS BIENES ADJUDICADOS DEBERÁN





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		SIGUIENTE HÁBIL DE LA EMISIÓN DEL FALLO. SEGUNDA ENTREGA.- EL 50% DE LOS BIENES ADJUDICADOS DEBERÁN DE ENTREGARSE EN UN PERIODO DE 30 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA PRIMERA FECHA DE ENTREGA ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI PARA AQUELLOS INSUMOS DE IMPORTACIÓN SE PUEDEN EMITIR ORDENES DE REPOSICIÓN? Ó BIEN QUE LA PRIMERA ENTREGA SEA A LOS 30 DÍAS.	DE ENTREGARSE EN UN PERIODO DE 30 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL DE LA EMISIÓN DEL FALLO.
2	ANEXO NÚMERO 2 A (DOS A)	EL ANEXO NÚMERO 2 A (DOS A) ¿TENDRA QUE SER REQUISITADO E INCLUIRLO EN LA PROPUESTA?	COMO PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR EL ANEXO 2A (DOS A) DEBIDAMENTE REQUISITADO PARA LAS PARTIDAS CON LAS QUE PARTICIPARAN.
3		DICE: EN EL CASO DE SER DISTRIBUIDOR DEBERÁ PRESENTAR EN FORMATO LIBRE CARTA DE APOYO POR PARTE DEL FABRICANTE, DISTRIBUIDOR PRIMARIO, O MAYORISTA, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O COMERCIAL EN HOJA MEMBRETADA. PREGUNTA: DADO LOS TIEMPOS DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL ¿SE ACEPTAN IMPRESIONES DE LAS CARTAS DE APOYO DE LOS FABRICANTES TAL COMO SE HACE AHORA EN COMPRANET?	COMO PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR EN FORMATO LIBRE CARTA DE APOYO POR PARTE DEL FABRICANTE, DISTRIBUIDOR PRIMARIO, O MAYORISTA, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O COMERCIAL EN HOJA MEMBRETADA, DICHAS CARTAS SE ACEPTAN IMPRESAS.
4		DICE: SE REQUIEREN DE MANUALES, FICHAS TÉCNICAS, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y FOTOGRAFÍAS NECESARIOS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR ÚNICAMENTE LA PORTADA DEL CATÁLOGO Y LA PÁGINA DONDE SE ENCUENTRE EL INSUMO (DEBIDAMENTE REFERENCIADO) SIN TENER QUE PRESENTAR TODO EL CATÁLOGO CON FINES DE NO DESPERDICIO DE HOJAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PODER PRESENTAR PORTADA Y HOJAS DE MANUALES, FICHAS TÉCNICAS, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y FOTOGRAFÍAS DONDE SE ENCUENTRE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL BIEN DE SUMINISTRO A OFERTAR SIEMPRE Y CUANDO LA INFORMACIÓN ESTÉ REFERENCIADA, PERMITA VERIFICAR Y CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

			CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE. LO ANTERIOR, NO ES OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
1	ANEXO 1	PARTIDA 79 37917120070002 PARA QUE PUEDA COMPLETARSE EL CIRCUITO DE CPAP, ES NECESARIO QUE SE INCLUYAN LOS DOS TUBOS CORRUGADOS, TAMAÑO NEONATAL Y LÍNEA DE MONITOREO DE PRESIÓN PROXIMAL ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LA SOLICITUD DESCRITA DE LA PARTIDA 79.
2	ANEXO 1	PARTIDA 80 37917120150002 PARA QUE PUEDA COMPLETARSE EL CIRCUITO DE CPAP, ES NECESARIO QUE SE INCLUYAN LOS DOS TUBOS CORRUGADOS, TAMAÑO NEONATAL Y LÍNEA DE MONITOREO DE PRESIÓN PROXIMAL ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LA SOLICITUD DESCRITA DE LA PARTIDA 80.
3	ANEXO 1	PARTIDA 81 37917120310002 PARA QUE PUEDA COMPLETARSE EL CIRCUITO DE CPAP, ES NECESARIO QUE SE INCLUYAN LOS DOS TUBOS CORRUGADOS, TAMAÑO NEONATAL Y LÍNEA DE MONITOREO DE PRESIÓN PROXIMAL ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LA SOLICITUD DESCRITA DE LA PARTIDA 81.
4	ANEXO 1	PARTIDA 90 37920006750002 PARA EVITAR QUE LA CONDENSACIÓN GENERADA POR LA HUMIDIFICACIÓN TÉRMICA LLEGUE AL PACIENTE ES NECESARIO QUE EL CIRCUITO CUENTE CON TRAMPAS DE AGUA ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LA SOLICITUD DESCRITA DE LA PARTIDA 90.
5	ANEXO 1	PARTIDA 91 37920007170001 PARA EVITAR QUE LA CONDENSACIÓN GENERADA POR LA HUMIDIFICACIÓN TÉRMICA LLEGUE AL PACIENTE ES NECESARIO QUE EL CIRCUITO CUENTE CON TRAMPAS DE AGUA ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LA SOLICITUD DESCRITA DE LA PARTIDA 91
6	ANEXO 1	PARTIDA 92 37920014590001 EL CIRCUITO SOLICITADO DEBE SER COMPATIBLE CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL MODELO MR 850 ¿ES CORRECTO?	EL CIRCUITO SOLICITADO DEBERÁ SER COMPATIBLE CON EL HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL MODELO MR 850.
7	ANEXO 1	PARTIDA 92	NO ES CORRECTA SU

Libramiento Poniente Av. Politécnico Nacional S/N, C.P. 90110, San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlax., Teléfono 246 46 80492



FO CON-08-11

2022 Ricardo
Flores
Año de
Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Dpto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		37920014590001 PARA EVITAR QUE LA CONDENSACIÓN GENERADA POR LA HUMIDIFICACIÓN TÉRMICA LLEGUE AL PACIENTE ES NECESARIO QUE EL CIRCUITO CUENTE CON TRAMPAS DE AGUA ¿ES CORRECTO?	APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LA SOLICITUD DESCRITA DE LA PARTIDA 92
8	ANEXO 1	PARTIDA 94 37920019700002 PARA EVITAR QUE LA CONDENSACIÓN GENERADA POR LA HUMIDIFICACIÓN TÉRMICA LLEGUE AL PACIENTE ES NECESARIO QUE EL CIRCUITO CUENTE CON TRAMPAS DE AGUA ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
9	ANEXO 1	PARTIDA 95 37920021350000 (1) PARA EVITAR QUE LA CONDENSACIÓN GENERADA POR LA HUMIDIFICACIÓN TÉRMICA LLEGUE AL PACIENTE ES NECESARIO QUE EL CIRCUITO CUENTE CON TRAMPAS DE AGUA ¿ES CORRECTO? (2) PARA QUE PUEDA COMPLETARSE EL CIRCUITO DE HUMIDIFICACIÓN DEL GAS PROPORCIONADO AL PACIENTE, ES NECESARIO QUE EL CIRCUITO INCLUYA LÍNEA PARA CONECTAR EL VENTILADOR CON LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN (COMPLETAR LA CASCADA) ¿ES CORRECTO? (3) PARA ASEGURAR QUE LA TEMPERATURA PROPORCIONADA POR EL HUMIDIFICADOR ES LA ADECUADA, EL CIRCUITO DEBERÁ CONTENER PUERTOS PARA LA COLOCACIÓN DEL SENSOR DUAL (SENSOR DE TEMPERATURA DISTAL Y PROXIMAL) ¿ES CORRECTO? (4) PARA QUE EL VENTILADOR PUEDA SENSAR EL DIFERENCIAL DE PRESIÓN DEL PACIENTE, ES NECESARIO QUE EL CIRCUITO CUENTE CON LÍNEA DE PRESIÓN PROXIMAL. ¿ES CORRECTO?	1) ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL CIRCUITO DEBERÁ DE CONTAR CON TRAMPAS DE AGUA EN AMBAS RAMAS (INSPIRATORIA Y EXHALATORIA. 2) ES CORRECTA SU APRECIACIÓN 3) ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. 4) ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
10	ANEXO 1	PARTIDA 96 37920021680001 (1) EL CIRCUITO SOLICITADO DEBE CONTAR CON VÁLVULA EXHALACIÓN UNIDIRECCIONAL DESECHABLE ¿ES CORRECTO? (2) PARA QUE EL VENTILADOR PUEDA SENSAR EL DIFERENCIAL DE PRESIÓN DEL PACIENTE, ES NECESARIO QUE EL CIRCUITO CUENTE CON LÍNEA DE	1). ES CORRECTA SU APRECIACIÓN EL CIRCUITO DEBERÁ DE CONTAR CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN DESECHABLE. 2) ES CORRECTA SU APRECIACIÓN EL CIRCUITO DEBERÁ DE CONTAR CON LÍNEA DE PRESIÓN





		PRESIÓN PROXIMAL. ¿ES CORRECTO? (3) PARA CONTROLAR LOS MOMENTOS ESPIRATORIOS DEL VENTILADOR, ES NECESARIO QUE EL CIRCUITO CUENTE CON LÍNEA PARA CONTROL DE LA VÁLVULA EXHALATORIA ¿ES CORRECTO? (4) PARA FACILITAR EL CONTROL Y LA OPERACIÓN DE UN TRASLADO INTRAHOSPITALARIO, ES NECESARIO EL CIRCUITO SEA DE UNA SOLA RAMA ¿ES CORRECTO?	PROXIMAL. 3) ES CORRECTA SU APRECIACIÓN EL CIRCUITO DEBERÁ DE CONTAR. 4) ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
11	ANEXO 1	PARTIDA 123 37936016200001 (1) PARA EVITAR LA LLEGADA DE PARTÍCULAS INDESEABLES COMO VIRUS Y BACTERIAS AL PACIENTE ES NECESARIO QUE LA EFICACIA BACTERIANA Y VIRAL DEL FILTRO SEA DE 99.99%¿ES CORRECTO?	1) ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
12	ANEXO 1	PARTIDA 346 52610000290001 (1) PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA GENERADA POR INFECCIONES NOSOCOMIALES EL CIRCUITO OFERTADO DEBERÁ SER DESECHABLE ¿ES CORRECTO? (2) PARA EVITAR QUE LA CONDENSACIÓN GENERADA POR LA HUMIDIFICACIÓN TÉRMICA LLEGUE AL PACIENTE ES NECESARIO QUE EL CIRCUITO CUENTE CON TRAMPAS DE AGUA ¿ES CORRECTO? (3) PARA QUE PUEDA COMPLETARSE EL CIRCUITO DE HUMIDIFICACIÓN DEL GAS PROPORCIONADO AL PACIENTE, ES NECESARIO QUE EL CIRCUITO INCLUYA LÍNEA PARA CONECTAR EL VENTILADOR CON LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN (COMPLETAR LA CASCADA) ¿ES CORRECTO? (4) PARA QUE EL VENTILADOR PUEDA SENSAR EL DIFERENCIAL DE PRESIÓN DEL PACIENTE, ES NECESARIO QUE EL CIRCUITO CUENTE CON LÍNEA DE PRESIÓN PROXIMAL. ¿ES CORRECTO?	1). NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LA SOLICITUD DESCRITA (CIRCUITO REUTILIZABLE) DE LA PARTIDA 346. 2) NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LA SOLICITUD DESCRITA DE LA PARTIDA 346. 3) NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LA SOLICITUD DESCRITA DE LA PARTIDA 346. 4) NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LA SOLICITUD DESCRITA DE LA PARTIDA 346.
13	ANEXO 1	PARTIDA 347 52610000370001 (1) PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA GENERADA POR INFECCIONES NOSOCOMIALES EL CIRCUITO OFERTADO DEBERÁ SER DESECHABLE ¿ES CORRECTO? (2) PARA EVITAR QUE LA CONDENSACIÓN GENERADA POR LA	1). NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LA SOLICITUD DESCRITA (CIRCUITO REUTILIZABLE) DE LA PARTIDA 347. 2) NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		HUMIDIFICACIÓN TÉRMICA LLEGUE AL PACIENTE ES NECESARIO QUE EL CIRCUITO CUENTE CON TRAMPAS DE AGUA ¿ES CORRECTO?	APEGARSE A LA SOLICITUD DESCRITA DE LA PARTIDA 347.
14	ANEXO 1	PARTIDA 425 53115700960201 (1) SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL TAMAÑO O RANGO DE PESO DEL TIPO DE PACIENTE EN EL QUE SE USARA LA CÁMARA CEFÁLICA SOLICITADA. (2) PARA DAR UNA TERAPIA EFECTIVA ES NECESARIO QUE LA CÁMARA CEFÁLICA CUENTE CON UN DIFUSOR DE GASES EL CUAL PERMITE QUE SE REALICE UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DEL GAS POR TODA LA CÁMARA GARANTIZANDO QUE CUANDO EL PACIENTE INHALE, SIEMPRE HAYA A SU DISPOSICIÓN GAS FRESCO, ¿ES CORRECTO?	1) PARA LA PARTIDA 425 SE SOLICITA QUE EL TAMAÑO DE LA CÁMARA CEFÁLICA SEA PARA NEONATAL. 2) NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LA SOLICITUD DESCRITA DE LA PARTIDA 425.
15	ANEXO 1	PARTIDA 1 379-017-1981-00-01 ¿SE PODRÁ OFERTAR UNA MARCA DIFERENTE A NIHON KOHDEN?	SE ACEPTA SU SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO EL BIEN DE SUMINISTRO SEA COMPATIBLE Y FUNCIONAL, LO ANTERIOR NO ES OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
16	ANEXO 1	PARTIDA 2 379-017-2724-00-01 ¿SERÁ CORRECTO OFERTAR ABREBOCAS TIPO TIJERA? COMO EL DE LA SIGUIENTE IMAGEN? 	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN LA PARTIDA 2.
17	ANEXO 1	PARTIDA 11 379-095-0293-00-01 ¿SERÁ CORRECTO OFERTAR BATERÍA RECARGABLE? SI ES ASÍ, FAVOR DE MENCIONAR QUE TIPO DE BATERÍA: AA, AAA.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA DE LA PARTIDA 11.
18	ANEXO 1	PARTIDA 12 379-095-0327-00-01 ¿SERÁ CORRECTO OFERTAR BATERÍA RECARGABLE? SI ES ASÍ FAVOR DE MENCIONAR QUE TIPO DE BATERÍA: AA, AAA.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA DE LA PARTIDA 12.
19	ANEXO 1	PARTIDA 13 379-095-0335-00-01	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, APEGARSE A





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Dpto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		¿SERÁ CORRECTO OFERTAR BATERÍA RECARGABLE? SI ES ASÍ FAVOR DE MENCIONAR QUE TIPO DE BATERÍA: AA, AAA.	LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA DE LA PARTIDA 13.
20	ANEXO 1	PARTIDA 14 379-095-0558-00-00 ¿ACEPTAN MARCA EVEREADY GOLD?	SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
21	ANEXO 1	PARTIDA 15 379-095-0566-00-00 ¿ACEPTAN MARCA EVEREADY GOLD?	SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
22	ANEXO 1	PARTIDA 16 379-095-0574-00-00 ¿EN CASO DE SER ADJUDICADOS EL ALMACÉN NOS PODRÍA RECIBIR EN LA PRESENTACIÓN ORIGINAL DEL FABRICANTE, ES DECIR POR BLÍSTER DE 2 O 4 PIEZAS?	SE ACEPTA SU SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO SE ENTREGUE LA CANTIDAD DE 6 PIEZAS DESCRITA EN LA PARTIDA 16, LO ANTERIOR SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
23	ANEXO 1	PARTIDA 18 379-095-0590-00-00 ¿EN CASO DE SER ADJUDICADOS EL ALMACÉN NOS PODRÍA RECIBIR EN LA PRESENTACIÓN ORIGINAL DEL FABRICANTE, ES DECIR POR BLÍSTER DE 2 O 4 PIEZAS ?	SE ACEPTA SU SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO SE ENTREGUE LA CANTIDAD TOTAL DE PIEZAS SOLICITADAS DE LA PARTIDA 18, LO ANTERIOR SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
24	ANEXO 1	PARTIDA 32 379-107-0109-01-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DOS VIAS, ¿REQUIERE DE CONECTORES ?	PARA LA PARTIDA 32 SE SOLICITA SEA BRAZALETE DE DOS VIAS SIN CONECTORES.
25	ANEXO 1	PARTIDA 33 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DOS VIAS, ¿REQUIERE DE CONECTORES, DE QUE TIPO? ¿ACEPTAN BRAZALETES DE 25-35 CM?	PARA LA PARTIDA 33 SE SOLICITA SEA BRAZALETE DE DOS VIAS SIN CONECTORES Y SE ACEPTAN BRAZALETES DE 25-35 CM, ESTE ÚLTIMO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
26	ANEXO 1	PARTIDA 34 379-107-0056-00-01 ¿REQUIERE DE CONECTORES? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN BRAZALETE DE 4 - 8 CM DE CIRCUNFERENCIA Y 3.8CM DE ANCHO.	SE ACEPTA PODER OFERTAR UN BRAZALETE DE 4-8 CM CON CIRCUNFERENCIA DE 3.8 CM, NO SE REQUIERE DE CONECTORES, LO ANTERIOR NO ES OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
27	ANEXO 1	PARTIDA 35 379-107-1164-00-01 ¿REQUIERE DE CONECTORES? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN BRAZALETE DE 3 - 6 CM DE CIRCUNFERENCIA Y 3.2 CM DE ANCHO.	SE ACEPTA PODER OFERTAR UN BRAZALETE DE 3-6 CM CON CIRCUNFERENCIA DE 3.2 CM, NO SE REQUIERE DE CONECTORES, LO ANTERIOR NO ES OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
28	ANEXO 1	PARTIDA 36 379-107-1172-00-01 ¿REQUIERE DE CONECTORES?	SE ACEPTA PODER OFERTAR UN BRAZALETE DE 3-6 CM CON CIRCUNFERENCIA DE



FO CON-08-15

2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN BRAZALETE DE 3 - 6 CM DE CIRCUNFERENCIA Y 3.2 CM DE ANCHO.	3.2 CM, NO SE REQUIERE DE CONECTORES, LO ANTERIOR NO ES OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
29	ANEXO 1	PARTIDA 37 379-107-1180-00-01 ¿REQUIERE DE CONECTORES? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN BRAZALETE DE 3 - 6 CM DE CIRCUNFERENCIA Y 3.2 CM DE ANCHO.	SE ACEPTA PODER OFERTAR UN BRAZALETE DE 3-6 CM CON CIRCUNFERENCIA DE 3.2 CM, NO SE REQUIERE DE CONECTORES, LO ANTERIOR NO ES OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
30	ANEXO 1	PARTIDA 38 379-107-1198-00-01 ¿REQUIERE DE CONECTORES? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN BRAZALETE DE 3 - 6 CM DE CIRCUNFERENCIA Y 3.2 CM DE ANCHO.	SE ACEPTA PODER OFERTAR UN BRAZALETE DE 3-6 CM CON CIRCUNFERENCIA DE 3.2 CM, NO SE REQUIERE DE CONECTORES, LO ANTERIOR NO ES OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
31	ANEXO 1	PARTIDA 39 379-107-1206-00-01 ¿REQUIERE DE CONECTORES? SI LA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN BRAZALETE DE 4 - 8 CM DE CIRCUNFERENCIA Y 3.8CM DE ANCHO.	SE ACEPTA PODER OFERTAR UN BRAZALETE DE 4-8 CM CON CIRCUNFERENCIA DE 3.8 CM, NO SE REQUIERE DE CONECTORES, LO ANTERIOR NO ES OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
32	ANEXO 1	PARTIDA 40 379-107-1214-00-01 ¿REQUIERE DE CONECTORES? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN BRAZALETE DE 4 - 8 CM DE CIRCUNFERENCIA Y 3.8CM DE ANCHO.	SE ACEPTA PODER OFERTAR UN BRAZALETE DE 4-8 CM CON CIRCUNFERENCIA DE 3.8 CM, NO SE REQUIERE DE CONECTORES, LO ANTERIOR SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
33	ANEXO 1	PARTIDA 41 379-107-1222-00-01 ¿REQUIERE DE CONECTORES? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN BRAZALETE DE 6 - 11 CM DE CIRCUNFERENCIA Y 5CM DE ANCHO.	SE ACEPTA PODER OFERTAR UN BRAZALETE DE 6-11 CM CON CIRCUNFERENCIA DE 5 CM, NO SE REQUIERE DE CONECTORES, LO ANTERIOR NO ES OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
34	ANEXO 1	PARTIDA 42 379-107-1230-00-01 ¿REQUIERE DE CONECTORES? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN BRAZALETE DE 6 - 11 CM DE CIRCUNFERENCIA Y 5CM DE ANCHO.	SE ACEPTA PODER OFERTAR UN BRAZALETE DE 6-11 CM CON CIRCUNFERENCIA DE 5 CM, NO SE REQUIERE DE CONECTORES, LO ANTERIOR NO ES OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
35	ANEXO 1	PARTIDA 43 379-107-1248-00-01 ¿REQUIERE DE CONECTORES? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN BRAZALETE DE 6 - 11 CM DE CIRCUNFERENCIA Y 5CM DE ANCHO.	SE ACEPTA PODER OFERTAR UN BRAZALETE DE 6-11 CM CON CIRCUNFERENCIA DE 5 CM, NO SE REQUIERE DE CONECTORES, LO ANTERIOR NO ES OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
36	ANEXO 1	PARTIDA 47	SE ACEPTA PODER OFERTAR



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		379-107-1354-00-01 ¿SERÁ CORECTO OFERTAR BRAZALETE DE 25-35 CM SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DOS VIAS, ¿REQUIERE DE CONECTORES, DE QUE TIPO?	UN BRAZALETE DE 25-35 CM, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SE REQUIERE BRAZALETE DE UNA VÍA CONECTOR METÁLICO PARA EL MONITOR MARCA MEDICA D MODELO VITA CARE 2000.
37	ANEXO 1	PARTIDA 48 379-107-1362-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DOS VIAS, ¿REQUIERE DE CONECTORES, DE QUE TIPO?	SE ACEPTA PODER OFERTAR UN BRAZALETE DE 25-35 CM, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SE REQUIERE DE CONECTOR METÁLICO PARA EL MONITOR MARCA MEDICA D MODELO VITA CARE 2000.
38	ANEXO 1	PARTIDA 49 379-107-1677-00-01 ¿REQUIERE DE CONECTORES?	SI SE REQUIERE DE CONECTORES PARA LA PARTIDA 49.
39	ANEXO 1	PARTIDA 50 379-107-2600-00-00 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DOS VIAS, ¿REQUIERE DE CONECTORES, DE QUE TIPO?	PARA LA PARTIDA 50 SE REQUIERE BRAZALETE DE UNA SOLA VÍA SIN CONECTORES.
40	ANEXO 1	PARTIDA 53 379-107-2881-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DOS VIAS, ¿REQUIERE DE CONECTORES, DE QUE TIPO?	PARA LA PARTIDA 53 SE REQUIERE BRAZALETE DE UNA SOLA VÍA SIN CONECTORES.
41	ANEXO 1	PARTIDA 54 379-107-2899-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DOS VIAS, ¿REQUIERE DE CONECTORES, DE QUE TIPO?	PARA LA PARTIDA 54 SE REQUIERE BRAZALETE DE UNA SOLA VÍA SIN CONECTORES.
42	ANEXO 1	PARTIDA 55 379-107-2907-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DOS VIAS, ¿REQUIERE DE CONECTORES, DE QUE TIPO?	PARA LA PARTIDA 55 SE REQUIERE BRAZALETE DE UNA SOLA VÍA SIN CONECTORES.



FO CON-08-17

2022 **Ricardo Flores**
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

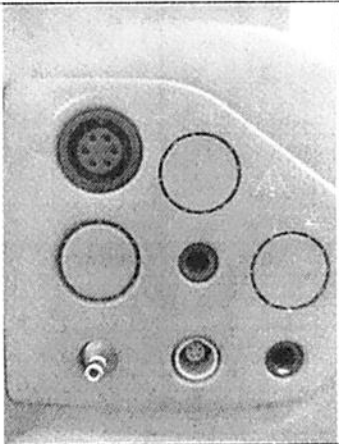
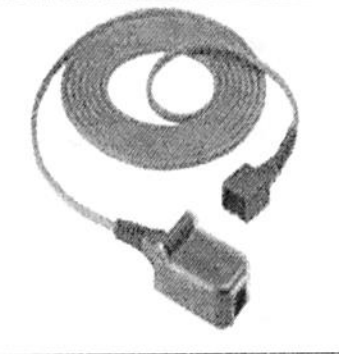


GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

43	ANEXO 1	PARTIDA 67 379-156-4554-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE UNA FOTO DE LA ENTRADA DEL MONITOR, DEBIDO A LAS DIVERSAS GENERACIONES QUE EXISTEN	
44	ANEXO 1	PARTIDA 69 379-156-8425-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE UNA FOTO DE LA ENTRADA DEL MONITOR, DEBIDO A LAS DIVERSAS GENERACIONES QUE EXISTEN	
45	ANEXO 1	PARTIDA 78 379-171-1355-00-01 PODRÍAN ESPECIFICAR EL TAMAÑO MEDIANO SOLICITADO A QUE TIPO DE PACIENTE CORRESPONDE PREMATURO, NEONATO, INFANTE, INTERMEDIO Y PEDIÁTRICO.	SE SOLICITA PARA LA PARTIDA 78 EL TAMAÑO MEDIANO SEA PARA PACIENTE NEONATO.
46	ANEXO 1	PARTIDA 97 379-200-2903-00-01 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE REQUIERE CIRCUITO "REUSABLE"?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE REQUIERE DE UN CIRCUITO REUSABLE.
47	ANEXO 1	PARTIDA 98 379-200-2911-00-01 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE REQUIERE CIRCUITO "REUSABLE"?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE REQUIERE DE UN CIRCUITO REUSABLE.
48	ANEXO 1	PARTIDA 110 379-288-0159-00-01 ¿SE REQUIERE OFERTAR CON CONECTOR TIPO PURITAN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE REQUIERE DE TIPO PURITAN HEXAGONAL.
49	ANEXO 1	PARTIDA 122 379-329-0010-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR OTRA MARCA DIFERENTE A WELCH ALLYN SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE.	SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
50	ANEXO 1	PARTIDA 123	PARA LA PARTIDA 123 SE



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		379-360-1620-00-01 ¿SERÁ CORRECTO OFERTAR UN FILTROFILTRO BACTERIANO VIRAL DE FLUJO PRINCIPAL. MARCA HUDSON RCI DE 22MM I.D. X 15MM I.D./22MM O.D. EFICACIA BACTERIAL 99.999%; EFICACIA VIRAL 99.99% ESPACIO MUERTO DE 42 ML. LA RESISTENCIA DE FLUJO DE APROXIMADA 1,5 CM H2O A 60 LPM.	PUEDE OFERTAR EL FILTRO BACTERIANO VIRAL DE OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SEA IGUAL A LA DEL FILTRO SOLICITADO, LO ANTERIOR NO ES OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
51	ANEXO 1	PARTIDA 167 379-436-0077-00-01 1.- SUPONEMOS QUE DEBEMOS OFERTAR LA CONEXIÓN A LA TOMA MURAL DE AIRE, EN ESTE SENTIDO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUEN EL TIPO DE TOMA MURAL A LA QUE SE CONECTARAN LOS GENERADORES DE SUCCIÓN. 2.-¿ REQUIERE LA CONVOCANTE QUE EL DISPOSITIVO TENGA MANÓMETRO INTEGRADO?	1) SE REQUIERE CONEXIÓN DE TIPO DE AGA ENROSCABLE CON SEGURO. 2) NO SE REQUIERE DE MANÓMETRO.
52	ANEXO 1	PARTIDA 168 379-437-1777-00-02 ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE REQUIERE JERINGA DE 200 ML CON TUBO CONECTOR DE 1500 MM Y TUBO DE LLENADO COMO EL DE LA SIGUIENTE FOTO:	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA LA PARTIDA 168 SE REQUIERE DE LA JERINGA DE 200 ML CON TUBO CONECTOR Y TUBO DE LLENADO LOS CUALES DEBERÁN DE SER COMPATIBLES CON EL INYECTOR MARCA NEMOTO MODELO ALPHA 7.





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		 200ml Product code: 7.20.01.0063 Application: Nemoto A-60 Single Standard configuration: 1- 200ml Syringe 1- 1500mm Connecting Tube 1- Fill Tube	
53	ANEXO 1	PARTIDA 174 ¿LA CONVOCANTE REQUIERE UNICAMENTE LOS INSERTOS PARA CAVITRÓN? Ó REQUIERE ÚNICAMENTE LAS PUNTAS PARA CAVITRÓN, SE COMPARTEN IMÁGENES DE CADA UNO.  INSERTO PARA CAVITRÓN	PARA LA PARTIDA 174 SE REQUIERE OFERTAR PUNTAS PARA CAVITRÓN.



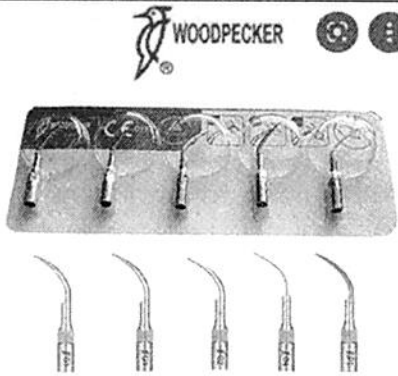
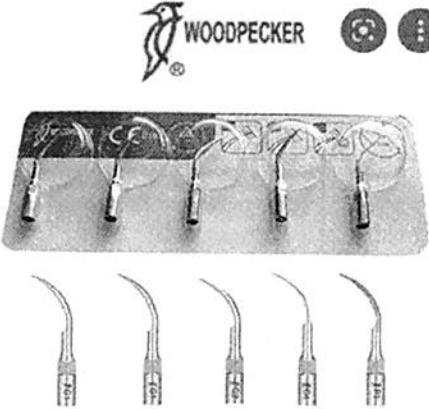


GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		 PUNTAS PARA CAVITRÓN.	
54	ANEXO 1	PARTIDA 175 ¿LA CONVOCANTE REQUIERE ÚNICAMENTE LOS INSERTOS PARA CAVITRÓN? Ó REQUIERE ÚNICAMENTE LAS PUNTAS PARA CAVITRÓN, SE COMPARTEN IMÁGENES DE CADA UNO.  INSERTO PARA CAVITRÓN  PUNTAS PARA CAVITRÓN.	PARA LA PARTIDA 175 SE REQUIERE OFERTAR PUNTAS PARA CAVITRÓN.
55	ANEXO 1	PARTIDA 184 379-603-0215-00-01 -¿SERÁ CORRECTO OFERTAR UN MANGUITO DE 33 -47 CM? ¿REQUIERE QUE EL BRAZALETE LLEVE CONECTORES?, SI ES ASI ¿PODRÍAN MENCIONAR QUE TIPO DE CONECTOR REQUIERE?, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI REQUIEREN BRAZALETE	PARA LA PARTIDA 184 SE PUEDE OFERTAR UN MANGUITO DE 33-47 CM, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. NO SE REQUIERE DE CONECTORES Y EL BRAZALETE SE REQUIERE SEA DE UNA VÍA.



FO CON-08-21

2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		CON UNA O DE DOS VÍAS.	
56	ANEXO 1	PARTIDA 185 379-603-0306-00-01 -¿SERÁ CORRECTO OFERTAR UN MANGUITO DE 46 -66 CM? ¿REQUIERE QUE EL BRAZALETE LLEVE CONECTORES?, SI ES ASI	PARA LA PARTIDA 185 SE PUEDE OFERTAR UN MANGUITO DE 46-66 CM, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. NO SE REQUIERE DE CONECTORES Y EL BRAZALETE SE REQUIERE SEA DE DOS VÍAS.
57	ANEXO 1	PARTIDA 186 379-603-0314-00-01 -¿SERÁ CORRECTO OFERTAR UN MANGUITO DE 33 -47 CM? ¿REQUIERE QUE EL BRAZALETE LLEVE CONECTORES?,	PARA LA PARTIDA 186 SE PUEDE OFERTAR UN MANGUITO DE 33-47 CM, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. NO SE REQUIERE DE CONECTORES Y EL BRAZALETE SE REQUIERE SEA DE UNA VÍA.
58	ANEXO 1	PARTIDA 186 379-603-0322-00-01 -¿SERÁ CORRECTO OFERTAR UN MANGUITO DE 25 - 35 CM?	REFERIRSE A LAS RESPUESTAS EMITIDAS PARA LAS PREGUNTAS 57 Y 59.
59	ANEXO 1	PARTIDA 187 379-603-0322-00-01 -¿SERÁ CORRECTO OFERTAR UN MANGUITO DE 25 - 35 CM?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, AJUSTARSE A LAS MEDIDAS SOLICITADAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 187.
60	ANEXO 1	PARTIDA 188 379-603-0330-00-01 -¿SERÁ CORRECTO OFERTAR UN MANGUITO DE 25 - 35 CM?	PARA LA PARTIDA 188 SE PUEDE OFERTAR UN MANGUITO DE 25-35 CM, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
61	ANEXO 1	PARTIDA 189 -¿SERÁ CORRECTO OFERTAR UN MANGUITO DE 25 - 35 CM? SE REQUIERE MANGUITO DE UNA O DE DOS VÍAS. -REQUIERE CONECTOR EN EL BRAZALTE? SI ES ASI, FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR QUE NECESITA.	PARA LA PARTIDA 189 SE PUEDE OFERTAR UN MANGUITO DE 25-35 CM, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. NO SE REQUIERE DE CONECTORES Y EL BRAZALETE SE REQUIERE SEA DE UNA VÍA.
62	ANEXO 1	PARTIDA 190 379-603-0371-00-01 -¿SERÁ CORRECTO OFERTAR UN MANGUITO DE 33 -47 CM? SE REQUIERE MANGUITO DE UNA O DE DOS VÍAS. -REQUIERE CONECTOR EN EL BRAZALTE? SI ES ASI, FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR QUE NECESITA.	PARA LA PARTIDA 190 SE PUEDE OFERTAR UN MANGUITO DE 33-47 CM, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. NO SE REQUIERE DE CONECTORES Y EL BRAZALETE SE REQUIERE SEA DE UNA VÍA.
63	ANEXO 1	PARTIDA 191 379-603-0389-00-01	PARA LA PARTIDA 191 SE PUEDE OFERTAR UN



2022 Ricardo
Flores
Año de
Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



		-¿SERÁ CORRECTO OFERTAR UN MANGUITO DE 18 A 26 CM? SE REQUIERE MANGUITO DE UNA O DE DOS VÍAS. -REQUIERE CONECTOR EN EL BRAZALTE? SI ES ASI, FAVOR DE MENCIONAR EL TIPO DE CONECTOR QUE NECESITA.	MANGUITO DE 18-26 CM, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. NO SE REQUIERE DE CONECTORES Y EL BRAZALETE SE REQUIERE SEA DE UNA VÍA.
64	ANEXO 1	PARTIDA 192 379-603-0413-00-01 -¿SERÁ CORRECTO OFERTAR UN MANGUITO DE 25-35 CM? ¿REQUIERE QUE EL BRAZALETE LLEVE CONECTORES?, SI ES ASI ¿PODRÍAN MENCIONAR QUE TIPO DE CONECTOR REQUIERE? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI REQUIEREN BRAZALETE CON UNA O DE DOS VÍAS.	PARA LA PARTIDA 192 SE PUEDE OFERTAR UN MANGUITO DE 25-35 CM, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. NO SE REQUIERE DE CONECTORES Y EL BRAZALETE SE REQUIERE SEA DE UNA VÍA.
65	ANEXO 1	PARTIDA 193 379-603-0421-00-01 -¿SERÁ CORRECTO OFERTAR UN MANGUITO DE 6-11 CM? ¿REQUIERE QUE EL BRAZALETE LLEVE CONECTORES?, SI ES ASI ¿PODRÍAN MENCIONAR QUE TIPO DE CONECTOR REQUIERE? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI REQUIEREN BRAZALETE CON UNA O DE DOS VÍAS.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, AJUSTARSE A LAS MEDIDAS SOLICITADAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 193.
66	ANEXO 1	PARTIDA 194 379-603-0439-00-01 -¿SERÁ CORRECTO OFERTAR UN MANGUITO DE 18-26 CM? ¿REQUIERE QUE EL BRAZALETE LLEVE CONECTORES?, SI ES ASI ¿PODRÍAN MENCIONAR QUE TIPO DE CONECTOR REQUIERE? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI REQUIEREN BRAZALETE CON UNA O DE DOS VÍAS.	PARA LA PARTIDA 194 SE PUEDE OFERTAR UN MANGUITO DE 25-35 CM, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. NO SE REQUIERE DE CONECTORES Y EL BRAZALETE SE REQUIERE SEA DE UNA VÍA.
67	ANEXO 1	PARTIDA 195 379-604-0024-00-01	NO ESPECÍFICA PREGUNTA.
68	ANEXO 1	PARTIDA 196 379-604-0370-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA MOSTRAR UNA FOTOGRAFIA DE LA MANGUERA PARA PODER OFERTAR EL INSUMO CORRECTAMENTE, O BIEN, PODRIA HACER UNA VISITA PERSONAL DE NUESTRA EMPRESA PARA VER LAS MANGUERAS Y QUE NOS FACILITEN	SE PUEDE REALIZAR VISITA AL HGZ#1 EN TLAXCALA DIRIGIÉNDOSE CON EL JEFE DE ABASTO DE LA UNIDAD MÉDICA, LO ANTERIOR SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Dpto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		TOMAR TODOS LOS DATOS DEL INSUMO. SI ES ASI, FAVOR DE MENCIONAR A DONDE TENDRIAMOS QUE DIRIJRNOS Y CON QUE PERSONA.	
69	ANEXO 1	PARTIDA 197 379-604-0677-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA MOSTRAR UNA FOTOGRAFIA DE LA MANGUERA PARA PODER OFERTAR EL INSUMO CORRECTAMENTE, O BIEN, PODRIA HACER UNA VISITA PERSONAL DE NUESTRA EMPRESA PARA VER LAS MANGUERAS Y QUE NOS FACILITEN TOMAR TODOS LOS DATOS DEL INSUMO. SI ES ASI, FAVOR DE MENCIONAR A DONDE TENDRIAMOS QUE DIRIJRNOS Y CON QUE PERSONA.	SE PUEDE REALIZAR VISITA AL HGZ#1 EN TLAXCALA DIRIGIÉNDOSE CON EL JEFE DE ABASTO DE LA UNIDAD MÉDICA, LO ANTERIOR SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
70	ANEXO 1	PARTIDA 198 379-604-0685-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA MOSTRAR UNA FOTOGRAFIA DE LA MANGUERA PARA PODER OFERTAR EL INSUMO CORRECTAMENTE, O BIEN, PODRIA HACER UNA VISITA PERSONAL DE NUESTRA EMPRESA PARA VER LAS MANGUERAS Y QUE NOS FACILITEN TOMAR TODOS LOS DATOS DEL INSUMO. SI ES ASI, FAVOR DE MENCIONAR A DONDE TENDRIAMOS QUE DIRIJRNOS Y CON QUE PERSONA.	SE PUEDE REALIZAR VISITA AL HGZ#1 EN TLAXCALA DIRIGIÉNDOSE CON EL JEFE DE ABASTO DE LA UNIDAD MÉDICA, LO ANTERIOR SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
71	ANEXO 1	PARTIDA 212 379-614-4107-00-01 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REQUIERE MASCARILLA REUSABLE PARA REANIMADOR?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PARA LA PARTIDA 212 SE SOLICITA QUE LA MASCARILLA SEA DESECHABLE.
72	ANEXO 1	PARTIDA 213 379-614-4115-00-01 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REQUIERE MASCARILLA REUSABLE PARA REANIMADOR?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PARA LA PARTIDA 213 SE SOLICITA QUE LA MASCARILLA SEA DESECHABLE.
73	ANEXO 1	PARTIDA 214 379-614-4123-00-01 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REQUIERE MASCARILLA REUSABLE PARA REANIMADOR?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PARA LA PARTIDA 214 SE SOLICITA QUE LA MASCARILLA SEA DESECHABLE.
74	ANEXO 1	PARTIDA 215 379-614-4131-00-01 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REQUIERE MASCARILLA REUSABLE PARA REANIMADOR?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PARA LA PARTIDA 215 SE SOLICITA QUE LA MASCARILLA SEA DESECHABLE.
75	ANEXO 1	PARTIDA 216 379-614-4149-00-01 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REQUIERE MASCARILLA REUSABLE	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PARA LA PARTIDA 216 SE SOLICITA QUE LA MASCARILLA SEA



		PARA REANIMADOR?	DESECHABLE.
76	ANEXO 1	PARTIDA 217 379-614-4156-00-01 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REQUIERE MASCARILLA REUSABLE PARA REANIMADOR?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PARA LA PARTIDA 217 SE SOLICITA QUE LA MASCARILLA SEA DESECHABLE.
77	ANEXO 1	PARTIDA 218 379-614-4305-00-01 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REQUIERE MASCARILLA REUSABLE PARA REANIMADOR?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PARA LA PARTIDA 218 SE SOLICITA QUE LA MASCARILLA SEA DESECHABLE.
78	ANEXO 1	PARTIDA 219 379-614-4313-00-01 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REQUIERE MASCARILLA REUSABLE PARA REANIMADOR?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PARA LA PARTIDA 219 SE SOLICITA QUE LA MASCARILLA SEA DESECHABLE.
79	ANEXO 1	PARTIDA 220 379-614-4321-00-01 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REQUIERE MASCARILLA REUSABLE PARA REANIMADOR?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PARA LA PARTIDA 220 SE SOLICITA QUE LA MASCARILLA SEA DESECHABLE.
80	ANEXO 1	PARTIDA 221 379-614-4339-00-01 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REQUIERE MASCARILLA REUSABLE PARA REANIMADOR?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PARA LA PARTIDA 221 SE SOLICITA QUE LA MASCARILLA SEA DESECHABLE.
81	ANEXO 1	PARTIDA 232 379-625-0029-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI SE REQUIERE MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA, SI ES ASI SOLICITAMOS EL TAMAÑO DE LA MISMA. Ó ¿ÚNICAMENTE REQUIERE EL VASITO NEBULIZADOR?	PARA LA PARTIDA 232 SE REQUIERE DEL MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA TAMAÑO ADULTO
82	ANEXO 1	PARTIDA 233 379-625-0045-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI SE REQUIERE MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA, SI ES ASI SOLICITAMOS EL TAMAÑO DE LA MISMA, Ó ¿ÚNICAMENTE EL VASITO NEBULIZADOR?	PARA LA PARTIDA 233 SE REQUIERE DEL MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA TAMAÑO PEDIÁTRICO.
83	ANEXO 1	PARTIDA 234 379-625-0052-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI SE REQUIERE MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA, SI ES ASI SOLICITAMOS EL TAMAÑO DE LA MISMA, Ó ¿ÚNICAMENTE EL VASITO NEBULIZADOR?	PARA LA PARTIDA 234 SE REQUIERE DEL MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA TAMAÑO ADULTO
84	ANEXO 1	PARTIDA 237 379-643-0100-00-01	PARA LA PARTIDA 237 SE REQUIERE MASCARILLA





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE EL TAMAÑO DE LA MASCARILLA	TAMAÑO ADULTO.
85	ANEXO 1	PARTIDA 238 379-643-0118-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR: UN NEBULIZADOR PRE-LLENADO DE AGUA ESTERILIZADA "AQUAPAK" DE 760ML , CON ADAPTADORES DE HUMIDIFICADOR INCORPORAN UNA ALARMA AUDIBLE PARA ALERTAR AL MÉDICO SOBRE LA RESTRICCIÓN DEL FLUJO U OCLUSIÓN DEL HUMIDIFICADOR O LA TUBERÍA, EL CUAL CONSTA DE UN SISTEMA VERSATIL Y ESTÉRIL PARA PROPORCIONAR NEBULIZACIÓN FRÍA O CALIENTE. COMO EL DE LA SIGUIENTE IMAGEN:¿SE ACEPTA? 	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 238.
86	ANEXO 1	PARTIDA 239 379-643-0216-00-01 EL NEBULIZADOR DESECHABLE DE ALTO VOLUMEN CONCENTRACION VARIABLE NUMERO DE CATALOG : 1770 SE HA DESCONTINUADO POR EL FABRICANTE, SIN EMBARGO, PARA SUSTITUIRLO CON LAS MISMAS FUNCIONES SE OFRECE A LOS CLIENTES EL SIGUIENTE INSUMO: UN NEBULIZADOR PRE-LLENADO DE AGUA ESTERILIZADA "AQUAPAK" DE 760ML , CON ADAPTADORES DE HUMIDIFICADOR INCORPORAN UNA ALARMA AUDIBLE PARA ALERTAR AL MÉDICO SOBRE LA RESTRICCIÓN DEL FLUJO U OCLUSIÓN DEL HUMIDIFICADOR O LA TUBERÍA, EL CUAL CONSTA DE UN SISTEMA VERSATIL Y ESTÉRIL PARA PROPORCIONAR NEBULIZACIÓN FRÍA O CALIENTE. COMO EL DE LA SIGUIENTE IMAGEN:¿SE	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 239 O EN SU CASO AL BIEN DE SUMINISTRO COMPATIBLE CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES.



2022 *Ricardo*
Flores
Año de *Magón*
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		ACEPTA? 	
87	ANEXO 1	PARTIDA 265 379-696-0023-00-01 REQUIEREN PILA ALCALINA O DE CARBÓN? ¿EN CASO DE SER ADJUDICADOS EL ALMACEN NOS PODRIA RECIBIR EN LA PRESENTACIÓN ORIGINAL DEL FABRICANTE, ES DECIR POR BLISTER DE 2 O 4 PIEZAS? ¿SERÁ CORRECTO OFERTAR PILA POR PIEZA?	PARA LA APARTIDA 265 SE REQUIERE SEAN PILAS ALCALINAS Y SE ACEPTA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO SE ENTREGUE LA CANTIDAD TOTAL DE PIEZAS SOLICITADAS PARA LA PARTIDA, LO ANTERIOR SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
88	ANEXO 1	PARTIDA 266 379-696-0056-00-01 ¿SERÁ CORRECTO OFERTAR PILA POR PIEZA? O ¿SE REQUIERE OFERTAR PAQUETE DE 4 PIEZAS? ¿EN CASO DE SER ADJUDICADOS EL ALMACÉN NOS PODRÍA RECIBIR EN LA PRESENTACIÓN ORIGINAL DEL FABRICANTE, ES DECIR POR BLISTER DE 2 O 4 PIEZAS?	PARA LA APARTIDA 266 ACEPTA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO SE ENTREGUE LA CANTIDAD TOTAL DE PIEZAS SOLICITADAS PARA LA PARTIDA, LO ANTERIOR SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
89	ANEXO 1	PARTIDA 267 379-696-0098-00-01 ¿SERÁ CORRECTO OFERTAR PILA POR PIEZA? ¿EN CASO DE SER ADJUDICADOS EL ALMACÉN NOS PODRÍA RECIBIR EN LA PRESENTACIÓN ORIGINAL DEL FABRICANTE, ES DECIR POR BLISTER DE 2 O 4 PIEZAS?	PARA LA APARTIDA 267 ACEPTA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO SE ENTREGUE LA CANTIDAD TOTAL DE PIEZAS SOLICITADAS PARA LA PARTIDA, LO ANTERIOR SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
90	ANEXO 1	PARTIDA 269 379-696-0189-00-01 ¿SERÁ CORRECTO OFERTAR PILA AA REUSABLE? ¿EN CASO DE SER ADJUDICADOS EL ALMACÉN NOS PODRÍA RECIBIR EN LA PRESENTACIÓN ORIGINAL DEL FABRICANTE, ES DECIR POR BLISTER DE 2 O 4 PIEZAS?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LO REQUERIDO EN LA PARTIDA 269 DONDE LA PILA DEBE SER COMPATIBLE O ESPECÍFICA PARA EL EQUIPO REFRIGERADOR PARA VACUNAS DE LA MARCA OJEDA MODELO RVBM-500.
91	ANEXO 1	PARTIDA 270	NO SE ACEPTA SU





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Dpto. De Adquisición de Bienes v Contratación de Servicios

		¿SERÁ CORRECTO OFERTAR PILA AA REUSABLE? ¿EN CASO DE SER ADJUDICADOS EL ALMACEN NOS PODRIA RECIBIR EN LA PRESENTACIÓN ORIGINAL DEL FABRICANTE, ES DECIR POR BLISTER DE 2 O 4 PIEZAS?	SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LO REQUERIDO EN LA PARTIDA 269 DONDE LA PILA DEBE SER COMPATIBLE O ESPECÍFICA PARA EL EQUIPO REFRIGERADOR PARA VACUNAS DE LA MARCA OJEDA MODELO RVBM-500.
92	ANEXO 1	PARTIDA 271 379-704-0015-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI LA PLACA QUE REQUIEREN ES DESECHABLE O REUSABLE, SI SE REQUIERE TAMAÑO ADULTO O PEDIATRICO. ES CORRECTO OFERTAR PLACA CON EL CABLE?	PARA LA PARTIDA 271 SE REQUIERE PLACAS DESECHABLES TAMAÑO ADULTO CON CABLE.
93	ANEXO 1	PARTIDA 272 379-704-0023-01-01 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE REQUIEREN PLACA REUSABLE?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PARA LA PARTIDA 272.
94	ANEXO 1	PARTIDA 278 379-778-0073-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR JERINGA DE RESINA CON 4 GR	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 278.
95	ANEXO 1	PARTIDA 279 379-778-0081-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR JERINGA DE RESINA CON 4 GR	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 279.
96		PARTIDA 283 379-782-0010-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE EL RANGO QUE DEBE TENER EL MANOMETRO, CONSIDERANDO QUE LOS MANUALES DE RESUCITACION REFIEREN MANEJO DE PRESIONES DE 0 A 60 MMHG. CONSIDERANDO QUE LOS ADITAMENTOS DE SEGURIDAD (MANOMETRO Y VALVULA PEEP) ELEVAN EL PRECIO DEL INSUMO APROXIMADAMENTE EN UN 40%, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE REQUIERE EL INSUMO CON DICHS ADITAMENTOS	PARA LA PARTIDA 283 SE SOLICITA OFERTAR RESUCITADOR CON MANÓMETRO CON ESCALA DE 0-60 CMH2O Y DEBERÁ DE APEGARSE A LOS ADITAMENTOS DESCRITOS EN LA DESCRIPCIÓN DE DICHA PARTIDA.
97	ANEXO 1	PARTIDA 284 379-782-0028-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE EL RANGO QUE DEBE TENER LA VALVULA PEEP, CONSIDERANDO	PARA LA PARTIDA 284 SE SOLICITA OFERTAR RESUCITADOR CON MANÓMETRO CON ESCALA DE 0-20CMH2O Y DEBERÁ DE APEGARSE A LOS

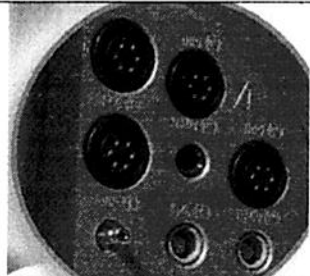
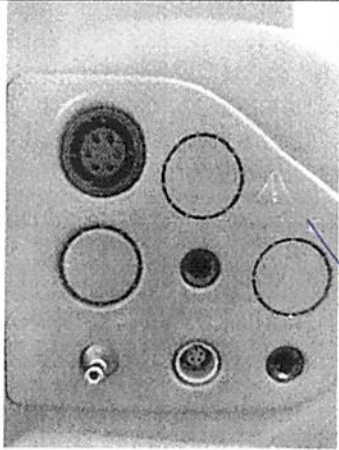


GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		QUE LOS MANUALES DE RESUCITACION REFIEREN MANEJO DE PRESIONES DE 0 A 20 CMH2O. CONSIDERANDO QUE LOS ADITAMENTOS DE SEGURIDAD (MANOMETRO Y VALVULA PEEP) ELEVAN EL PRECIO DEL INSUMO APROXIMADAMENTE EN UN 40%, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE REQUIERE EL INSUMO CON DICHS ADITAMENTOS	ADITAMENTOS DESCRITOS EN LA DESCRIPCIÓN DE DICHA PARTIDA.
98	ANEXO 1	PARTIDA 285 379-782-0036-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE EL RANGO QUE DEBE TENER EL MANOMETRO, CONSIDERANDO QUE LOS MANUALES DE RESUCITACION REFIEREN MANEJO DE PRESIONES DE 0 A 60 CMH2O. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE EL RANGO QUE DEBE TENER LA VALVULA PEEP, CONSIDERANDO QUE LOS MANUALES DE RESUCITACION REFIEREN MANEJO DE PRESIONES DE 0 A 20 CMH2O.	PARA LA PARTIDA 285 SE PUEDE OFERTAR RESUCITADOR CON MANÓMETRO CON ESCALA DE 0-60CMH2O NO SIENDO OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES SIN EMBARGO EL RANGO QUE DEBE DE TENER LA VÁLVULA PEEP DEBERÁ DE SER DE 0 A 40 CMH2O.
99	ANEXO 1	PARTIDA 296 379-808-3592-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE UNA FOTO O DIAGRAMA DE LA ENTRADA DEL MONITOR, DEBIDO A LAS DIVERSAS GENERACIONES DE LOS MONITORES	
100	ANEXO 1	PARTIDA 297 379-808-3741-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE UNA FOTO O DIAGRAMA DE LA ENTRADA DEL MONITOR, DEBIDO A LAS DIVERSAS GENERACIONES DE LOS MONITORES	



FO CON-08-29

2022 Ricardo
Año de Flores
Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

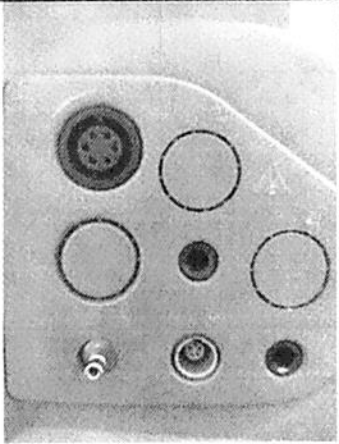


GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

101	ANEXO 1	PARTIDA 298 379-808-3766-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE UNA FOTO O DIAGRAMA DE LA ENTRADA DEL MONITOR, DEBIDO A LAS DIVERSAS GENERACIONES DE LOS MONITORES	
102	ANEXO 1	PARTIDA 303 379-808-6587-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN SENSOR DE OTRA MARCA TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL MNITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX VSM 6000/SPOT LXI.	NO ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 303.
103	ANEXO 1	PARTIDA 304 379-808-6637-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN SENSOR DE OTRA MARCA TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL MNITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX VSM 6000/SPOT LXI.	NO ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 304.
104	ANEXO 1	PARTIDA 315 379-892-0314-00-01 ES CORRECTIO ENTENDER EQUE ESTAS TRAMPAS SON PARA EL MODELO DE LA MARCA DRAGER	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN LAS TRAMPAS DE AGUA PARA CAPNÓGRAFÍA DEBERÁN SER COMPATIBLES O ESPECÍFICAS PARA LA UNIDAD DE ANESTESIA DE LA MARCA PLARRE MODELO 9500.
105	ANEXO 1	PARTIDA 322 526-055-0313-00-01 ¿EN CASO DE SER ADJUDICADOS EL ALMACEN NOS PODRIA RECIBIR EN LA PRESENTACIÓN ORIGINAL DEL FABRICANTE, ES DECIR POR BLISTER DE 2 O 4 PIEZAS?	SE ACEPTA SU SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO LA CANTIDAD TOTAL SEA LA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 322, NO SIENDO OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
106	ANEXO 1	PARTIDA 324 526-055-0735-00-00 ¿EN CASO DE SER ADJUDICADOS EL	SE ACEPTA SU SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO LA CANTIDAD TOTAL SEA LA





		ALMACÉN NOS PODRÍA RECIBIR EN LA PRESENTACIÓN ORIGINAL DEL FABRICANTE, ES DECIR POR BLISTER DE 2 O 4 PIEZAS?	SOLICITADA PARA LA PARTIDA 324, NO SIENDO OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
107	ANEXO 1	PARTIDA 325 526-055-0743-00-00 ¿EN CASO DE SER ADJUDICADOS EL ALMACÉN NOS PODRÍA RECIBIR EN LA PRESENTACIÓN ORIGINAL DEL FABRICANTE, ES DECIR POR BLISTER DE 2 O 4 PIEZAS?	SE ACEPTA SU SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO LA CANTIDAD TOTAL SEA LA SOLICITADA PARA LA PARTIDA 325, NO SIENDO OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
108	ANEXO 1	PARTIDA 329 526-070-0017-00-01 ¿EN CASO DE SER ADJUDICADOS EL ALMACÉN NOS PODRÍA RECIBIR EN LA PRESENTACIÓN ORIGINAL DEL FABRICANTE, ES DECIR POR BLISTER DE 2 O 4 PIEZAS?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LA PRESENTACIÓN REQUERIDA PARA A LA PARTIDA 329 BRAZALETE ADULTO REUSABLE.
109	ANEXO 1	PARTIDA 330 526-070-0181-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN BRAZALETE DE 6 - 11 CM DE CIRCUNFERENCIA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DOS VIAS, ¿REQUIERE DE CONECTORES, DE QUE TIPO?	SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, NO SE REQUIERE DE CONECTORES Y EL BRAZALETE DEBERÁ DE SER DE UNA VÍA.
110	ANEXO 1	PARTIDA 331 526-070-0843-00-00 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN BRAZALETE DE 18 - 26 CM DE CIRCUNFERENCIA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DOS VIAS, ¿REQUIERE DE CONECTORES, DE QUE TIPO?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 331.
111	ANEXO 1	PARTIDA 332 526-070-0868-00-00 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN BRAZALETE DE 25 - 35 CM DE CIRCUNFERENCIA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DOS VIAS, ¿REQUIERE DE CONECTORES, DE QUE TIPO?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 332.
112	ANEXO 1	PARTIDA 333 526-070-0884-00-00 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN BRAZALET DE 33 - 47 CM DE CIRCUNFERENCIA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 333.





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		DE UNA O DOS VIAS, ¿REQUIERE DE CONECTORES, DE QUE TIPO?	
113	ANEXO 1	PARTIDA 334 526-080-0270-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE UNA FOTO O DIAGRAMA DE LA ENTRADA DEL MONITOR, POR LAS DIVERSAS GNERACIONES QUE EXISTEN ACTUALMENTE	
114	ANEXO 1	PARTIDA 335 526-080-0361-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE UNA FOTO O DIAGRAMA DE LA ENTRADA DEL MONITOR, POR LAS DIVERSAS GNERACIONES QUE EXISTEN ACTUALMENTE	
115	ANEXO 1	PARTIDA 362 526-257-0251-00-01	EL LICITANTE NO EMITE PREGUNTA.
116	ANEXO 1	PARTIDA 374 526-517-0265-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN BRAZALETE DE 25 - 35 CM DE CIRCUNFERENCIA Y 14 CM DE ANCHO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DOS VIAS, ¿REQUIERE DE CONECTORES, DE QUE TIPO?	SE ACEPTA SOLICITUD DE OFERTAR BRAZALETE DE 25 - 35 CM, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. NO SE REQUIERE DE CONECTORES Y EL BRAZALETE DEBERÁ DE SER DE UNA VÍA.
117	ANEXO 1	PARTIDA 375 526-517-0273-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN BRAZALETE DE 33 - 47 CM DE CIRCUNFERENCIA Y 14CM DE ANCHO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DOS VIAS, ¿REQUIERE DE CONECTORES, DE QUE TIPO?	SE ACEPTA SOLICITUD DE OFERTAR BRAZALETE DE 33 - 47 CM, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. NO SE REQUIERE DE CONECTORES Y EL BRAZALETE DEBERÁ DE SER DE UNA VÍA.
118	ANEXO 1	PARTIDA 379 526-518-0199-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE LA MARCA Y MODELO DEL CAPNOGRADO EN DONDE SERÁ UTILIZADA LA MANGUERADEL	PARA LA PARTIDA 379 SE REQUIERE SEA COMPATIBLE CON LA UNIDAD DE ANESTESIA DE LA MARCA PLARRE MODELO 9500 LA CUAL TIENE UN MONITOR DE LA MARCA PLARRE MODELO SV7.
119	ANEXO 1	PARTIDA 381 526-524-0084-00-01 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PARA LA PARTIDA 381.





		REQUIEREN MASCARILLA REUSABLE?	
120	ANEXO 1	PARTIDA 382 526-524-0092-00-01 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE REQUIEREN MASCARILLA REUSABLE?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PARA LA PARTIDA 382.
121	ANEXO 1	PARTIDA 383 526-524-0100-00-01 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE REQUIEREN MASCARILLA REUSABLE?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PARA LA PARTIDA 383.
122	ANEXO 1	PARTIDA 397 526-689-0184-00-02 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE REQUIEREN PULMÓN DE PRUEBA NEONATAL?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL PULMÓN DE PRUEBA DEBERÁ SER ADULTO.
123	ANEXO 1	PARTIDA 411 526-766-1766-00-00 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE UNA IMAGEN O FOTO DE LA ENTRADA DEL MONITOR, ESTO DEBIDO A LAS DIVERSAS GENERACIONES QUE EXISTEN	
124	ANEXO 1	PARTIDA 422 531-116-0369-03-01 1.- POR NORMA SUPONEMOS QUE DEBEREMOS OFERTAR DIÁMETRO LE LA CARATULA CON ESCALA 58 MM COMO MÍNIMO, Y QUE SE DEBERÁ OFERTAR UNA GRADUACIÓN DE LA ESCALA 0 - 300 MMHG, ES ESTO CORRECTO? 2.- DE QUE MEDIDAS (EXISTEN DE 13-19CM, 17-26CM, 27-33CM Y 31-47CM) Y CUANTOS BRAZALES REQUIEREN? 3.- SUPONEMOS QUE LA PERILLA DE INSUFLACION VA UNIDA FIRMEMENTE AL MANÓMETRO ES CORRECTO? 3.- ¿PODREMOS OMITIR LA PRESENTACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO PARA OFERTAR EQUIPOS DE PRECEDENCIA ASIÁTICA DE BAJO PRECIO?	PARA LA PARTIDA 422 LOS PARTICIPANTES DEBERÁN DE APEGARSE A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS BIENES DEBERÁN SER BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS.





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

CLAVE SAI: 531.116.0369.03.01 FECHA IMP.: 13/04/2021
CLAVE PREI: 000000000011662 HORA IMP.: 19:00:12
NOMBRE GENÉRICO

ESIFIGNOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Descripción:

- 1.1 Carátula con escala graduada con seguridad de sobrepresión.
- 1.2 Brazaletes reusables:
 - 1.2.1 Con cierre tipo velcro.
 - 1.2.2 Bolsas de insuflación libres de látex.
 - 1.2.3 Lavables, de los siguientes tamaños:
 - 1.2.3.1 Un (1) brazalete para paciente adulto con rango de 29 a 42 cm.
 - 1.2.3.2 Un (1) brazalete para paciente pediátrico con rango de 20 a 29 cm.
- 1.3 Una (1) perilla de insuflación con:
 - 1.3.1 Válvula de desinflado.
 - 1.3.2 Sistema de seguridad que impida la fuga de aire.
 - 1.3.3 Conector cónico.
 - 1.3.4 Válvula giratoria de desinflado.

125	ANEXO 1	PARTIDA 424 531-141-0079-00-01 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE REQUIEREN UN BOTA FRESA UNIVERSAL PARA PIEZA DE MANO DENTAL?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PARA LA PARTIDA 424.
126	ANEXO 1	PARTIDA 424 531-141-0079-00-01 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE REQUIEREN UN BOTA FRESA UNIVERSAL PARA PIEZA DE MANO DENTAL?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PARA LA PARTIDA 424.
127	ANEXO 1	PARTIDA 430 531-423-0011-02-01 1.- SUPONEMOS QUE DEBEMOS OFERTAR LA CONEXIÓN A LA TOMA MURAL, EN ESTE SENTIDO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUEN EL TIPO DE TOMA MURAL A LA QUE SE CONECTARAN LOS FLUJÓMETROS. ¿PARA QUE TIPO DE TANQUE ?	SE SOLICITA PARA LA PARTIDA 430 QUE LOS FLUJOMETROS SEAN PARA TANQUE DE OXÍGENO CON CGA.
128	ANEXO 1	PARTIDA 431 531-423-0052-02-01 1.- SUPONEMOS QUE DEBEMOS OFERTAR LA CONEXIÓN A LA TOMA MURAL, EN ESTE SENTIDO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUEN EL TIPO DE TOMA MURAL A LA QUE SE CONECTARAN LOS FLUJÓMETROS.	SE SOLICITA A LOS PARTICIPANTES QUE PARA LA PARTIDA 431 SE CONSIDERE TOMA MURAL INFRA Y AGA, POR LO QUE SE DEBERÁ SUMINISTRAR MITAD Y MITAD DE LA CANTIDAD TOTAL SOLICITADA.
129	ANEXO 1	PARTIDA 432 531-423-0060-02-01 1.- SUPONEMOS QUE DEBEMOS	SE SOLICITA A LOS PARTICIPANTES QUE PARA LA PARTIDA 432 SE





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		OFERTAR LA CONEXIÓN A LA TOMA MURAL, EN ESTE SENTIDO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUEN EL TIPO DE TOMA MURAL A LA QUE SE CONECTARAN LOS FLUJÓMETROS. ¿LA CONVOCANTE REQUIERE FLUJOMETROS DE AIRE O DE OXIGENO?	CONSIDERE TOMA MURAL OXIGENO TIPO AGA.
130	ANEXO 1	PARTIDA 433 531-423-0078-02-01 SUPONEMOS QUE AL SOLICITAR PARA TANQUE DE OXIGENO, REQUEIRE DE SELECTOR TIPO SINTONIZADOR DE TELEVISOR ANTIGUO PARA 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10 LITROS Y CON MANOMETRO PARA VER NIVEL DE LLENADO DEL TANQUE? ES CORRECTA NUESTRA OBSERVACION?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 433, Y CONEXIÓN CGA.
131	ANEXO 1	PARTIDA 443 531-721-0085-00-01 DEBIDO A QUE EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE CAVITRON SOLICITAMOS ACLARE SI REQUEREN QUE SE OFERTE UNICAMENTE LA PUNTA O INSERTO CON PUNTA.	PARA LA PARTIDA 443 SE SOLICITA PUNTAS PARA CAVITRÓN.
132	ANEXO 1	PARTIDA 444 531-721-0093-00-01 DEBIDO A QUE EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE CAVITRON SOLICITAMOS ACLARE SI REQUEREN QUE SE OFERTE UNICAMENTE LA PUNTA O INSERTO CON PUNTA.	PARA LA PARTIDA 444 SE SOLICITA PUNTAS PARA CAVITRÓN.
133	ANEXO 1	PARTIDA 445 531-784-0022-00-01 ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE REQUIERE RESUCITADOR DESECHABLE?, SI ES ASI, ¿PODRÍASN ESPECIFICAR PARA QUTIPO DE PACIENTE SE REQUIERE: ADULTO, PEDIATRICO O NEONATAL?	PARA LA PARTIDA 445 SE REQUIERE QUE SEA RESUCITADOR DESECHABLE TAMAÑO ADULTO.
134	ANEXO 1	PARTIDA 446 531-784-0204-03-01 ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE REQUIERE RESUCITADOR REUSABLE? LA DESCRIPCIÓN DEL INSUMO MENCIONA: " EN PACIENTES NEONATOS, PEDIATRICOS Y ADULTOS." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIOE LA PROPORCIÓN DE LOS TAMAÑOS REQUERIDOS.	PARA LA PARTIDA 446, EL RESUCITADOR SOLICITADO ES REUSABLE PARA PACIENTE ADULTO.
135	ANEXO 1	PARTIDA 362 526-257-0251-00-01 ¿SERÁ CORRECTO OFERTAR UN ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMO EL	PARA L APARTIDA 362, FAVOR DE APEGARSE A LA SIGUIENTE IMAGEN:



FO CON-08-35

2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		DE LA SIGUIENTE IMAGEN?: 	
136	ANEXO 1	PARTIDA 977 537-428-5350-00-01 DICE: FRESA DE DIAMANTE, PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA TRONCO CONICO NO. 117. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REQUIERE LA FRESA TRONCO CÓNICA DE CARBURO COMO LA QUE SE MUESTRA EN LA SIGUIENTE IMAGEN?  YA QUE EL FABRICANTE MENCIONA QUE LA FRESA CON NÚMERO DE PARTE 117 ES UN KIT DE FRESAS DE DIAMANTE:	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA DE LA PARTIDA 977, DONDE SE SOLICITA UNA PIEZA DE FRESA DE DIAMANTE PARA USO DE MANO DE ALTA VELOCIDAD FORMA TRONCO CÓNICO NO. 117.



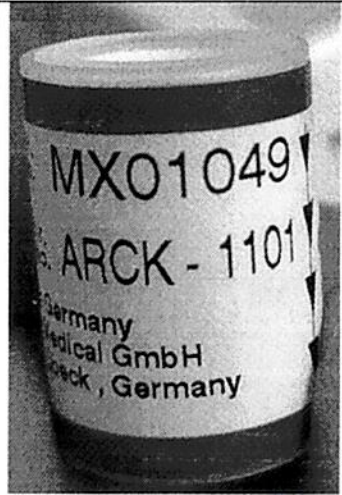


GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

			
137	ANEXO 1	FAVOR DE ACLARAR. PARTIDA 895 537-327-0577-00-01 ELEVADOR DE PERIOSTIO. JUEGO DE 4 Y 6 MM. ¿SERÁ CORRECTO OFERTAR EL SIGUIENTE ELEVADOR DE PERIOSTIO? 	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PARA LA PARTIDA 895.
138	ANEXO 1	PARTIDA 120 379-304-6636-00-01 DEBIDO A QUE EL FABRICANTE SUSTITUYÓ EL NÚMERO DE PARTE H327 POR EL H329, SIENDO EL MISMO ELECTRODO, PERO CON DIFERENTE NUMERO DE PARTE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EL ELECTRODO DESECHABLE DE DESFIBRILACIÓN, ADULTO PEDIATRICO (MAYOR QUE 10 KG). NO. DE PARTE: H329 ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
139	ANEXO 1	PARTIDA 85 379-184-0253-00-01 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA MOSTRAR UNA FOTOGRAFIA DE LA CELDA DE OXÍGENO PARA PODER OFERTAR EL INSUMO CORRECTAMENTE, O BIEN, PODRIA HACER UNA VISITA PERSONAL DE NUESTRA EMPRESA PARA VER LAS CELDAS Y QUE NOS FACILITEN TOMAR TODOS LOS DATOS DEL INSUMO. SI ES ASI, FAVOR DE MENCIONAR A DONDE TENDRIAMOS QUE DIRIJRNOS Y CON QUE PERSONA.	



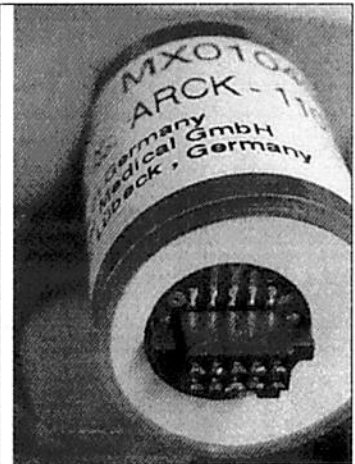


GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



140	ANEXO 1	PARTIDA 306 Y PARTIDA 402, ¿SERÁ CORRECTO OFERTAR EL MISMO SENSOR PARA AMBAS CLAVES? YA QUE EL NÚMERO DE PARTE QUE SE MENCIONA EN LAS DESCRIPCIONES DE AMBAS PARTIDAS ES EL MISMO.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PARA LAS PARTIDAS 306 Y 402 ES EL MISMO SENSOR DE FLUJO.
141	ANEXO 1	PARTIDA 363 SOLICITAMOS SE PUEDA OFERTAR HOJA DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA, TIPO MILLER # 4 (LONGITUD TOTAL 210MM). PRESENTACION: PZA., COMPATIBLE CON LARINGOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN, MODELO 60813. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LA MEDIDA SOLICITADA EN LA PARTIDA 363.
142	ANEXO 1	PARTIDA 364: SOLICITAMOS SE PUEDA OFERTAR HOJA DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA, TIPO MILLER # 4 (LONGITUD TOTAL 197MM). PRESENTACION: PZA., COMPATIBLE CON LARINGOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN, MODELO 60813. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LA MEDIDA SOLICITADA EN LA PARTIDA 364.
143	ANEXO 1	PARTIDA 365: SOLICITAMOS SE PUEDA OFERTAR HOJA DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA, TIPO MACINTOSH NUMERO 1 (LONGITUD TOTAL 92MM). PRESENTACION: PZA., COMPATIBLE CON LARINGOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN, MODELO 60813. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
144	ANEXO 1	PARTIDA 366: SOLICITAMOS SE PUEDA OFERTAR HOJA	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LA MEDIDA SOLICITADA EN LA PARTIDA





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA, TIPO MILLER # 1 (LONGITUD TOTAL 106MM). PRESENTACION: PZA., COMPATIBLE CON LARINGOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN, MODELO 60813. ¿SE ACEPTA?	366.
145	ANEXO 1	PARTIDA 367: SOLICITAMOS SE PUEDA OFERTAR HOJA DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA, TIPO MACINTOSH # 2 (LONGITUD TOTAL 100MM). PRESENTACION: PZA., COMPATIBLE CON LARINGOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN, MODELO 60813. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
146	ANEXO 1	PARTIDA 368: SOLICITAMOS SE PUEDA OFERTAR HOJA DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA, TIPO MACINTOSH # 3 (LONGITUD TOTAL 135MM). PRESENTACION: PZA., COMPATIBLE CON LARINGOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN, MODELO 60813. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LA MEDIDA SOLICITADA EN LA PARTIDA 368.
147	ANEXO 1	PARTIDA 369: SOLICITAMOS SE PUEDA OFERTAR HOJA DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA, TIPO MACINTOSH # 4 (LONGITUD TOTAL 155 MM). PRESENTACION: PZA., COMPATIBLE CON LARINGOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN, MODELO 60813. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
148	ANEXO 1	PARTIDA 370: SOLICITAMOS SE PUEDA OFERTAR HOJA DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA, TIPO MILLER # 0 (LONGITUD TOTAL 79MM). PRESENTACION: PZA., COMPATIBLE CON LARINGOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN, MODELO 60813. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LA MEDIDA SOLICITADA EN LA PARTIDA 370.
149	ANEXO 1	PARTIDA 371: SOLICITAMOS SE PUEDA OFERTAR HOJA DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA, TIPO MILLER # 00 (LONGITUD TOTAL 65MM). PRESENTACION: PZA., COMPATIBLE CON LARINGOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN, MODELO 60813. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LA MEDIDA SOLICITADA EN LA PARTIDA 371.
150	ANEXO 1	PARTIDA 372:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE



FO CON-08-39

2022 *Ricardo Flores*
Año de *Magón*
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		SOLICITAMOS SE PUEDA OFERTAR HOJA DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA, TIPO MILLER # 2 (LONGITUD TOTAL 160MM). PRESENTACION: PZA., COMPATIBLE CON LARINGOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN, MODELO 60813. ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LA MEDIDA SOLICITADA EN LA PARTIDA 372.
151	ANEXO 1	PARTIDA 378: SOLICITAMOS SE PUEDA OFERTAR MANGO PARA SU USO CON BATERÍAS, TAMAÑO MEDIANO "C", DE FIBRA ÓPTICA CON LUZ XENON, COMPATIBLE CON LARINGOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN, MODELO 60813. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, FAVOR DE APEGARSE A LA MEDIDA SOLICITADA EN LA PARTIDA 378.
152	ANEXO 1	PARTIDA 418 BASCULA ELECTRÓNICA CON ESTADÍMETRO ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ TENER CAPACIDAD MÁXIMA DE 250 KG O MAYOR ¿ES CORRECTO?	PARA LA PARTIDA 418 LOS PARTICIPANTES DEBERÁN DE APEGARSE A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CLAVE SAI: 531.110.0175.02.01 FECHA IMP.: 31/03/2020
CLAVE PREI: 000000000011655 HORA IMP.: 10:57:24

NOMBRE GENÉRICO

BÁSCULA ELECTRÓNICA CON ESTADÍMETRO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1. Descripción:

- 1.1 Equipo fijo para determinar el peso y la talla corporales.
- 1.2 Despliegue digital del peso en pantalla, lectura en kilogramos.
- 1.3 Rango de medición: 0 a 180 Kilogramos o mayor.
- 1.4 División: 100 g o menor.
- 1.5 Funciones:
 - 1.5.1 Tara.
 - 1.5.2 HOLD.
 - 1.5.3 Índice de masa corporal (BMI y/o IMC).
 - 1.5.4 Desconexión automática.
- 1.6 Estadímetro:
 - 1.6.1 Diseñado en acero o aluminio anodizado.
 - 1.6.2 Rango de medición de 60 a 200 cm. como mínimo.
 - 1.6.3 Con división de 1 mm.
 - 1.6.4 Con graduaciones en centímetros y pulgadas.

2 Accesorios:

- 2.1 Eliminador/cargador de baterías.
- 2.2 Adaptador de 120V/60 Hz.

3 Consumibles:

- 3.1 Batería recargable.

4 Instalación:

- 4.1 Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.

153	ANEXO 1	PARTIDA 418 BASCULA ELECTRÓNICA	PARA LA PARTIDA 418 LOS PARTICIPANTES DEBERÁN
-----	---------	---------------------------------	---





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		CON ESTADÍMETRO ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ TENER ESTADÍMETRO DE MEDICIÓN EN EL RANGO DE 76 CM O MENOR A 214 CM O MAYOR ¿ES CORRECTO?	DE APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA PREGUNTA 152.
154	ANEXO 1	PARTIDA 418: BASCULA ELECTRÓNICA CON ESTADÍMETRO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR BÁSCULA CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA POR ELIMINADOR AC Ó BATERÍAS RECARGABLES, SIENDO SOLO UNA DE LAS OPCIONES PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	PARA LA PARTIDA 418 LOS PARTICIPANTES DEBERÁN DE APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA PREGUNTA 152.
155	ANEXO 1	PARTIDA 419 BÁSCULA ELECTRÓNICA SOLICITAMOS QUE LA FUNCIÓN DE INDICADOR DE BATERÍA BAJA SEA OPCIONAL, DE ACUERDO A LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, YA QUE SE SOLICITA ADAPTADOR AC-DC. ¿SE ACEPTA?	PARA LA PARTIDA 419 LOS PARTICIPANTES DEBERÁN DE APEGARSE A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

CLAVE SAI: 531.110.0209.02.01 FECHA IMP.: 31/03/2020
CLAVE PREI: 000000000011656 HORA IMP.: 10:57:43

NOMBRE GENÉRICO

BÁSCULA ELECTRÓNICA

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Descripción:

- 1.1 Equipo para determinar el peso corporal en neonatos, lactantes y pediátricos.
- 1.2 Báscula con despliegue digital del peso en pantalla.
 - 1.2.1 Capacidad de hasta 20 kg. de peso.
 - 1.2.2 Lectura en gramos y kilogramos.
 - 1.2.3 División de 5 gramos o 10 gramos.
 - 1.2.4 Platillo o charola.
 - 1.2.5 Funciones:
 - 1.2.5.1 Tara
 - 1.2.5.2 Hold
 - 1.2.6 Indicador de batería baja
 - 1.2.7 Desconexión automática.
 - 1.2.8 Que funcione por medio de los siguientes tipos de alimentación eléctrica:
 - 1.2.8.1 Alimentación por baterías recargables y
 - 1.2.8.2 Alimentación por medio de corriente eléctrica.

2 Accesorios:

- 2.1 Adaptador AC-DC y Eliminador/cargador de baterías recargables

3 Consumibles:

- 3.1 Batería recargable

4 Instalación:

- 4.1 Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.

156	ANEXO 1	PARTIDA 419 BÁSCULA ELECTRÓNICA ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON CHAROLA DESPRENDIBLE PARA PESO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS DE PIE CON UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE HASTA 20 KG ¿ES CORRECTO?	PARA LA PARTIDA 419 LOS PARTICIPANTES DEBERÁN DE APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA PREGUNTA 155.
157	ANEXO 1	PARTIDA 422.- ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON CARÁTULA DE FONDO BLANCO Y ESCALA EN COLOR NEGRO CON AGUJA ROJA PARA MEJOR LECTURA DE LAS MEDICIONES ¿SE ACEPTA?	PARA LA PARTIDA 422 LOS PARTICIPANTES DEBERÁN DE APEGARSE A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





CLAVE SAI: 531.116.0369.03.01 FECHA IMP.: 13/04/2021
CLAVE PREI: 000000000011662 HORA IMP.: 19:00:12
NOMBRE GENÉRICO

ESIFIGNOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Descripción:

- 1.1 Carátula con escala graduada con seguridad de sobrepresión.
- 1.2 Brazaletes reusables:
 - 1.2.1 Con cierre tipo velcro.
 - 1.2.2 Bolsas de insuflación libres de látex.
 - 1.2.3 Lavables, de los siguientes tamaños:
 - 1.2.3.1 Un (1) brazalete para paciente adulto con rango de 29 a 42 cm.
 - 1.2.3.2 Un (1) brazalete para paciente pediátrico con rango de 20 a 29 cm.
- 1.3 Una (1) perilla de insuflación con:
 - 1.3.1 Válvula de desinflado.
 - 1.3.2 Sistema de seguridad que impida la fuga de aire.
 - 1.3.3 Conector cónico.
 - 1.3.4 Válvula giratoria de desinflado.

158	ANEXO 1	PARTIDA 422.- ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. LOS BRAZALETES A OFERTAR DEBERÁN SER PEDIÁTRICO DE 20.5 CM A 28.5 CM, ADULTO DE 27.5 CM A 36.5CM Y ADULTO GRANDE DE 35.C CM A 46.0 CM ¿ES CORRECTO?	PARA LA PARTIDA 422 LOS PARTICIPANTES DEBERÁN DE APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA PREGUNTA 124 Y 157
159	ANEXO 1	PARTIDA 423 ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PEDESTAL ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON CARÁTULA DE FONDO BLANCO Y ESCALA EN COLOR NEGRO CON AGUJA ROJA PARA MEJOR LECTURA DE LAS MEDICIONES ¿SE ACEPTA?	PARA LA PARTIDA 423 LOS PARTICIPANTES DEBERÁN DE APEGARSE A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Descripción:

- 1.1 Carátula con escala graduada con seguridad de sobrepresión.
- 1.2 Brazaletes reusables:
 - 1.2.1 Con cierre tipo velcro.
 - 1.2.2 Bolsas de insuflación libres de látex.
 - 1.2.3 Lavables, de los siguientes tamaños:
 - 1.2.3.1 Un (1) brazalete para paciente adulto con rango de 29 a 42 cm.
 - 1.2.3.2 Un (1) brazalete para paciente pediátrico con rango de 20 a 29 cm.
- 1.3 Una (1) perilla de insuflación con:
 - 1.3.1 Válvula de desinflado.
 - 1.3.2 Sistema de seguridad que impida la fuga de aire.
 - 1.3.3 Conector cónico.
 - 1.3.4 Válvula giratoria de desinflado.
 - 1.3.5 Cuchara adaptable para diestros y zurdos.

2 Accesorios:

- 2.1 Base con ruedas para su trasportación.

160	ANEXO 1	PARTIDA 423 ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PEDESTAL SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR BRAZALETES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PEDIÁTRICO DE 20.5 CM A 28.5 CM, ADULTO DE 27.5 CM A 36.5CM Y ADULTO GRANDE DE 35.C CM A 46.0 CM ¿SE ACEPTA?	PARA LA PARTIDA 423 LOS PARTICIPANTES DEBERÁN DE APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA PREGUNTA 159.
161	ANEXO 1	PARTIDA 427 ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. ENTENDEMOS QUE LOS INSTRUMENTOS DEBERÁN SER DE FABRICACIÓN EN ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE EN AURICULARES Y CAMPANA, PARA LOGRAR LA MEJOR CONDUCCIÓN DE SONIDO ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PARA LA PARTIDA 427.





Licitante: CORPORATIVO MS SISTEMAS MÉDICOS, S.A. DE C.V.

PREGUNTA	PUNTO O NUMERAL	ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS
1	2.1. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA	REFERENCIA: 2.1. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA PREGUNTA: PODRIA LA CONVOCANTE AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 30 NATURALES DE LA PRIMERA ENTREGA (50%), SIENDO QUE LOS BIENES OFERTADOS Y/O SOLICITADOS EN SU GRAN MAYORIA SON IMPORTACION. FAVOR DE CONSIDERAR EN BENEFICIO DE LA CONCURRENCIA.	REFERIRSE A LA ACLARATORIA NÚMERO 5 DE LA CONVOCANTE: PRIMERA ENTREGA.- EL 50% DE LOS BIENES ADJUDICADOS DEBERÁN DE ENTREGARSE EN UN PERIODO DE 30 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL DE LA EMISIÓN DEL FALLO.
2	2.3 NUMEROS 1,2,3,4,5,6 Y 7	NUMERAL 2.3 NUMEROS 1,2,3,4,5,6 Y 7 PREGUNTA: PARA UNA MEJOR CONDUCCION DEL EVENTO Y CON LA FINALIDAD DE AHORRAR EN IMPRESIÓN DE PAPEL CONFORME A LA CERTIFICACION DE MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUES POR LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL SEGÚN DOF DE FECHA 5/SEPTIEMBRE/2007, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN PRESENTAR EN USB O CD LOS REGISTROS SANITARIOS, OFICIOS COFEPRIS, PRORROGAS, CERTIFICADOS ISO Y/O TUV, CERTIFICADOS DE BUENAS PRACTICAS, FDA O CE SEGÚN CORRESPONDAN , DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, POR LOS BIENES OFERTADOS, ESTO EN BENEFICIO DE LA CONCURRENCIA Y DE UN MANEJO RESPONSABLE DEL PAPEL. FAVOR DE CONSIDERAR.	POR SER UN PROCEDIMIENTO DE CARÁCTER PRESENCIAL SE DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE MANERA IMPRESA.
3	NUMERAL 2.3 NUMERO 5	NUMERAL 2.3 NUMEROS 5 DICE: COPIA DEL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001-2015, ISO 13485 O TÜV PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE SE PUEDE PRESENTAR DE MANERA INDISTINTA SOLO UNO DE LOS CERTIFICADOS INDICADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, TODA VEZ QUE SE SOLICITA LOS DOS CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-2015 E ISO 13485 O CERTIFICADO TÜV PARA LAS PARTIDAS OFERTADAS, LOS CUALES DEBERÁN DE ESTAR VIGENTES Y DEBIDAMENTE REFERENCIADOS.





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

4	NUMERAL 2.3 NUMERO 9	NUMERAL 2.3 NUMERO 9 DICE FOLLETOS CATALOGOS Y FOTOGRAFIAS PREGUNTA: PARA UNA MEJOR CONDUCCION DEL EVENTO Y CON LA FINALIDAD DE AHORRAR EN IMPRESIÓN DE PAPEL CONFORME A LA CERTIFICACION DE MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUES POR LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL SEGÚN DOF DE FECHA 5/SEPTIEMBRE/2007, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN PRESENTAR EN USB O CD LOS FOLLETOS, CATALOGOS Y/O FOTOGRAFIAS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, DE LOS BIENES OFERTADOS, ESTO EN BENEFICIO DE LA CONCURRENCIA Y DE UN MANEJO RESPONSABLE DEL PAPEL. FAVOR DE CONSIDERAR.	POR SER UN PROCEDIMIENTO DE CARÁCTER PRESENCIAL SE DEBERÁ PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DE MANERA IMPRESA.
5	NUMERAL 2.3 NUMERO 9	NUMERAL 2.3 NUMERO 9 PREGUNTA: EN EL CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR FUESE EN SENTIDO NEGATIVO, SE PUEDEN HACER LAS IMPRESIONES LEGIBLES DE LOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y FOTOGRAFÍAS EN BLANCO Y NEGRO Y ADJUNTAR EN CD O USB DICHS DOCUMENTOS A COLOR, SIENDO QUE AL IMPRIMIR A COLOR SERIA UN COSTO MUY HONEROSO PARA LOS LICITANTES FAVOR DE ACEPTAR EN BENEFICIO DE LA CONCURRENCIA.	PUEDE PRESENTAR LA IMPRESIÓN DE FOLLETOS, CATÁLOGOS Y FOTOGRAFÍAS EN BLANCO Y NEGRO SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN DEBIDAMENTE REFERENCIADAS Y ESTAS PERMITAN VERIFICAR, VALIDAR, SUSTENTAR Y CORROBORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE. LO ANTERIOR, NO ES OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ASIMISMO, REMITIRSE A LAS RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE A SUS PREGUNTAS 2 Y 4.
6	NUMERAL 2.3 NUMERO 9	NUMERAL 2.3 NUMERO 9 DICE: SE REQUIEREN DE MANUALES, FICHAS TÉCNICAS, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y FOTOGRAFÍAS NECESARIOS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS BIENES DE SUMINISTRO OFERTADOS	COMO PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR EL ANEXO 2A (DOS A) DEBIDAMENTE REQUISITADO PARA LAS PARTIDAS A OFERTAR O QUE PARTICIPARAN.



FO CON-08-46

2022 Flores
Año de Magón
PROCURADOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



		DEBIDAMENTE REFERENCIADOS CONFORME EL ANEXO 2 A (DOS A) "CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LAS CLAVES 379, 526, 531, 535 Y 537" DEBIDAMENTE REFERENCIADA CON MANUALES, FICHAS TÉCNICAS, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y FOTOGRAFÍAS NECESARIOS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. PARA LO CUAL DEBERÁ DE AGREGAR UNA COLUMNA. PREGUNTA: HACIENDO REFERENCIA AL ANEXO 2A (DOS A) LE PREGUNTAMOS A LA CONVOCANTE SI EL MISMO DEBE REQUISITARSE CON LAS PARTIDAS QUE SEAN DE INTERES EN PARTICIPAR, O ¿CUAL ES EL PROPOSITO DE ESTE DOCUMENTO Y A EFECTO COMO DEBE REQUISITARSE? FAVOR DE ACLARAR.	
7	NUMERAL 2.3 NUMERO 9	NUMERAL 2.3 NUMERO 9 DICE: SE REQUIEREN DE MANUALES, FICHAS TÉCNICAS, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y FOTOGRAFÍAS NECESARIOS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS BIENES DE SUMINISTRO OFERTADOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS CONFORME EL ANEXO 2 A (DOS A) "CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LAS CLAVES 379, 526, 531, 535 Y 537" DEBIDAMENTE REFERENCIADA CON MANUALES, FICHAS TÉCNICAS, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y FOTOGRAFÍAS NECESARIOS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. <u>PARA LO CUAL DEBERÁ DE AGREGAR UNA COLUMNA.</u> PREGUNTA: EN EL ARCHIVO EXCEL ANEXO 2A (DOS A) AL INCORPORAR LA COLUMNA DE FICHAS TECNICAS , FOLLETOS CATALOGOS Y FOTOGRAFIAS,	SE REQUIEREN DE MANUALES, FICHAS TÉCNICAS, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y FOTOGRAFÍAS NECESARIOS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS BIENES DE SUMINISTRO OFERTADOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, ASÍ MISMO SE REQUIERE REQUISITAR EL ANEXO 2A (DOS A) PARA LAS PARTIDAS OFERTADAS, DICHO ANEXO DEBERÁ TENER CONGRUENCIA Y CORRESPONDENCIA CON LA DOCUMENTAL PRESENTADA





		DEBEMOS INDICAR LA HOJA/FOLIO DONDE SE ECUESTRAN LOS MISMOS O COMO DEBEMOS CUMPLIR CON LO SOLICITADO SIENDO QUE EL FORMATO EXCEL NO SE PRESTA PARA EL MANEJO DE INFORMACION DE IMÁGENES QUE SOLICITAN, FAVOR DE ACLARAR COMO REQUISITAR LO SOLICITADO.	
8	PREGUNTA GENERAL:	PREGUNTA GENERAL: EN EL CASO DE QUE SE REPITAN DOCUMENTOS SOLICITADOS EN DIFERENTES NUMERALES, SE PUEDE HACER REFERENCIA A LOS NUMERALES QUE CORRESPONDAN PARA DAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO ESTO CON LA FINALIDAD DE NO IMPRIMIR DOS VECES LOS MISMOS DOCUMENTOS ESTO EN BENEFICIO DEL AHORRO DE PAPEL Y CUIDADO RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE. FAVOR DE ACEPTAR EN BENEFICIO DE LA CONCURRENCIA.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA CONVOCANTE.
9	PREGUNTA GENERAL:	PREGUNTA GENERAL: ¿ES REQUISITO INDISPENSABLE EL FOLIAR LOS DOCUMENTOS O SERA CAUSAL DE DESCALIFICACION EL NO HACERLO? FAVOR DE ACLARAR.	DE ACUERDO AL NUMERAL 10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO, INCISO IX. LA FALTA ABSOLUTA DE FOLIO EN LA PROPOSICIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 50, SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGALMENTO DE LA LAASSP.
10	PREGUNTA GENERAL:	PREGUNTA GENERAL: SIENDO QUE EL CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO CAMBIO A "PRESENCIAL" SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDIQUEN COMO QUIEREN EL ARMADO DE LAS CARPETAS Y/O DOCUMENTOS A PRESENTAR ASI COMO LOS DOCUMENTOS QUE VAN FUERA DE LOS SOBRES. FAVOR DE ACLARAR.	LOS LICITANTES ENTREGARÁN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y LEGAL EN SOBRE CERRADO DE FORMA TAL QUE SE GARANTICE SU INVIOABILIDAD, DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES (EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LA PROPUESTA PUEDEN ENTREGARLO EN UN SOLO SOBRE O EN VARIOS, SIEMPRE Y CUANDO SE GARANTICE LA INVIOABILIDAD.
11	PREGUNTA GENERAL:	PREGUNTA GENERAL:	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EN CASO DE



		TODA VEZ QUE SE RETRASEN LAS RESPUESTAS RESPECTO A LA JUNTA DE ACLARACIONES , ¿TAMBIEN SE RECORRERA EN LA MISMA PROPORCION LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS? FAVOR DE ACLARAR	QUE LA JUNTA DE ACLARACIONES SE EXTIENDA POR LA COMPLEJIDAD Y/O EXTENSIÓN DEL NÚMERO DE PREGUNTAS REALIZADAS POR LOS LICITANTES, SE DARÁ A CONOCER EL CALENDARIO DE EVENTOS SUBSECUENTES.
12	ANEXO NÚMERO 1 (UNO)	REFERENCIA: ANEXO NÚMERO 1 (UNO) PREGUNTA: HACIENDO REFERENCIA AL ANEXO INDICADO LE PREGUNTAMOS A LA CONVOCANTE SI EL TOTAL DE PARTIDAS DEL REQUERIMIENTO CONSTA DE 1138 PARTIDAS. FAVOR DE ACLARAR	EL ANEXO NUMERO 1 (UNO) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA CONSTA DE 1138 PARTIDAS, DE LAS CUALES LA PARTIDA LA 1136 CONSTA DE 10 CLAVES AGRUPADAS. PARA LA PARTIDA 1136 DEBERÁN OFERTAR LAS 10 CLAVES AGRUPADAS.
13	ANEXO NÚMERO 1 (UNO)	REFERENCIA: ANEXO NÚMERO 1 (UNO) PREGUNTA: EN CASO DE QUE SU RESPUESTA A LA PREGUNTA FUERA ANTERIOR FUERA EN SENTIDO POSITIVO, DEBEMOS TOMAR EN CUENTA EL ORDEN/NUMERACION DE LA PARTIDAS DE ESTE REQUERIMIENTO PARA EFECTOS DE ELABORACION DE DOCUMENTOS TANTO LEGALES-ADMINISTRATIVO, TECNICO Y ECONOMICO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	PODRÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN EN EL ORDEN DE LA NUMERACIÓN DEL ANEXO 1 SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
14	2.4. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS FRACCION II	2.4. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS FRACCION II DICE: COPIA DE LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PATRONAL ANTE EL IMSS E INFONAVIT. (CONTABILIDAD) PREGUNTA: ES CORRECTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO PRESENTAR SOLO LA TARJETA DE IDENTIFICACION PATRONAL IMSS SIENDO QUE ESTA SIRVE PARA LOS TRAMITES ANTE EL IMSS E INFONAVIT. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ ENTREGAR LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PATRONAL ANTE EL IMSS.
15	2.4. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS FRACCION III	2.4. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS FRACCION III DICE: ÚLTIMO PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL BIMESTRE PREVIO U OPINIÓN POSITIVA EN	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PODRA PRESENTAR EL ULTIMO PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL BIMESTRE PREVIO O LA OPINIÓN





		MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE EN LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. PREGUNTA: ES CORRECTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EL PRESENTAR UNO O ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS VIGENTES Y POSITIVOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION	POSITIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.
15	ANEXO NÚMERO 1 (UNO)	REFERENCIA: PARTIDA 1136 (AGRUPACION DE CLAVES) PREGUNTA: SIENDO QUE LA PARTIDA INDICADA ES POR AGRUPACION DE CLAVES Y HACEN REFERENCIA A UNA MARCA EN ESPECIFICO EN EL MERCADO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS PERMITAN OFERTAR EQUIPO DE SIMILARES CARACTERISTICAS Y/O TECNOLOGIA SUPERIOR Y QUE A EFECTO NOS PERMITAN EN EL ANEXO NUMERO 10 (PROPUESTA ECONOMICA) INSERTAR UNA COLUMNA DONDE SE INDIQUE LA "DESCRIPCION OFERTADA POR EL LICITANTE" . FAVOR DE ACEPTAR EN BENEFICIO DE LA CONCURRENCIA.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA PARTIDA INDICADA POR AGRUPACIÓN DE LAS CLAVES NO HACEN REFERENCIA A UNA SOLA MARCA EN ESPECÍFICO CONFORME A LAS DESCRIPCIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA BIEN DE SUMINISTRO REQUERIDO. PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGÍA SIEMPRE Y CUANDO LA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS CLAVES Y DE LOS BIENES DE SUMINISTRO SE MANTENGAN Y CUMPLAN CON LAS ANUNCIADAS Y ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ADEMÁS DE QUE SE DEBERÁ DE RESPETAR LA CANTIDAD EXACTA DE LAS CLAVES QUE CONFORMAN LA AGRUPACIÓN SOLICITADAS EN EL ANEXO 1 (UNO). LO ANTERIOR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
16		REFERENCIA: PARTIDA 1136 (AGRUPACION DE CLAVES) DICE EN BASES: PARA LAS CLAVES 379.200.3844.00.00, 379.200.3851.00.00 Y 379.200.3869.00.00 SE SOLICITA INCLUIR UN MANÓMETRO	LA SOLICITUD DE UN MANÓMETRO DE PRESIÓN ES PARA MONITORIZAR Y VISUALIZAR LA PRESIÓN A LA VÍA AÉREA DEL PACIENTE Y CONTAR CON UNA MAYOR SEGURIDAD PARA EL PACIENTE.





		DESECHABLE COMPATIBLE CON ESCALA DE 0 A 25 CMH20.	
		PREGUNTA: PODRIA LA CONVOCANTE INDICARNOS CUAL ES EL OBJETIVO DE INCLUIR UN MANOMETRO DESECHABLE EN LOS CIRCUITOS DE PACIENTES Y/O CUAL ES LA FUNCION ESPECIFICA QUE REALIZARA DICHO MANOMETRO EN LA TORRE DE BAJO FLUJO DE LAS CLAVES INDICADAS FAVOR DE ACLARAR.	
15	ANEXO NÚMERO 1 (UNO)	REFERENCIA: PARTIDA 1136 (AGRUPACION DE CLAVES) DE LA CLAVE: 526.330.0013.00.01 PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR QUE CUMPLE CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS PARA SATISFACER SU USO EN CONJUNTO CON EL VENTILADOR MECANICO CLAVE 531.941.1038.01 INDICADA EN LA DESCRIPCIÓN DE ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGÍA SIEMPRE Y CUANDO LA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CLAVE Y DEL BIEN DE SUMINISTRO SE MANTENGAN Y CUMPLAN CON LAS ANUNCIADAS Y ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ADEMÁS DE SER CORRESPONDIENTE Y CONGRUENTE Y DE RESPETAR LA CANTIDAD EXACTA DE LA CLAVE DESCRITA EN EL ANEXO 1 (UNO). LO ANTERIOR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
16	ANEXO NÚMERO 1 (UNO)	REFERENCIA: PARTIDA 1136 (AGRUPACION DE CLAVES) DE LA CLAVE: 526.330.0013.00.01 PREGUNTA: PERMITE LA CONVOCANTE OFERTAR UN HUMIDIFICADOR CON LAS CARACTERISTICAS PUBLICADAS EN EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CLAVE: 531.480.0128 MISMA CLAVE DE CUADRO BASICO QUE ES VALIDA PARA EL IMSS REFERENTE AL SISTEMA DE HUMIDIFICADOR CON CALEFACCIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE DEL BIEN DE SUMINISTRO SOLICITADO 526.330.0013.00.01 REFERIDA AL GRUPO 526 ACCESORIOS DE EQUIPO MÉDICO Y DESCRITO EN EL ANEXO 1 (UNO) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
17	ANEXO NÚMERO 1 (UNO)	REFERENCIA: PARTIDA 1136 (AGRUPACION DE CLAVES)	PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGÍA SIEMPRE Y CUANDO LA NATURALEZA,





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		DE LA CLAVE: 379.200.3844.00.00 PREGUNTA: PERMITE LA CONVOCANTE OFERTAR NUESTRA PROPIA TECNOLOGIA CON CARACTERISTICAS SIMILATES O SUPERIORES CON EL OBJETIVO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CLAVE Y DEL BIEN DE SUMINISTRO SE MANTENGAN Y CUMPLAN CON LAS ANUNCIADAS Y ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ADEMÁS DE SER CORRESPONDIENTE Y CONGRUENTE Y DE RESPETAR LA CANTIDAD EXACTA DE LA CLAVE DESCRITA EN EL ANEXO 1 (UNO). LO ANTERIOR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
18	ANEXO NÚMERO 1 (UNO)	REFERENCIA: PARTIDA 1136 (AGRUPACION DE CLAVES) DE LA CLAVE: 379.200.3844.00.00 PREGUNTA: SE ACEPTA QUE EL CIRCUITO DEBA INCLUIR UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LIMITA LA PRESIÓN Y FLUJO (MANIFOLD O TUBULADURA DE PRESIÓN) PARA PREVENIR DAÑO PULMONAR POR SOBREPRESIÓN AL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CABALMENTE LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN DE SUMINISTRO SOLICITADO, LA CUAL DEBERÁ DE TENER CORRESPONDENCIA Y CONGRUENCIA. LO ANTERIOR SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
19	ANEXO NÚMERO 1 (UNO)	REFERENCIA: PARTIDA 1136 (AGRUPACION DE CLAVES) DE LA CLAVE: 379.200.3851.00.00 PREGUNTA: PERMITE LA CONVOCANTE OFERTAR NUESTRA PROPIA TECNOLOGIA CON CARACTERISTICAS SIMILATES O SUPERIORES CON EL OBJETIVO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGÍA SIEMPRE Y CUANDO LA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CLAVE Y DEL BIEN DE SUMINISTRO SE MANTENGAN Y CUMPLAN CON LAS ANUNCIADAS Y ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ADEMÁS DE SER CORRESPONDIENTE Y CONGRUENTE Y DE RESPETAR LA CANTIDAD EXACTA DE LA CLAVE DESCRITA EN EL ANEXO 1 (UNO). LO ANTERIOR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
20	ANEXO NÚMERO 1 (UNO)	REFERENCIA: PARTIDA 1136 (AGRUPACION DE CLAVES) DE LA CLAVE: 379.200.3851.00.00	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CABALMENTE LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES





		PREGUNTA: SE ACEPTA QUE EL CIRCUITO DEBA INCLUIR UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LIMITA LA PRESIÓN Y FLUJO (MANIFOLD O TUBULADURA DE PRESIÓN) PARA PREVENIR DAÑO PULMONAR POR SOBREPRESIÓN AL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	TÉCNICAS DEL BIEN DE SUMINISTRO SOLICITADO, LA CUAL DEBERÁ DE TENER CORRESPONDENCIA Y CONGRUENCIA. LO ANTERIOR SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
21	ANEXO NÚMERO 1 (UNO)	REFERENCIA: PARTIDA 1136 (AGRUPACION DE CLAVES) DE LA CLAVE: 379.200.3869.00.00 PREGUNTA: PERMITE LA CONVOCANTE OFERTAR NUESTRA PROPIA TECNOLOGIA CON CARACTERISTICAS SIMILARES O SUPERIORES CON EL OBJETIVO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGÍA SIEMPRE Y CUANDO LA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CLAVE Y DEL BIEN DE SUMINISTRO SE MANTENGAN Y CUMPLAN CON LAS ANUNCIADAS Y ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA ADEMÁS DE SER CORRESPONDIENTE Y CONGRUENTE Y DE RESPETAR LA CANTIDAD EXACTA DE LA CLAVE DESCRITA EN EL ANEXO 1 (UNO). LO ANTERIOR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
22	ANEXO NÚMERO 1 (UNO)	REFERENCIA: PARTIDA 1136 (AGRUPACION DE CLAVES) DE LA CLAVE: 379.200.3869.00.00 PREGUNTA: SE ACEPTA QUE EL CIRCUITO DEBA INCLUIR UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LIMITA LA PRESIÓN Y FLUJO (MANIFOLD O TUBULADURA DE PRESIÓN) PARA PREVENIR DAÑO PULMONAR POR SOBREPRESIÓN AL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CABALMENTE LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN DE SUMINISTRO SOLICITADO, LA CUAL DEBERÁ DE TENER CORRESPONDENCIA Y CONGRUENCIA. LO ANTERIOR SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
23		DICE EN BASES: PARA LAS CLAVES 379.200.3844.00.00, 379.200.3851.00.00 Y 379.200.3869.00.00 SE SOLICITA INCLUIR UN MANÓMETRO DESECHABLE COMPATIBLE CON ESCALA DE 0 A 25 CMH2O. PREGUNTA: PODRIA LA CONVOCANTE INDICAR QUE CANTIDAD REQUIEREN DE LOS MANOMETROS SOLICITADOS PARA CADA TAMAÑO DE CIRCUITO. FAVOR DE ACLARAR	PARA LAS CLAVES 379.200.3844.00.00, 379.200.3851.00.00 Y 379.200.3869.00.00 SE SOLICITA INCLUIR UN MANÓMETRO DESECHABLE COMPATIBLE CON ESCALA DE 0 A 25 CMH2O, POR LO ANTERIOR SE REQUIERE SUMINISTRAR UN MANÓMETRO POR CADA UNO DE LOS BIENES O CIRCUITOS SOLICITADOS.
24	PAGINA 11 DE LAS	REFERENCIA: PAGINA 11 DE LAS BASES	REFERIRSE A LA





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Dpto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

	BASES	DICE EN BASES: PARA LA CLAVE 526.330.0054.00.00 HUMIDIFICADOR FISHER&PAYKEL MR850 SE INCLUYA EN LAS PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES SE ENTREGUE CON UN BLENDER (MEZCLADOR) PARA USO NEONATAL DE BAJO FLUJO QUE PERMITA UNA MEZCLA DE GASES PARA PROPORCIONAR UN FIO2 DEL 21 AL 100%, CON MANGUERAS DE CONEXIÓN COMPATIBLES A LAS TOMAS DE AIRE Y OXIGENO DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y QUE EL BLENDER SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE CPAP CLAVE 379.817.0282.00, ASÍ MISMO DEBERÁ DE CONTAR CON UNA BASE RODABLE, COMPATIBLE, ESPECÍFICO Y SEGURO PARA MONTAR EL HUMIDIFICADOR. PREGUNTA: PODRIA LA CONVOCANTE INDICAR A QUE NUMERO DE PARTIDA DEL ANEXO 1 DEL REQUERIMIENTO CORRESPONDE LA CLAVE 526.330.0054.00.00 Y A EFECTO NOS PROPORCIONEN LAS ESPECIFICACIONES COMPLETAS DE ESTA CLAVE SIENDO QUE NO APARECE EN NINGUNA FUENTE DE INFORMACION DICHA CLAVE. FAVOR DE ACLARAR.	ACLARATORIA NÚMERO 1 POR LA CONVOCANTE.
24	PAGINA 11 DE LAS BASES	REFERENCIA: PAGINA 11 DE LAS BASES DICE EN BASES: PARA LA CLAVE 526.330.0054.00.00 HUMIDIFICADOR FISHER&PAYKEL MR850 SE INCLUYA EN LAS PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES SE ENTREGUE CON UN BLENDER (MEZCLADOR) PARA USO NEONATAL DE BAJO FLUJO QUE PERMITA UNA MEZCLA DE GASES PARA PROPORCIONAR UN FIO2 DEL 21 AL 100%, CON MANGUERAS DE CONEXIÓN COMPATIBLES A LAS TOMAS DE AIRE Y OXIGENO DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y QUE EL BLENDER SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE CPAP CLAVE 379.817.0282.00, ASÍ MISMO DEBERÁ DE CONTAR CON UNA BASE RODABLE, COMPATIBLE, ESPECÍFICO Y SEGURO PARA MONTAR EL HUMIDIFICADOR.	REFERIRSE A LA ACLARATORIA NÚMERO 1 POR LA CONVOCANTE.





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		PREGUNTA: PODRIA LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI LA CLAVE 526.330.0054.00.00 ES PARTE INTEGRAL DE LA PARTIDA 1136 (AGRUPACION DE PARTIDAS) Y SI ESTA ES SIMILAR A LA CLAVE 526.330.0013.00.01 INDICADA Y A EFECTO SE PUEDA UTILIZAR UNA U OTRA DE MANERA INDISTINTA ESTO CON LA FINALIDAD DE EVITAR DUPLICIDADES. FAVOR DE ACLARAR.	
25	PAGINA 11 DE LAS BASES	REFERENCIA: PAGINA 11 DE LAS BASES DICE EN BASES: PARA LA CLAVE 526.330.0054.00.00 HUMIDIFICADOR FISHER&PAYKEL MR850 SE INCLUYA EN LAS PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES SE ENTREGUE CON UN BLENDER (MEZCLADOR) PARA USO NEONATAL DE BAJO FLUJO QUE PERMITA UNA MEZCLA DE GASES PARA PROPORCIONAR UN FIO2 DEL 21 AL 100%, CON MANGUERAS DE CONEXIÓN COMPATIBLES A LAS TOMAS DE AIRE Y OXIGENO DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y QUE EL BLENDER SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE CPAP CLAVE 379.817.0282.00, ASÍ MISMO DEBERÁ DE CONTAR CON UNA BASE RODABLE, COMPATIBLE, ESPECÍFICO Y SEGURO PARA MONTAR EL HUMIDIFICADOR. PREGUNTA: PODRIA LA CONVOCANTE INDICAR A QUE NUMERO DE PARTIDA DEL ANEXO 1 DEL REQUERIMIENTO CORRESPONDE LA CLAVE 379.817.0282.00, Y A EFECTO NOS PROPORCIONEN LAS ESPECIFICACIONES COMPLETAS DE ESTA CLAVE SIENDO QUE NO APARECE EN NINGUNA FUENTE DE INFORMACION DE DICHA CLAVE. FAVOR DE ACLARAR.	REFERIRSE A LA ACLARATORIA NÚMERO 1 POR LA CONVOCANTE.
26	PAGINA 11 DE LAS BASES	REFERENCIA: PAGINA 11 DE LAS BASES DICE EN BASES: PARA LA CLAVE 526.330.0054.00.00 HUMIDIFICADOR FISHER&PAYKEL MR850 SE INCLUYA EN LAS PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES SE ENTREGUE CON UN BLENDER (MEZCLADOR) PARA USO NEONATAL DE BAJO FLUJO QUE PERMITA UNA MEZCLA DE GASES	REFERIRSE A LA ACLARATORIA NÚMERO 1 POR LA CONVOCANTE.





		PARA PROPORCIONAR UN FIO2 DEL 21 AL 100%, CON MANGUERAS DE CONEXIÓN COMPATIBLES A LAS TOMAS DE AIRE Y OXIGENO DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y QUE EL BLENDER SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE CPAP CLAVE 379.817.0282.00, ASÍ MISMO DEBERÁ DE CONTAR CON UNA BASE RODABLE, COMPATIBLE, ESPECÍFICO Y SEGURO PARA MONTAR EL HUMIDIFICADOR. PREGUNTA: EN REFERENCIA A LA CLAVE 379.817.0282.00, ESTA LA INDICAN DE MANERA INCOMPLETA POR LO QUE SEGÚN NUESTRO EXPERTISE Y PARA UNA MEJOR CONDUCCION DEL EVENTO LA CLAVE CORRECTA ES LA SIGUIENTE: 379.817.0282.00.00 LA CUAL CUENTA CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: SISTEMA CPAP DE BURBUJA INCLUYE GENERADOR DE CPAP DE BURBUJAS, CIRCUITO CERRADO CALENTADO, CAMARA DE HUMIFICACION, TABULADURA DE PRESION AJUSTABLE DE 3 A 10 CMH20, VALVULA DE SEGURIDAD DE LIBERACION DE PRESION, PARA INTERFASE FLEXITRUNK . PRESENTACION CAJA CON 10 . NUMERO DE CATALOGO: BC161-10 PARA USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION CLAVE: 531.480.0128. MARCA FISHER & PAYKEL MODELO MR 850. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION	
27	PAGINA 11 DE LAS BASES	REFERENCIA: PAGINA 11 DE LAS BASES DICE EN BASES: PARA LA CLAVE 526.330.0054.00.00 HUMIDIFICADOR FISHER&PAYKEL MR850 SE INCLUYA EN LAS PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES SE ENTREGUE CON UN BLENDER (MEZCLADOR) PARA USO NEONATAL DE BAJO FLUJO QUE PERMITA UNA MEZCLA DE GASES PARA PROPORCIONAR UN FIO2 DEL 21 AL 100%, CON MANGUERAS DE CONEXIÓN COMPATIBLES A LAS TOMAS DE AIRE Y OXIGENO DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y QUE EL BLENDER SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE CPAP CLAVE 379.817.0282.00, ASÍ MISMO DEBERÁ	REFERIRSE A LA ACLARATORIA NÚMERO 1 POR LA CONVOCANTE.



		DE CONTAR CON UNA BASE RODABLE, COMPATIBLE, ESPECÍFICO Y SEGURO PARA MONTAR EL HUMIDIFICADOR. PREGUNTA: EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR FUESE EN SENTIDO POSITIVO, LE PREGUNTO A LA CONVOCANTE SI LA CLAVE 379.817.0282.00.00 ¿SE INTEGRA A LA PARTIDA 1136 (AGRUPACION DE PARTIDAS)? FAVOR DE ACLARAR	
28	PAGINA 11 DE LAS BASES	REFERENCIA: PAGINA 11 DE LAS BASES DICE EN BASES: PARA LA CLAVE 526.330.0054.00.00 HUMIDIFICADOR FISHER&PAYKEL MR850 SE INCLUYA EN LAS PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES SE ENTREGUE CON UN BLENDER (MEZCLADOR) PARA USO NEONATAL DE BAJO FLUJO QUE PERMITA UNA MEZCLA DE GASES PARA PROPORCIONAR UN FIO2 DEL 21 AL 100%, CON MANGUERAS DE CONEXIÓN COMPATIBLES A LAS TOMAS DE AIRE Y OXIGENO DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y QUE EL BLENDER SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE CPAP CLAVE 379.817.0282.00.00, ASÍ MISMO DEBERÁ DE CONTAR CON UNA BASE RODABLE, COMPATIBLE, ESPECÍFICO Y SEGURO PARA MONTAR EL HUMIDIFICADOR. PREGUNTA SE ENTIENDE QUE AL INCLUIR AMBAS CLAVES SIENDO ESTAS: 526.330.0054.00.00 Y LA 379.817.0282.00.00 POR TRATARSE DE LA MARCA FISHER & PAYKEL, LOS CIRCUITOS, EL CABLE CALEFACTOR Y SENSOR DE TEMPERATURA SOLICITADOS EN LA PARTIDA 1136 (AGRUPACION DE PARTIDAS) DEBERAN SER COMPATIBLES TANTO CON EL HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL Y CON EL GENERADOR DE BURBUJAS SOLICITADOS. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION	REFERIRSE A LA ACLARATORIA NÚMERO 1 POR LA CONVOCANTE.
29	PAGINA 11 DE LAS BASES	REFERENCIA: PAGINA 11 DE LAS BASES DICE: A) NORMAS: OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR (ANTES MEXICANA), INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN	REFERIRSE A LA ACLARATORIA NÚMERO 1 POR LA CONVOCANTE.





		TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS, CONFORME A LA LIC CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 4.28.4 DE LAS PRESENTES POBALINES Y, EN SU CASO, EL REGISTRO SANITARIO CORRESPONDIENTE. PREGUNTA: PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO ES CORRECTO INCLUIR EL REGISTRO SANITARIO, DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, OFICIOS DE LA COFEPRIS SEGÚN CORRESPONDA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO? FAVOR DE ACLARAR SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION O COMO SE DARA CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO.	
30	ANEXO 1	REFERENCIA: ANEXO 1 PARTIDAS: 232,233 Y 234 (MICRONEBULIZADOR) PREGUNTA: PODRIA LA CONVOCANTE INDICAR LAS ESPECIFICACIONES COMPLETAS DE LAS PARTIDAS INDICADAS. MUCHAS GRACIAS	PARA LA PARTIDA 232 SE REQUIERE DEL MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA TAMAÑO ADULTO. PARA LA PARTIDA 233 SE REQUIERE DEL MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA TAMAÑO PEDIÁTRICO. PARA LA PARTIDA 234 SE REQUIERE DEL MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA TAMAÑO ADULTO.
31	ANEXO 1	REFERENCIA: ANEXO 1 PARTIDA: 237 CLAVE: 379.643.0100.00.01 MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA CON TUBERIA DE 2.1 MTS DESECHABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 002433. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.423.0052 FLUJOMETRO DE PARED. MARCA: AGA. MODELO: MC PREGUNTA: PODRIA LA CONVOCANTE INDICAR PARA QUE TIPO DE PACIENTE REQUIEREN EL MICRONEBULIZADOR. MUCHAS GRACIAS	PARA LA PARTIDA 237 SE REQUIERE MASCARILLA TAMAÑO ADULTO.
33	ANEXO 1	REFERENCIA: ANEXO 1 PARTIDA: 444 CLAVE: 531.784.0022.00.01	EN LA PARTIDA 444 SE SOLICITA LA CLAVE 53172100930001, PUNTAS





		PREGUNTA: EL RESUCITADOR SOLICITADO ES ¿REUSABLE O DESECHABLE?, Y ¿QUE TAMAÑO REQUIEREN? FAVOR DE ACLARAR	PARA CAVITRON P-11, NO SE REFIERE A UN RESUCITADOR. SIN EMBARGO LA CLAVE 531.784.0022.00.01 SOLICITADA EN LA PARTIDA 445 DEL ANEXO 1 (UNO) SE REQUIERE SEA UN RESUCITADOR DESECHABLE TAMAÑO ADULTO.
32	ANEXO 1	REFERENCIA: ANEXO 1 PARTIDA: 446 CLAVE: 531.784.0204.03.01 PREGUNTA: EL REANIMADOR SOLICITADO ES ¿REUSABLE O DESECHABLE?, Y ¿QUE TAMAÑO REQUIEREN? SE REQUIERE ¿SENCILLO O REQUIEREN REFACCIONES ADICIONALES? FAVOR DE ACLARAR	PARA LA PARTIDA 446, EL RESUCITADOR SOLICITADO ES REUSABLE PARA PACIENTE ADULTO.
33	ANEXO 1	REFERENCIA: ANEXO 1 PARTIDA: 1136 AGRUPACION DE PARTIDAS PREGUNTA: PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR EN LUGAR DE LA CLAVE 526.330.0013.00.01, LA CLAVE SAI: 531.480.0128 HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADOR CON CALEFACCIÓN MARCA FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850. EL CUAL ES COMPATIBLE Y FUNCIONAL EN EL EQUIPO MÉDICO CLAVE: 531.941.1038.01, ASÍ COMO EN EQUIPOS MÉDICOS: SISTEMA DE CPAP Y EQUIPOS PARA PROPORCIONAR OXIGENOTERAPIA TAL Y COMO LO SOLICITA LA PRESENTE LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE DEL BIEN DE SUMINISTRO SOLICITADO 526.330.0013.00.01 REFERIDA AL GRUPO 526 ACCESORIOS DE EQUIPO MÉDICO Y DESCRITO EN EL ANEXO 1 (UNO) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
34	ANEXO 1	REFERENCIA: ANEXO 1 PARTIDA: 1136 AGRUPACION DE PARTIDAS PREGUNTA: PARA NO LIMITAR LA LIBRE	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CABALMENTE LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN DE SUMINISTRO SOLICITADO, LO CUAL DEBERÁ DE TENER





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes v Contratación de Servicios

		PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EN LA CLAVE 379.288.0159.00.01 PERMITA OFERTAR CUALQUIER MARCA DE LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y LAS ESPECIFICACIONES DE LA CLAVE SAI, YA QUE NO AFECTA SU FUNCIONAMIENTO Y ES COMPATIBLE CON SISTEMAS DE CPAP Y EQUIPOS PARA PROPORCIONAR OXIGENOTERAPIA, COMO LO SOLICITA LA PRESENTE LICITACIÓN ¿SE ACEPTA?	CORRESPONDENCIA Y CONGRUENCIA. LO ANTERIOR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
35	ANEXO 1	REFERENCIA: ANEXO 1 PARTIDA: 1136 AGRUPACION DE PARTIDAS PREGUNTA: PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EN LA CLAVE 379.604.1006.00.01 PERMITA OFERTAR CUALQUIER MARCA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y LAS ESPECIFICACIONES DE LA CLAVE SAI, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CABALMENTE LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN DE SUMINISTRO SOLICITADO, LO CUAL DEBERÁ DE TENER CORRESPONDENCIA Y CONGRUENCIA. LO ANTERIOR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
36	ANEXO 1	REFERENCIA: ANEXO 1 PARTIDA: 1136 AGRUPACION DE PARTIDAS PREGUNTA: PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EN LA CLAVE 379.604.1014.00.01 PERMITA OFERTAR CUALQUIER MARCA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y LAS ESPECIFICACIONES DE LA CLAVE SAI, YA QUE NO AFECTA SU	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CABALMENTE LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN DE SUMINISTRO SOLICITADO, LO CUAL DEBERÁ DE TENER CORRESPONDENCIA Y CONGRUENCIA. LO ANTERIOR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.





		FUNCIONAMIENTO ¿SE ACEPTA?	
37	ANEXO 1	REFERENCIA: ANEXO 1 PARTIDA: 1136 AGRUPACION DE PARTIDAS PREGUNTA: PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR EN LUGAR DE LA CLAVE 526.081.0568.00.01, LA CLAVE SAI: 379.156.9555.00.00 CABLE ADAPTADOR DE ALAMBRE CALENTADOR PARA CIRCUITOS RESPIRATORIOS CALENTADOS DE UNO Y DE DOS RAMALES COLOR AMARILLO. PRESENTACION: CAJA CON 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 900MR805. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO:MR850. EL CUAL CUMPLE CON LA FUNCIÓN DE ADAPTADOR DE ALAMBRE CALENTADOR PARA CIRCUITOS RESPIRATORIOS Y PUEDE EMPLEARSE EN SISTEMA DE CPAP Y EQUIPOS PARA PROPORCIONAR OXIGENOTERAPIA, COMO LO SOLICITA LA PRESENTE LICITACIÓN, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE DEL BIEN DE SUMINISTRO SOLICITADO 526.081.0568.00.01 REFERIDA AL GRUPO 526 ACCESORIOS DE EQUIPO MÉDICO Y DESCRITO EN EL ANEXO 1 (UNO) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
38		PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR EN LUGAR DE LA CLAVE 526.766.0495.00.01, LA CLAVE SAI: 379.822.0228.00.01 Sonda de TEMPERATURA P/HUMIDIFICADOR 900MR869. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 900MR869. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.480.0128 HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: 900MR858. EL CUAL CUMPLE CON LA FUNCIÓN SENSOR DE TEMPERATURA REUSABLE Y PUEDE EMPLEARSE EN SISTEMA DE CPAP Y EQUIPOS PARA PROPORCIONAR	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE DEL BIEN DE SUMINISTRO SOLICITADO 526.766.0495.00.01 REFERIDA AL GRUPO 526 ACCESORIOS DE EQUIPO MÉDICO Y DESCRITO EN EL ANEXO 1 (UNO) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		OXIGENOTERAPIA, COMO LO SOLICITA LA PRESENTE LICITACIÓN, ¿SE ACEPTA?	
39	ANEXO 1	REFERENCIA: ANEXO 1 PARTIDA: 1136 AGRUPACION DE PARTIDAS PREGUNTA: PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EN LUGAR DE LA CLAVE 379.200.3488.00.00 LA CLAVE SAI: 379.817.0282.00.00 CONSUMIBLE MEDIANTE EL CUAL PUEDE ADMINISTRARSE TERAPIA DE CPAP A PACIENTES NEONATALES Y CUENTA CON UN DISPOSITIVO LIMITANTE DE PRESIÓN Y FLUJO (MANIFOLD O TUBULADURA DE PRESIÓN) PARA PREVENIR DAÑOS PULMONARES POR SOBREPRESIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, TODA VEZ QUE NO SE SOLICITA ALGUNA PARTIDA CON LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE 379.200.3488.00.00 EN EL ANEXO 1 (UNO) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
40	ANEXO 1	REFERENCIA: ANEXO 1 PARTIDA: 1136 AGRUPACION DE PARTIDAS PREGUNTA: PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EN LUGAR DE LA CLAVE 379.200.3851.00.00 LA CLAVE SAI: 379.817.0282.00.00 CONSUMIBLE MEDIANTE EL CUAL PUEDE ADMINISTRARSE TERAPIA DE CPAP A PACIENTES NEONATALES Y CUENTA CON UN DISPOSITIVO LIMITANTE DE PRESIÓN Y FLUJO (MANIFOLD O TUBULADURA DE PRESIÓN) PARA PREVENIR DAÑOS PULMONARES POR SOBREPRESIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE DEL BIEN DE SUMINISTRO SOLICITADO 379.200.3851.00.00 REFERIDA AL GRUPO 526 ACCESORIOS DE EQUIPO MÉDICO Y DESCRITO EN EL ANEXO 1 (UNO) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
41	ANEXO 1	REFERENCIA: ANEXO 1	NO SE ACEPTA SU



		PARTIDA: 1136 AGRUPACION DE PARTIDAS PREGUNTA: PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EN LUGAR DE LA CLAVE 379.200.3869.00.00 LA CLAVE SAI: 379.817.0282.00.00 CONSUMIBLE MEDIANTE EL CUAL PUEDE ADMINISTRARSE TERAPIA DE CPAP A PACIENTES NEONATALES Y CUENTA CON UN DISPOSITIVO LIMITANTE DE PRESIÓN Y FLUJO (MANIFOLD O TUBULADURA DE PRESIÓN) PARA PREVENIR DAÑOS PULMONARES POR SOBREPRESIÓN. ¿SE ACEPTA?	SOLICITUD, APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE DEL BIEN DE SUMINISTRO SOLICITADO 379.200.3869.00.00 REFERIDA AL GRUPO 526 ACCESORIOS DE EQUIPO MÉDICO Y DESCRITO EN EL ANEXO 1 (UNO) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
42	ANEXO 1	REFERENCIA: ANEXO 1 PARTIDA: 1136 AGRUPACION DE PARTIDAS PREGUNTA: PARA REGULAR LA PRESIÓN DE LA SALIDA DE GASES DE LAS TOMAS MURALES DE LAS UNIDADES MÉDICAS, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLICITAR REGULADORES DE PRESIÓN EN EL SISTEMA CPAP PARA MANTENER REGULADA LA PRESIÓN ADMINISTRADA AL PACIENTE Y EVITAR DAÑOS PULMONARES POR SOBREPRESIÓN ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SOLICITUD PARA SU TECNOLOGÍA DEL SISTEMA OFERTADO NO SIENDO OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
43	PREGUNTA GENERAL	PREGUNTA GENERAL SE PUEDEN REFERENCIAR LAS CLAVES POR FAMILIA CUANDO ESTO APLIQUE, EN LOS REGISTROS SANITARIOS ESTO CON LA FINALIDAD DE NO HACER MAS GRANDES LOS EXPEDIENTES Y POR ENDE EL GASTO DE PAPEL. FAVOR DE ACEPTAR.	SE ACEPTA SU SOLICITUD. LO ANTERIOR SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
44	PREGUNTA GENERAL	PREGUNTA GENERAL SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER ENVIAR LAS	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, POR TRATARSE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL Y UN ACTO





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

		PROPOSICIONES LEGAL, TECNICA Y ECONOMICA POR PAQUETERIA, SIENDO RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LOS LICITANTES QUE ESTAS LLEGUEN ANTES DE LA FECHA DE APERTURA. FAVOR DE ACEPTAR EN BENEFICIO DE LA CONCURRENCIA.	FORMAL, LA PROPUESTA DEBERÁ ENTREGARSE EN SOBRE CERRADO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.
45	PREGUNTA GENERAL	PREGUNTA GENERAL EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR HAYA SIDO EN SENTIDO POSITIVO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA EFECTOS DE ENVIO DE LOS DOCUMENTOS, SIENDO QUE ASI LO SOLICITA EL SERVICIO DE PAQUETERIA, NOS INDIQUEN EL DEPARTAMENTO QUE RECIBE LAS PROPUESTAS, EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE Y EL NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO PARA HACER UN ENVIO EN TIEMPO Y FORMA, Y A EFECTO POSTERIORMENTE CONFIRMAR LA RECEPCION DEL PAQUETE. MUCHAS GRACIAS	FAVOR DE REMIITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA ANTERIOR.

A continuación conforme el tercer párrafo de la fracción I del artículo 46 del Reglamento de la Ley, se da oportunidad a los licitantes para que formulen preguntas en relación a las respuestas recibidas.

Repreguntas licitante: **CORPORATIVO MS SISTEMAS MÉDICOS, S.A. DE C.V.**

Pregunt a	Punto y/o Numeral	Aclaración	Respuesta IMSS
1	PREGUNTA 3 NUMERAL 2.3 NÚMERO 5	NOTA: ACTUALMENTE LAS EMPRESAS FABRICANTES SOLO CUENTAN O TRAMITAN EL CERTIFICADO ISO-13485 O TUV SEGÚN SEA EL CASO SIENDO SIENDO QUE ESTE ESPECIFICO O PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y POR TAL RAZÓN EL ISO-9001-2015 ES UNA EXTENSIÓN DE LOS	APEGARSE A LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA PRESENTANDO LOS DOS CERTIFICADOS ISO-9001-2015 E ISO-13485 O BIEN, PODRÁ PRESENTAR UNICAMENTE CERTIFICADO TUV.





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Dpto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Pregunt a	Punto y/o Numeral	Aclaración	Respuesta IMSS									
		CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO-13485. POR LO QUE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SOLO PRESENTAR EN NUESTRO CASO, EN PARTICULAR EL ISO13485 Ó TUV SEGÚN APLIQUE: FAVOR DE ACEPTAR.										
2	PREGUNTA 7 NÚMERAL 2.3 NÚMERO 9	RELATIVO A SU RESPUESTA, AÚN QUEDA LA DUDA DE INCLUIR LA COLUMNA DE FICHAS TÉCNICAS Y FOLLETOS, CATÁLOGO Y FOTOGRAFÍAS EN EL ANEXO 2 A, QUE TEXTO DEBE LLEVAR DICHA COLUMNA PARA DAR CUMPLIMIENTO, ES DECIR, SI DEBEMOS PONER SI SE CUMPLE, SE INCLUYE O FOLIO DONDE SE ENCUENTRA DICHO CATÁLOGO O INFORMACIÓN, FAVOR DE ACLARAR.	DEBERÁ REFERENCIAR LA UBICACIÓN CON NOMBRE DEL CATALOGO, FOLLETO O DOCUMENTAL TÉCNICA, DESCRIBIENDO LA PÁGINA Y FOLIO. LO CUAL DEBERÁ ESTAR INCERTO A PARTIR DE LA CELDA M A LA R DEL ANEXO NÚMERO 2 A. EJEMPLO:									
			<table><tr><th>DESCRIPCIÓN ARTICULO COMPLETA OFERTADA POR EL LICITANTE</th><th>PAIS DE ORIGEN</th><th>NO. REGISTRO SANITARIO Y VIGENCIA</th><th>No. CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001, ISO 13485 o TUV Y VIGENCIA</th><th>No. CERTIFICAD O DE CALIDAD FDA, CE o PAIS DE ORIGEN Y VIGENCIA</th><th>No. CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN Y VIGENCIA</th></tr><tr><td>EJEMPLO: CABLE PARA ECG 5 DERIVACIONE S,,,,, DOCUMENTAL TECNICA CATALOGO DE OPERACIÓN ADVANCE , PAGINA 25 FOLIO 0040.</td><td>EJEMPLO: IRLANDA REGISTR O SANITARI O NO. XXX FOLIO DOCUME NTAL TECNICA 00150</td><td>EJEMPLO: REGISTRO SANITARIO NO. XXX VIGENCIA 12 SEPTIEMBR E 2025, DOCUMEN TAL TECNICA FOLIO 00150 AL 00155</td><td>EJEMPLO: CERTIFICADO ISO 9002015 NO. XXXXX VIGENCIA 12 ENERO 2024 , DOCUMENTAL TECNICA FOLIO 00180 AL 00185, CERTIFICADO ISO 13485 NO. YYYYY, VIGENCIA 15 JULIO 2024, DOCUMENTAL TECNICA FOLIO 00186 AL 00190</td><td>EJEMPLO: CERTIFICADO FDA NO. XXXXX VIGENCIA 30 JUNIO 2023, DOCUMENT AL TECNICA FOLIO 00195 AL 00200,</td><td>N/A</td></tr></table>	DESCRIPCIÓN ARTICULO COMPLETA OFERTADA POR EL LICITANTE	PAIS DE ORIGEN	NO. REGISTRO SANITARIO Y VIGENCIA	No. CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001, ISO 13485 o TUV Y VIGENCIA	No. CERTIFICAD O DE CALIDAD FDA, CE o PAIS DE ORIGEN Y VIGENCIA	No. CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN Y VIGENCIA	EJEMPLO: CABLE PARA ECG 5 DERIVACIONE S,,,,, DOCUMENTAL TECNICA CATALOGO DE OPERACIÓN ADVANCE , PAGINA 25 FOLIO 0040.	EJEMPLO: IRLANDA REGISTR O SANITARI O NO. XXX FOLIO DOCUME NTAL TECNICA 00150	EJEMPLO: REGISTRO SANITARIO NO. XXX VIGENCIA 12 SEPTIEMBR E 2025, DOCUMEN TAL TECNICA FOLIO 00150 AL 00155
DESCRIPCIÓN ARTICULO COMPLETA OFERTADA POR EL LICITANTE	PAIS DE ORIGEN	NO. REGISTRO SANITARIO Y VIGENCIA	No. CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001, ISO 13485 o TUV Y VIGENCIA	No. CERTIFICAD O DE CALIDAD FDA, CE o PAIS DE ORIGEN Y VIGENCIA	No. CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN Y VIGENCIA							
EJEMPLO: CABLE PARA ECG 5 DERIVACIONE S,,,,, DOCUMENTAL TECNICA CATALOGO DE OPERACIÓN ADVANCE , PAGINA 25 FOLIO 0040.	EJEMPLO: IRLANDA REGISTR O SANITARI O NO. XXX FOLIO DOCUME NTAL TECNICA 00150	EJEMPLO: REGISTRO SANITARIO NO. XXX VIGENCIA 12 SEPTIEMBR E 2025, DOCUMEN TAL TECNICA FOLIO 00150 AL 00155	EJEMPLO: CERTIFICADO ISO 9002015 NO. XXXXX VIGENCIA 12 ENERO 2024 , DOCUMENTAL TECNICA FOLIO 00180 AL 00185, CERTIFICADO ISO 13485 NO. YYYYY, VIGENCIA 15 JULIO 2024, DOCUMENTAL TECNICA FOLIO 00186 AL 00190	EJEMPLO: CERTIFICADO FDA NO. XXXXX VIGENCIA 30 JUNIO 2023, DOCUMENT AL TECNICA FOLIO 00195 AL 00200,	N/A							

Repreguntas licitante: **MALER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y APARATOS MÉDICOS, S.A. DE C.V.**

PLAN DE CVT															
Pregunta	Punto y/o Numeral	Aclaración	Respuesta IMSS												
1	RESPUESTA A LA PREGUNTA NÚMERO 5	EN EL ENTEDIDO QUE PARA CUMPLIR CON LA PROPUESTA TÉCNICA, DEBEMOS PRESENTAR DEBIDAMENTE REQUISITADO EL	PARA LAS PARTIDAS:												
			<table><tr><th>No</th><th>DICE</th><th>DEBE DECIR:</th></tr><tr><td>481</td><td>53553500980101</td><td>53570100980101</td></tr><tr><td>482</td><td>53553501780001</td><td>53531601780001</td></tr><tr><td>483</td><td>53553501860001</td><td>53531601860001</td></tr></table>	No	DICE	DEBE DECIR:	481	53553500980101	53570100980101	482	53553501780001	53531601780001	483	53553501860001	53531601860001
			No	DICE	DEBE DECIR:										
			481	53553500980101	53570100980101										
			482	53553501780001	53531601780001										
483	53553501860001	53531601860001													





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Pregunta	Punto y/o Numeral	Aclaración	Respuesta IMSS												
		ANEXO 2 A CON LAS PARTIDAS DE NUESTRA REPRESENTADA ESTÉ INTERESADA EN PARTICIPAR, HACEMOS LA ACLARACIÓN DE EXISTEN VARIA CLAVES DEL ANEXO 1 QUE EL GRUPO Y GENERO SE ENCUENTRA DUPLICADO EL NÚMERO, POR LO QUE SOLICITAMOS A ALA CONVOCANTE PROPORCIONAR LA CLAVE CORRECTA O SI EL LISTADO ADJUNTO, CONFIRMAR SI LAS CLAVES QUE SE AGREGAN AL FINAL DE LA COLUMNA SON CORRECTAS. FAVOR DE ACLARAR.	484	53553501940001	53531601940001										
			485	53553502510001	53531602510001										
			486	53553505710001	53560805710001										
			491	53551617350201	53571617350201										
			493	53553526720101	53585926720101										
			494	53553548430001	53570148430001										
			495	53553549420101	53585949420101										
			497	53553564950101	53581464950101										
			986	53753701920101	53770201920101										
			987	53753702000001	53770202000001										
			988	53753702370001	53785702370001										
			989	53753703290001	53713803290001										
			990	53753703300001	53745703300001										
			991	53753704650101	53717304650101										
			992	53753704810101	53717304810101										
			993	53753705760001	53713805760001										
			998	53753782570101	53781482570101										
			999	53753784830101	53770384830101										
	RESPUESTA A LA PREGUNTA NÚMERO 5	PARA CONFIRMAR LA RESPUESTA OTORGADA, PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO ENTENDEMOS QUE DEBEMOS ENTREGAR EL ANEXO 2 A, COMPLEMENTANDO CON UNA COLUMNA CON EL NÚMERO DE CATALOGO DEL FABRICANTE DE LAS PARTIDAS A OFERTAR, ES CORRETA NUESTRA APRECIACIÓN	DEBERÁ REFERENCIAR LA UBICACIÓN CON NOMBRE DEL CATALOGO, FOLLETO O DOCUMENTAL TÉCNICA, DESCRIBIENDO LA PÁGINA Y FOLIO. LO CUAL DEBERÁ ESTAR INCERTO A PARTIR DE LA CELDA M A LA R DEL ANEXO NÚMERO 2 A. EJEMPLO:												
			<table><tr><th>DESCRIPCIÓN ARTICULO COMPLETA OFERTADA POR EL LICITANTE</th><th>PAIS DE ORIGEN</th><th>NO. REGISTRO SANITARIO Y VIGENCIA</th><th>No. CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001, ISO 13485 o TUV Y VIGENCIA</th><th>No. CERTIFICADO DE CALIDAD FDA, CE o PAIS DE ORIGEN Y VIGENCIA</th><th>No. CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN Y VIGENCIA</th></tr><tr><td>EJEMPLO: CABLE PARA ECG 5 DERIVACIONES,..... DOCUMENTAL TECNICA CATALOGO DE OPERACIÓN ADVANCE , PAGINA 25 FOLIO 0040.</td><td>EJEMPLO: IRLANDA REGISTRO SANITARIO NO. XXX FOLIO DOCUMENTAL TECNICA 00150</td><td>EJEMPLO: REGISTRO SANITARIO NO. XXX VIGENCIA 12 SEPTIEMBRE 2025, DOCUMENTAL TECNICA FOLIO 00150 AL 00155</td><td>EJEMPLO: CERTIFICADO ISO 9002015 NO. XXXXX VIGENCIA 12 ENERO 2024 , DOCUMENTAL TECNICA FOLIO 00180 AL 00185, CERTIFICADO ISO 13485 NO. YYYY, VIGENCIA 15 JULIO 2024, DOCUMENTAL</td><td>EJEMPLO: CERTIFICADO FDA NO. XXXXX VIGENCIA 30 JUNIO 2023, DOCUMENTAL TECNICA FOLIO 00195 AL 00200,</td><td>N/A</td></tr></table>	DESCRIPCIÓN ARTICULO COMPLETA OFERTADA POR EL LICITANTE	PAIS DE ORIGEN	NO. REGISTRO SANITARIO Y VIGENCIA	No. CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001, ISO 13485 o TUV Y VIGENCIA	No. CERTIFICADO DE CALIDAD FDA, CE o PAIS DE ORIGEN Y VIGENCIA	No. CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN Y VIGENCIA	EJEMPLO: CABLE PARA ECG 5 DERIVACIONES,..... DOCUMENTAL TECNICA CATALOGO DE OPERACIÓN ADVANCE , PAGINA 25 FOLIO 0040.	EJEMPLO: IRLANDA REGISTRO SANITARIO NO. XXX FOLIO DOCUMENTAL TECNICA 00150	EJEMPLO: REGISTRO SANITARIO NO. XXX VIGENCIA 12 SEPTIEMBRE 2025, DOCUMENTAL TECNICA FOLIO 00150 AL 00155	EJEMPLO: CERTIFICADO ISO 9002015 NO. XXXXX VIGENCIA 12 ENERO 2024 , DOCUMENTAL TECNICA FOLIO 00180 AL 00185, CERTIFICADO ISO 13485 NO. YYYY, VIGENCIA 15 JULIO 2024, DOCUMENTAL	EJEMPLO: CERTIFICADO FDA NO. XXXXX VIGENCIA 30 JUNIO 2023, DOCUMENTAL TECNICA FOLIO 00195 AL 00200,	N/A
DESCRIPCIÓN ARTICULO COMPLETA OFERTADA POR EL LICITANTE	PAIS DE ORIGEN	NO. REGISTRO SANITARIO Y VIGENCIA	No. CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001, ISO 13485 o TUV Y VIGENCIA	No. CERTIFICADO DE CALIDAD FDA, CE o PAIS DE ORIGEN Y VIGENCIA	No. CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN Y VIGENCIA										
EJEMPLO: CABLE PARA ECG 5 DERIVACIONES,..... DOCUMENTAL TECNICA CATALOGO DE OPERACIÓN ADVANCE , PAGINA 25 FOLIO 0040.	EJEMPLO: IRLANDA REGISTRO SANITARIO NO. XXX FOLIO DOCUMENTAL TECNICA 00150	EJEMPLO: REGISTRO SANITARIO NO. XXX VIGENCIA 12 SEPTIEMBRE 2025, DOCUMENTAL TECNICA FOLIO 00150 AL 00155	EJEMPLO: CERTIFICADO ISO 9002015 NO. XXXXX VIGENCIA 12 ENERO 2024 , DOCUMENTAL TECNICA FOLIO 00180 AL 00185, CERTIFICADO ISO 13485 NO. YYYY, VIGENCIA 15 JULIO 2024, DOCUMENTAL	EJEMPLO: CERTIFICADO FDA NO. XXXXX VIGENCIA 30 JUNIO 2023, DOCUMENTAL TECNICA FOLIO 00195 AL 00200,	N/A										





Pregunta	Punto y/o Numeral	Aclaración	Respuesta IMSS					
						TECNICA FOLIO 00186 AL 00190		

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, en este acto se da a conocer el calendario de los eventos subsecuentes de esta licitación, que a continuación se detalla:

EVENTO	FECHA	HORA
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	16 de agosto de 2022	11:00 hrs.
Comunicación y entrega de Fallo	23 de agosto de 2022	11:00 hrs.

Dichos eventos se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, en los horarios establecidos, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social, de conformidad con el artículo 39 y 47 del Reglamento de la Ley.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en el pizarrón de avisos de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Libramiento Poniente I.P.N., sin número San Diego Metepec, Tlaxcala, C.P. 90110, en donde se fijará el Acta o un ejemplar por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.hacienda.gob.mx.

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta primera y última junta siendo las 14:10 horas del mismo día, mes y año de su inicio.

Esta Acta consta de 68 hojas firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LOS LICITANTES:





GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Dpto. De Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL	FIRMA
GERARDO MANZANO NOLASCO	CORPORATIVO MS SISTEMAS MÉDICOS, S.A. DE C.V	
MARIA I. ROMERO B	MALER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y APARATOS MÉDICOS, S.A. DE C.V.	

**POR EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ESTATAL TLAXCALA**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Oscar Rolando Ávila Galván	Encargado Del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Guillermo Villanueva García	Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Itsel Analy Hernández Cortés	Líder de Proyectos	
Carlos Joel Barrera Velázquez	Coordinador Biomédico Delegacional	
Marcela Cuahutle Romano	Enfermera Supervisora en Atención Médica	
Dr. Ángel Alberto Olea Rivera	Coordinador Auxiliar de Estomatología	

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
NO ASISTIO REPRESENTACIÓN**

**POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS
NO ASISTIO REPRESENTACIÓN**

----- FIN DEL ACTA -----

