



Para: LIC. DAVID ADAIR ARAGON CARDENAS Jefe de Departamento de Adquisiciones.		
De: Dra. Jazmín De Anda González Jefa de Departamento de Anatomía Patológica		Prioridad: 1
Lugar: Ciudad de México.	Fecha: 24 de marzo de 2025.	Hora: 12:00 hrs
Asunto: Dictámen técnico de adquisición de reactivos de inmunohistoquímica e hibridación in situ, Grupo 379 y 540 para el servicio de Laboratorio de Anatomía Patológica	REF.No.HO/PATO/00058/2025.	

**ESTIMADO LIC. ARAGÓN CÁRDENAS
PRESENTE**

Por medio de la presente, envío un cordial saludo y el dictamen técnico para los productos enviados por once proveedores que enviaron sus propuestas técnicas, con respecto a la Adquisición de Reactivos de Inmunohistoquímica y Biología Molecular para el Servicio de Anatomía Patológica, para el ejercicio 2025, Grupo 379 y 540, evento: **LA-50-GYR-050GYR051-T-9-2025.**

Se analizaron las fichas técnicas de cada proveedor y se realizó un análisis minucioso en base al requerimiento técnico, los equipos recién adquiridos y el proceso implementado en el servicio de Anatomía Patológica de nuestra unidad, con lo cual se emite el siguiente análisis:

Para el proveedor **ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA SA DE CV**
RFC: AIE090420AEB

Las observaciones son las siguientes:
De 184 partidas ofertadas el participante:

- a) No ofertó: 58
- b) Si cumple con requerimientos en 74 partidas
- c) No cumple con requerimientos en 52 partidas.


A) PARTIDAS NO OFERTADAS:

1, 10, 14, 24, 53, 73, 76, 98, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 19, 160
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
181, 182, 183, 184

B) PARTIDAS QUE SI CUMPLEN CON REQUERIMIENTOS

De las 184 partidas ofertadas 74 partidas cumplen con los requisitos establecidos en cada una de las cédulas de requerimientos emitidas. Del total de partidas ofertadas por el proveedor, los productos corresponden a anticuerpos marca DIAGNOSTIC BIOSYSTEM, algunos de los cuáles se han usado previamente en el departamento, con diferentes recuperadores y diluyentes, sin exclusividad del sistema propuesto por el proveedor.

5, 6, 8, 12, 13, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49
50, 51, 52, 54, 55, 57, 58
62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 74, 75,
80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 99
100, 101, 102, 105, 107, 109, 110,
111, 113, 114, 116, 117, 118, 123, 124, 125

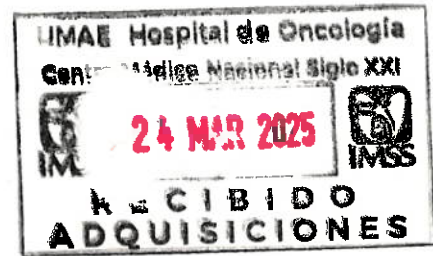





C) PARTIDAS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS

Estas partidas que no cumplen requerimientos técnicos son ofertados como monoclonales cuando la solicitud requiere policlona, se oferta de ratón cuando se solicita de conejo, y los viales ofertados no son los volúmenes requeridos.

2,3,4,7,9,11,15,16,17,18,19,
21,22,29,33,34,35,47,56,59,
60,61,63,68,72,77,78,79,82,
88,89,94,96,103,104,106,108,
112,115,119,120,121,122,126,
127,128,129,130,131,132,133,134

**2) Para el proveedor ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO SA DE CV
RFC: APE950801FJ4**

Las observaciones son las siguientes:

A) PARTIDAS NO OFERTADAS: 142

1,2,3,5,6,8,10,11,12,13,14,16,17,18,19
21,22,24,28,31,32,36,37,38,40,41,42,
43,44,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59
60,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,
80,82,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99,
100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,
110,111,112,113,115,116,117,118,119,
120,121,122,123,124,125,
130,131,132,133,134,
140,141,142,143,145,146,147,148,149,
150,151,152,156,157,158,159
160,164,165,166,167,168,169
170,171,172,173,174,175,176,177,178,179
180,181,182,183,184

B) PARTIDAS QUE SI CUMPLEN REQUERIMIENTOS: 6

15,23,90,135,136,137

Estas partidas cumplen requerimientos solicitados en las respectivas fichas técnicas, tanto de mono o policlona, tipo de inserto y cantidad solicitada de los viales

C) PARTIDAS QUE NO CUMPLEN CON REQUERIMIENTOS: 36

4,7,9,20,25,26,27,29,30,33,34,35,39,
46,47,58,63,65,74,81,83,92,114,126,
127,128,129,138,139,144,153,154,155
161,162,163

Estas partidas no cumplen requerimiento al ofertar anticuerpos listos para usarse, y requerirse en ficha técnica anticuerpos concentrados. Las fichas técnicas sugieren un diluyente específico de marca con el que no se cuenta y no se tiene contemplado el costo extra por lo que no es posible iniciar su uso en el Departamento.

Todas las clonas ofertadas son diferentes a las solicitadas

**3) PROVEEDOR COMERCIAL BIOMÈDICA JR S.A DE C.V
RFC CBJ060511U14**

Las observaciones son las siguientes:



De 184 partidas de la licitación, ofertó 45, de las cuáles 30 si cumplieron los requerimientos, 15 no cumplieron; No ofertó: 139 partidas

Las 45 partidas cumplen con los requerimientos solicitados en las fichas técnicas en base a las fichas enviadas de los anticuerpos solicitados.

Las diluciones o concentraciones son las solicitadas en las fichas técnicas

Cuenta con los requisitos de COFEPRIS, y de FDA para la calidad y control de los anticuerpos.

Cabe mencionar que estos anticuerpos se han usado previamente en el Departamento de Anatomía Patológica con buenos resultados, con sistemas de detección genéricos y diluyentes sin marca en particular.

A)PARTIDAS NO OFERTADAS

1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,17,18,
20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,36,39,
40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,59,
60,63,65,66,67,68,69,72,73,75,76,77,79,
80,84,85,86,87,89,91,92,93,97,98,99,100,
102,103,105,106,109,110,111,112,113,114,117,
120,121,122,123,125,126,127,128,129,130,
131,132,133,134,136,138,139,140,141,142,143,144,145,
146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159
160,161,162,163,171,172,173,174,175,176,177,178,179,
180,181,182,183,184

B)PARTIDAS QUE SI CUMPLEN REQUERIMIENTOS

19,34,35,64,71,74,78,82,88,90,94,95,96,
101,104,108,115,116,118,124,135,137,
164,165,166,167,168,169,170

C)PARTIDAS QUE NO CUMPLEN REQUERIMIENTOS

Las observaciones son las siguientes:

4: clona diferente a la solicitada

9: se solicita clona de conejo, oferta de ratón

27: oferta vial diferente al solicitado

29: oferta CD3 y se solicita CD3 Epsilon, clona diferente a la solicitada

37 y 38: oferta clona diferente a la solicitada (ratón x conejo)

55 y 58: oferta anticuerpo monoclonal, similar a ficha técnica sin embargo la clona No es la solicitada

61: No hay ficha técnica para evaluar.

62,70, 81, 83, 107 y 119: se solicita anticuerpo de ratón y oferta conejo, clona diferente a la solicitada

4) CORPORATIVO PROVEEDOR DE EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIO, S.A

De las 184 partidas ofertadas el proveedor participó con lo siguiente:

3 partidas de las cuales 1 no cumple con los requerimientos, 2 si cumplen y 181 no ofertadas

El análisis es el siguiente:

A)PARTIDAS NO OFERTADAS

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70
71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90
91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,
111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,
131,132,133,134,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,
151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,
171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184



B) PARTIDAS QUE SI CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS

136 y 137: si cumple con los requerimientos de ficha técnica en relación fabricación de acero inoxidable y dimensiones de largo, alto y grosor

C) PARTIDAS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS

135: No cumple con ficha técnica ni requerimiento de ficha técnica de impresora de cassette estipulado en términos y condiciones

5) Para el proveedor DIAGNOCELL LABORATORIOS, S.A DE C.V.

De 184 partidas, el proveedor ofertó lo siguiente:

-27 partidas de las cuáles 2 cumplen requerimientos de ficha técnica, 25 que no cumplen y 157 que no oferto.

El análisis fué el siguiente:

A) PARTIDAS NO OFERTADAS

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,20,
21,22,23,24,26,28,30,33,34,35,38,39,40,
41,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,60,
61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,
81,82,83,84,86,89,90,91,93,95,96,97,98,99,101,102,103,104,105,
106,109,110,111,112,113,114,117,118,119,120,121,122,123,125,
126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,
145,146,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,
166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184

B) PARTIDAS QUE SI CUMPLEN REQUERIMIENTOS

6: cumple con requerimiento de ser anticuerpo monoclonal, de ratón y clona solicitada

94: cumple con característica de ser monoclonal, de conejo, clona solicitada, así como vial de 1ml concentrado

C) PARTIDAS QUE NO CUMPLEN REQUERIMIENTOS

Estas partidas cuentan todas las fichas técnicas con la leyenda específica de RECONSTITUCIÓN, MEZCLA Y DILUCIÓN: **“El anticuerpo concentrado esta optimizado para diluirlo en el rango de dilución con Cell Marque Diamond Antibody Diluent”.**

No se contempló una partida en especial para la compra de diluyente marca específico de anticuerpos, el Departamento cuenta con diluyente “genérico” sin ser específico de marcas en particular. Agregada a esta leyenda que aparece en cada ficha técnica analizada se detectaron las siguientes características:

-15: Leyenda de uso únicamente in vitro, con dilución muy baja por lo que el número de pruebas será menor al esperado con otros anticuerpos con dilución mayor

-19: se solicita anticuerpo policlonal en ficha técnica, se oferta monoclonal, con clona específica

-25: se solicita anticuerpo de ratón, oferta de conejo, la clona ofertada es diferente a la solicitada

-27: menciona diluyente específico, baja dilución referida en ficha técnica con menor rendimiento en el número de pruebas

-29: se solicita anticuerpo monoclonal recombinante CD3 EPSILON, se oferta monoclonal de conejo y CD3 genérico, no cumple con ficha técnica

-31: solicita diluyente específico de marca

-32: se solicita vial de 200 microlitros y se oferta vial de 1 mililitro, con coincide con requerimiento de ficha

-36,37,42: oferta clona diferente a la solicitada en ficha técnica

-43: se solicita anticuerpo monoclonal de ratón y en ficha se oferta monoclonal de conejo. La presentación solicitada es de 200 microlitros y se oferta de 1 mililitro

-58: se solicita anticuerpo monoclonal de ratón y se oferta monoclonal de conejo, la clona es diferente a la solicitada en ficha técnica

-59: oferta clona específica de marca





- 75: se solicita presentación de vial de 100 Ul y se oferta vial de 1 mililitro
- 85: se solicita anticuerpo monoclonal de ratón y oferta monoclonal de conejo, la clona ofertada es diferente a la solicitada
- 87: se oferta clona diferente a la solicitada en ficha técnica
- 88: se solicita vial de 0.5ml y se oferta vial de 1.9 mililitros
- 92, 100, 107: solicita diluyente específico
- 108: la presentación del anticuerpo se solicita de 50ul en ficha técnica, se oferta vial de 0.1ml concentrado, sin especificar en la propuesta económica el costo total del equivalente
- 115 y 116: marca diluyente marca-específico
- 124: se solicita anticuerpo policlonal en ficha técnica y se oferta monoclonal
- 147: se cotiza únicamente caja con 1 paquete de laminillas con 12 unidades, no se cotiza de manera adecuada 12 cajas con 10 paquetes cada una.

6)MCD SERVICIOS INTEGRALES DE DIAGNOSTICOS S.A DE C.V.

De 184 partidas de la licitación el proveedor ofertó 143 partidas de las cuáles 83 si cumplieron con requerimientos de fichas técnicas, 40 no cumplieron y SIN participar en 61.

EL análisis fué el siguiente:

A)PARTIDAS NO OFERTADAS

1,3,12,13,14,16,17,18,21,24,36,45,
52,53,66,67,68,76,84,89,98,108,109,110,111,122,125,
132,134,135,136,137,142,143,145,146,148,150,
152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,164,165,166,167,168,169,
170,173,177,178,182,183,184

B)PARTIDAS QUE SI CUMPLEN CON REQUERIMIENTO

Estas partidas cumplen requisitos en relación a mono o policlonalidad, a inserto de ratón o conejo y a clona solicitada.

4,5,6,7,8,10,15,19,20,22,23,25,26,27,28,29,31,32,34,35,37,
42,44,46,47,48,49,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,69,
70,71,72,73,74,75,78,79,80,83,85,86,87,90,
92,93,94,95,96,97,99,100,101,104,105,106,
112,113,114,115,116,117,119,120,121,123,124,
171,172,174,175,176,179,180,181

C)PARTIDAS QUE NO CUMPLEN CON REQUERIMIENTO

- 2: se solicita anticuerpo monoclonal y se solicita policlonal, la clona es diferente a la solicitada
- 9: se solicita anticuerpo monoclonal de conejo y se oferta monoclonal de ratón
- 11: se solicita vial de 100ul y se oferta vial de 3ml sin especificar si es anticuerpo concentrado o diluido
- 30, 33: se solicita vial de 100ul y se oferta vial de 3ml sin especificar si es anticuerpo concentrado o diluido, la clona es diferente a la solicitada
- 38, 39, 43,50, 51,60: se solicita anticuerpo monoclonal de ratón, se oferta de conejo; la clona ofertada es diferente a la solicitada
- 40, 65, 77, 81, 82,91,103, 107, 118, 126: se solicita monoclonal de conejo y se oferta de ratón, la clona ofertada es diferente a la solicitada
- 41: se solicita anticuerpo monoclonal y se oferta policlonal, se solicita de ratón y se oferta de conejo, la clona ofertada es diferente a la solicitada
- 88: se solicita anticuerpo monoclonal de conejo y se oferta ratón, el volumen del vial solicitado es diferente al ofertado
- 102: se solicita anticuerpo monoclonal de conejo y se oferta de ratón; se solicita PAX-6 y se oferta PAX5
- 127, 128, 129: la clona ofertada es diferente a la solicitada, la presentación es diferente
- 130,131, 133, 138: la clona ofertada es diferente a la solicitada
- 139,140,141,144: no cumplen volúmenes de dispensadores y composición solicitada de cada kit





- 147: no cumple con las especificaciones de las dimensiones solicitadas
- 149: no cumple con las especificaciones de marcha y equipo
- 151,162,163: oferta número de pruebas diferentes a la solicitadas

7) MEXICO BIOCARE REPRESENTANTE S.A. DE C.V.

De 184 partidas ofertadas, el proveedor participó con 40 de las cuáles 14 si cumplen con los requerimientos, 26 no cumplen con los requerimientos de las fichas técnicas y 144 no ofertó EL análisis es el siguiente:

A) PARTIDAS NO OFERTADAS

1,5,10,14,22,24,28,31,32,36,72,73,77,95,
101,103,106,110,111,112,117,127,135,136,137,138,139,
140,141,142,143,144,145,146,148,149,150,
151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,
161,162,163,164,165,166,167,168,169,170

B) PARTIDAS QUE SI CUMPLEN CON REQUERIMIENTOS

Estas partidas cumplen con los requisitos de la ficha técnica en relación a mono o policlonalidad, insertos de taton o conejo y volumen de los viales.

3,4,6,7,8,9,11,13,15,18,20,23,25,26,27,30
34,37,38,39,40,41,42,44,45,46,48,49,50,
51,52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,68,69,70,
71,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
91,92,93,94,98,99,100,102,104,105,107,108,109,
113,115,116,118,119,120,121,122,123,124,125,
171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184

C) PARTIDAS QUE NO CUMPLEN CON REQUERIMIENTOS

Las siguientes partidas cuentan con las siguientes observaciones:

- 2, 12,21: se solicita anticuerpo monoclonal y oferta policlonal, la clona solicitada es diferente a la ofertada
- 16,17: se solicita anticuerpo monoclonal y oferta policlonal: se solicita anticuerpo de ratón y oferta de conejo
- 19: se solicita anticuerpo policlonal y oferta monoclonal, se solicita de conejo y oferta de ratón
- 29: se solicita CD3 EPSILON, se oferta CD3 genérico
- 33: se solicita clona diferente a la ofertada
- 35,96, 97: se solicita anticuerpo monoclonal de conejo y se oferta de ratón
- 43: se solicita anticuerpo monoclonal de raton y se oferta de conejo, la presentación del anticuerpo es diferente a la solicitada
- 47: 59,60,67,
- 114: se solicita anticuerpo monoclonal de conejo y se oferta anticuerpo policlonal
- 126: se presenta leyenda en ficha técnica de específico de protocolo IntelliPath, solamente para investigación
- 128,129,130,131,132,133,134: anticuerpos ofertados de clonas diferentes a las solicitadas, solo para uso in vitro, la presentación no concuerda con la solicitada; se especifica uso en equipo ONCORE con diluyentes y sistemas de detección específicos de marca
- 147: o cumple con especificaciones de ficha técnica de cantidad por número de paquetes y cajas.

8) ONCOSEQUENCING S.A.S. DE C.V.

De las 184 partidas ofertadas, el proveedor participo con 36, de las cuales 35 que si cumplen, sin ofertar 148.

Las 35 partidas cumplen con los requisitos establecidos en las cédulas de requerimiento emitidas. Cuenta con los requerimientos de carta de apoyo de proveedor, registro sanitario y COFEPRIS, con fichas que avalan el uso de estas partidas como parte de compaignon diagnostic.



La partida 147 no cumple.

No omito mencionar que los anticuerpos de esta marca han sido usados previamente en nuestro laboratorio de patología, con resultados satisfactorios y que cumplen con los registros sanitarios correspondientes así como el control de calidad solicitado en base a los estándares internacionales requeridos.

A)PARTIDAS NO OFERTADAS

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,
101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,
121,122,123,124,125,135,136,137,164,165,166,167,168,169,170,
171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,
181,182,183,184

B)PARTIDAS QUE SI CUMPLEN

1,126,127,128,129,130,131,132,133,134,138,139,140,
141,142,143,144,145,146,148,149,150,
151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,
161,162,163

C)PARTIDAS QUE NO CUMPLEN

147. No concuerda con lo que presenta en marca.

9)PROVEEDORA DE MATERIALES Y REACTIVOS BIOQ S.A. DE C.V.

El proveedor participó con 19 partidas de las cuales 7 si cumplen con los requerimientos de las ficha técnicas, 12 no cumplen y sin participar en 165.

A)PARTIDAS QUE NO OFERTO

1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,14,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30
31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,
53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,
91,92,93,94,95,96,97,98,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,
110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,
120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,
130,131,132,133,134,135,138,139,
140,141,142,145,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,
160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,
171,172,173,174,175,176,177,178,179,
180,181,182,183,184

B)PARTIDAS QUE SI CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS

25,51,85,90,99,136,137

Estas partidas cumplen con los requerimientos de las fichas técnicas solicitadas

C)PARTIDAS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS

Estas partidas tienen las siguientes observaciones:

- 7: se solicita clona conejo, se oferta clona ratón, en ficha técnica no especifica si el anticuerpo es poli o monoclonal como se especifica en ficha técnica
- 9: se solicita anticuerpo clona conejo, oferta clona ratón, se solicita vial de 1.0ml y se oferta únicamente vial de 0.5ml





- 13: se oferta clona diferente a ficha técnica, se solicita vial de 1.0ml concentrado y se oferta únicamente vial de 0.5ml
- 15: solicita en ficha técnica sistema de revelado marca específico
- 19: solicita en ficha técnica sistema de revelado marca-específico, la ficha técnica no especifica el volumen del vial que está ofertando
- 37: oferta clona diferente a la solicitada en ficha técnica, se oferta vial de 0.5ml cuando se solicita de 1.0ml concentrado
- 46: se oferta vial de 0.5ml, se especifica vial de 1.0ml
- 52: se solicita anticuerpo de conejo, se oferta anticuerpo de ratón, no especifica volumen del vial ofertado en la ficha técnica
- 143: oferta kit de detección de inmunohistoquímica, se solicita kit de detección de sondas de hibridación in situ con revelado en plata
- 144: se solicita kit de revelado marca Roche, modelo Benchmark, oferta SCYTEK LABORATORIES INC
- 146: la ficha técnica del medio de montaje no especifica el volumen ofertado, para cuantas pruebas es útil, se solicita en específico volumen de 25ml para 250 pruebas en ficha técnica
- 147: la ficha técnica especifica un grosor diferente de 1.0 a 1.2mm, las dimensiones de los portaobjetos son diferentes a las marcadas en la ficha técnica. Se solicita caja con 10paquetes de 100 piezas cada uno, se ofertan 72 piezas por caja y 1440 piezas sin especificar cuantas cajas hay x paquete.

10)QUIMICA KEICEL S.A DE C.V

El proveedor participó con 120 partidas de las cuáles 107 si cumplen con requerimientos, 13 no cumplen con requerimientos y 64 partidas que no participó.

No omito mencionar que en este departamento se ha trabajado previamente con anticuerpos de esta marca con diferentes diluyentes, recuperadores etc con resultados satisfactorios y con diluciones óptimas.

A)PARTIDAS QUE NO OFERTÓ

1,10,16,24,53,66,67,76,84,98,
102,122,126,127,128,129,
136,137,138,139,140,
141,142,143,144,145,146,148,149,
150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,
161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,
171,172,173,174,175,176,177,178,179,
180,181,182,183,184

B)PARTIDAS QUE SI CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS

Estas partidas cumplen con las características solicitadas en las fichas técnicas, en relación a mono o policlonalidad, conejo o ratón, clona solicitada y las presentaciones de los viales. Las partidas son las siguientes:

2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,17,18,19,20,
21,22,23,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,
61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80
81,83,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99,
100,101,103,104,105,106,107,108,109,110,
111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,123,124,125

C)PARTIDAS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS

Las observaciones a las partidas son las siguientes:

-25,29,42,60,82,85: oferta clona diferente a la solicitada





- 130: oferta clona diferente a la solicitada, se especifica vial para 50 pruebas y oferta vial de 1.0ml concentrado
- 131, 132, 134: oferta clona diferente a la solicitada, oferta vial con presentación diferente a la solicitada
- 133: oferta clona diferente a la solicitada
- 135: no contempla la impresora de cassettes
- 147: no corresponde las características ofertadas al producto solicitado

11)VITASOF S.A. DE C.V

De un total de 184 partidas, el proveedor participó con 48 partidas, de las cuáles 41 cumplen los requerimientos técnicos necesarios, 4 no cumplen y NO participó con 139 partidas

El análisis es el siguiente:

A)PARTIDAS QUE NO OFERTÓ

1,3,5,6,9,10,11,13,14,16,17,18,20,
21,22,23,24,28,29,30,31,36,38,39,40,
41,43,45,49,50,51,52,53,54,56,57,59,60,
61,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,83,84,85,86,88,89,
91,93,94,96,97,98,
101,102,103,105,106,107,109,110,
111,112,113,114,115,116,117,120,
121,122,123,124,125,126,127,129,130,
131,132,133,134,138,139,
140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,
150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,
160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,
170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,
180,181,182,183,184

B)PARTIDAS QUE SI CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS

Estas partidas cumplen con los requerimientos técnicos solicitados en las fichas en cuanto a tipo de anticuerpo, mono o policlonalidad, ratón o conejo y volumen del vial. Así mismo, las clonas ofertadas son las solicitadas en las fichas técnicas:

4,7,8,12,15,19,26,27,32,33,34,35,37,
44,46,47,48,55,58,62,63,64,75,78,79,
80,81,82,87,90,92,95,99,100,
104,108,118,119,135,136,137

C)PARTIDAS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS

- 2: se solicita anticuerpo policlonal y oferta monoclonal
- 25: oferta clona específica que no se consigna en ficha técnica
- 42: oferta clona diferente a la solicitada en la ficha técnica
- 128: oferta clona diferente a la solicitada, el volumen del vial es diferente al solicitado
- 135: no contempla la impresora de cassettes

UMAE HADIA UN TIEMPO XXI
Atentamente
Dra. Jazmín De Anda Gonzalez
JEFA DEL DEPTO
DE ANATOMIA PATOLÓGICA
IMSS

Jefa del Depto. de Anatomía Patológica

c.c.p.-
- Minuta.
-INTERESADA
JDA/lhm*



2025
Año de
La Mujer
Indígena