



Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Nacional

"Arrendamiento de Equipo de Tomografía Computada (con Inyector Dual de Medio de Contraste) y Equipo de Rayos X Portátil, con Importación de Estudios de Radiología e Imagen al Sistema de Digitalización para el Servicio de Radiodiagnóstico"

No. LA-50-GYR-050GYR051-N-6-2025

En la Ciudad de México siendo las 11:00 horas, del día 19 de diciembre de 2024, en la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología, ubicada en Avenida Cuauhtémoc No. 330, Colonia Doctores, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento) así como del numeral 3.4 de la convocatoria a la licitación.

Este acto fue presidido por el Lic. Noel Cruz Sánchez, servidor público designado por la convocante Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional "Siglo XXI", quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley sustantiva en la materia, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, de forma electrónica a través del portal CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, no se les permitirá a los licitantes formular preguntas.

El Presidente del acto, fue asistido por el representante del área técnica, la Ing. Guadalupe de Jesús Ramírez Cahuich la cual solventa las preguntas de carácter técnico; y el representante del área contratante, quien solventa las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la convocante como a través de CompraNet, de las siguientes personas:

No.	Nombre, Razón o Denominación Social	Forma de Presentación	No. de Preguntas
1	Electrónica y Medicina, S.A.	CompraNet	13

También se hace constar que la empresa EYM Solutions, S.A. de C.V. manifestó interés en participar pero sin presentar Manifiesto de interés en participar ni acuse de solicitud de aclaraciones.


De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la convocante, como se indica a continuación:

Preguntas efectuadas por: 1. Electrónica y Medicina, S.A.

1. "Anexo Uno. Anexo técnico

A) Descripción amplia y detallada de los bienes, incluyendo las cantidades por partida.

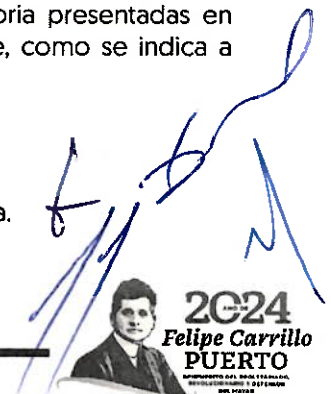



Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Nacional

"Arrendamiento de Equipo de Tomografía Computada (con Inyector Dual de Medio de Contraste) y Equipo de Rayos X Portátil, con Importación de Estudios de Radiología e Imagen al Sistema de Digitalización para el Servicio de Radiodiagnóstico"
No. LA-50-GYR-050GYR051-N-6-2025

Se requiere que el equipo de rayos X portátil a ofertar para el arrendamiento cuente con las siguientes especificaciones como mínimo:

Dice:

Punto 1.12 columna. Giratoria con movimiento motorizado

Pregunta: Entendemos que estaremos cumpliendo al ofertar un equipo de rx móvil con movimiento motorizado por baterías, con columna giratoria ¿es correcto?"

Respuesta:

Es correcta su apreciacion con respecto a que se requiere un equipo de RX móvil con movimiento motorizado con energía de baterías y que cuente con una columna giratoria.

Preguntas efectuadas por: 1. Electrónica y Medicina, S.A.

2. "anexo uno. Anexo técnico

A) Descripción amplia y detallada de los bienes, incluyendo las cantidades por partida.

Se requiere que el equipo de rayos X portátil a ofertar para el arrendamiento cuente con las siguientes especificaciones como mínimo:

Dice:

Punto 1.14 el equipo ofertado debe ser capaz de ser configurado con el sistema pacs para el envío de imágenes en formato dicom, la transmisión de las imágenes no generarán costos adicionales para el instituto.

Punto 1.15 las licencias del uso de software / firmware del equipo deberán estar liberadas sin costo adicional para el instituto.

Pregunta: Entendemos que para dar cumplimiento a estos puntos se referenciara en catálogos comerciales o técnicos, los servicios dicom y se indicará que está considerado en la oferta, ¿es correcto?"

Respuesta:

En lo que respecta a los servicios dicom es correcta su apreciacion de referenciar mediante catalogos. En cuanto a los licenciamientos del uso de software / firmware asi como la configuracion con el sistema pacs de la unidad la propuesta tecnica deberá integrar una carta bajo protesta de decir verdad firmada por el representante legal en formato libre de cumplimiento con dichos puntos.

Preguntas efectuadas por: 1. Electrónica y Medicina, S.A.

3. "Anexo Uno. Anexo Técnico

A) Descripción amplia y detallada de los bienes, incluyendo las cantidades por partida.

Se requiere que el equipo de rayos x portátil a ofertar para el arrendamiento cuente con las siguientes especificaciones como mínimo:

Dice: punto 4.1 preventivo trimestral (el licitante propondrá las fechas del mantenimiento).





Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Nacional

"Arrendamiento de Equipo de Tomografía Computada (con Inyector Dual de Medio de Contraste) y Equipo de Rayos X Portátil, con Importación de Estudios de Radiología e Imagen al Sistema de Digitalización para el Servicio de Radiodiagnóstico"
No. LA-50-GYR-050GYR051-N-6-2025

Pregunta: Solicitamos nos permitan ofertar mantenimiento preventivo semestral ya que los equipos no requieren un mantenimiento trimestral, ¿se acepta?"

Respuesta:

Se acepta sin ser limitativo para los demás participantes.

Preguntas efectuadas por: 1. Electrónica y Medicina, S.A.

4. "Anexo Uno. Anexo Técnico

A) Descripción amplia y detallada de los bienes, incluyendo las cantidades por partida.

Se requiere que el equipo de tomografía computada a ofertar para el arrendamiento cuente con las siguientes especificaciones como mínimo

Dice: 1.2. Número de detectores físicos: 80 o mayor

Pregunta: Solicitamos ofertar un equipo de 128 cortes y 64 filas ¿se acepta?"

Respuesta:

No se acepta su propuesta, se requieren las especificaciones técnicas señaladas en la convocatoria.

Preguntas efectuadas por: 1. Electrónica y Medicina, S.A.

5. "Anexo Uno. Anexo Técnico

A) Descripción amplia y detallada de los bienes, incluyendo las cantidades por partida.

Se requiere que el equipo de tomografía computada a ofertar para el arrendamiento cuente con las siguientes especificaciones como mínimo

Dice: Punto 1.3.4. Pantalla integrada que despliegue kv, ma, indicador de radiación, tiempo, posición de la mesa y frecuencia cardíaca.

Pregunta: Por cuestiones de referenciación, solicitamos se permita referenciar este punto de acuerdo con la literatura del fabricante. ¿se acepta?"

Respuesta:

Se acepta en tanto este correctamente referenciada y las especificaciones técnicas sean iguales a las solicitadas en la convocatoria.

Preguntas efectuadas por: 1. Electrónica y Medicina, S.A.

6. "Anexo Uno. Anexo Técnico

A) Descripción amplia y detallada de los bienes, incluyendo las cantidades por partida.

Se requiere que el equipo de tomografía computada a ofertar para el arrendamiento cuente con las siguientes especificaciones como mínimo

Dice: Punto 1.4.2. Con un espesor de corte de 0.5 mm o menor.

Pregunta. Solicitamos poder ofertar, el espesor de corte mínimo de 0.625mm ¿se acepta?"

2024
Felipe Carrillo
PUERTO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICA
FISCAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Nacional

"Arrendamiento de Equipo de Tomografía Computada (con Inyector Dual de Medio de Contraste) y Equipo de Rayos X Portátil, con Importación de Estudios de Radiología e Imagen al Sistema de Digitalización para el Servicio de Radiodiagnóstico"
No. LA-50-GYR-050GYR051-N-6-2025

Respuesta:

No se acepta su propuesta, se requieren las especificaciones técnicas señaladas en la convocatoria.

Preguntas efectuadas por: 1. Electrónica y Medicina, S.A.

7. "Anexo Uno. Anexo Técnico

A) Descripción amplia y detallada de los bienes, incluyendo las cantidades por partida.

Se requiere que el equipo de tomografía computada a ofertar para el arrendamiento cuente con las siguientes especificaciones como mínimo

Dice: Punto 2.6. Almacenamiento de al menos 30 gb.

Pregunta: Almacenamiento de al menos 30 gb. Al parecer hay un error de transcripción y este punto no corresponde a lo solicitado, ¿pueden aclarar?"

Respuesta:

Es correcta su apreciación, el rubro no corresponde a los accesorios requeridos por lo que no se requiere referenciar ni cumplir con este punto.

Preguntas efectuadas por: 1. Electrónica y Medicina, S.A.

8. "Numeral 4.1.5. Opiniones positivas de cumplimiento de obligaciones fiscales, en materia de seguridad social y de pago de aportaciones patronales

Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el instituto mexicano del seguro social [imss], conforme lo establece el acuerdo acdo.sa2.htc.270422/107.p.dir y su anexo único, relativo a las reglas para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, en la sesión celebrada el 27 de abril del 2022 y publicado en el diario oficial de la federación el 22 de septiembre del 2022. Dicho documento deberá encontrarse en sentido positivo y vigente el día de la carga de su propuesta, así mismo deberá de seguir positiva el día del fallo.

Pregunta: La opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el instituto mexicano del seguro social [imss] tiene una vigencia únicamente del día en que se emite, por lo que solicitamos nos permitan entregar el documento con 3 días hábiles previos a la entrega de la propuesta, y en caso de ser adjudicados se entregará el documento vigente al momento de la firma de contrato; ¿se acepta?"

Respuesta:

No se acepta su propuesta, se deberá integrar a la propuesta técnica la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social y de pago de aportaciones patronales con la fecha de la carga de dicha propuesta en sistema compranet.

Preguntas efectuadas por: 1. Electrónica y Medicina, S.A.

9. "Numeral 1.6. Idioma





Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Nacional

"Arrendamiento de Equipo de Tomografía Computada (con Inyector Dual de Medio de Contraste) y Equipo de Rayos X Portátil, con Importación de Estudios de Radiología e Imagen al Sistema de Digitalización para el Servicio de Radiodiagnóstico"
No. LA-50-GYR-050GYR051-N-6-2025

En caso de anexar folletos y/o anexos técnicos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, así como aquellos otros documentos que presente en su proposición técnica, tales como certificados y cartas del fabricante en otro idioma, podrán presentarse en el idioma del país de origen, acompañados de una traducción simple al español

Pregunta: En caso de ser necesario la presentación de manuales del fabricante, solicitamos nos permitan entregar únicamente las hojas referenciadas, con el compromiso de entregarlos completos a la entrega del equipo, ¿se acepta?"

Respuesta:

Se acepta en tanto que sea contemplada la traducción simple al español la referenciación correspondiente.

Preguntas efectuadas por: 1. Electrónica y Medicina, S.A.

10. "Anexo Dos. Términos Y Condiciones

K) Forma de pago.

La forma de pago será en pesos mexicanos, se pagarán el servicio efectuado posterior a la realización del mismo de acuerdo al anexo técnico.

Pazo de pago: 20 días de acuerdo al anexo 2. Normatividad de pago de las cuentas contables.

Pregunta: Favor de aclarar si el pago al proveedor adjudicado se llevará a cabo de manera mensual durante el transcurso del contrato."

Respuesta:

Es correcta su apreciación, con una frecuencia mensual el proveedor adjudicado deberá requisitar la documentación señalada en la convocatoria para el trámite de pago.

Preguntas efectuadas por: 1. Electrónica y Medicina, S.A.

11. "Anexo Dos. Términos Y Condiciones


F) Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.

Los licitantes se obligan a realizar la visita a las instalaciones institucionales a fin de considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos para la elaboración de las correspondientes guías mecánicas

Pregunta: La visita al ser obligatoria, solo podrán presentar propuestas los proveedores que se hayan presentado en las instalaciones de la unidad médica y obtengan su constancia de haber realizado la visita, ¿es esto correcto?"

Respuesta:

Es correcta su apreciación, únicamente los licitantes que integren en su propuesta la constancia de haber realizado la visita a las instalaciones serán contemplados para evaluación.

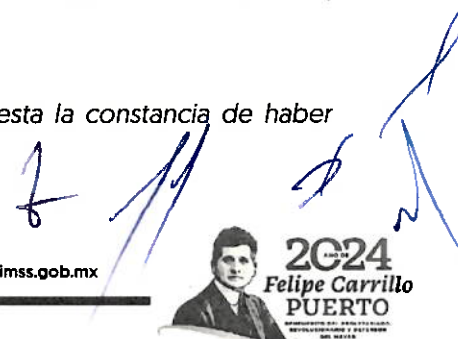



Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Nacional

"Arrendamiento de Equipo de Tomografía Computada (con Inyector Dual de Medio de Contraste) y Equipo de Rayos X Portátil, con Importación de Estudios de Radiología e Imagen al Sistema de Digitalización para el Servicio de Radiodiagnóstico"

No. LA-50-GYR-050GYR051-N-6-2025

Preguntas efectuadas por: 1. Electrónica y Medicina, S.A.

12. "4.2.1 Propuesta Técnica

La propuesta técnica deberá contener las especificaciones técnicas, la información y documentación requerida en la presente convocatoria, en sus anexos y considerando el resultado de la junta de aclaraciones

Pregunta: Entendemos que podrá utilizarse un formato libre para llevar a cabo la realización de la correspondencia de las características solicitadas; ¿es esto correcto?"

Respuesta:

Es correcta su apreciación en tanto se realice correctamente la referenciación de acuerdo a lo solicitado en la convocatoria.

Preguntas efectuadas por: 1. Electrónica y Medicina, S.A.

13. "Anexo Uno. Anexo Técnico

A) Descripción amplia y detallada del arrendamiento

Se requiere que el equipo de tomografía computada a ofertar para el arrendamiento cuente con las siguientes especificaciones como mínimo:

Dice: importación de estudios de radiología e imagen al sistema de digitalización

Pregunta: Entendemos que con "importación de estudios...." se refiere a que los estudios generados en el equipo de tomografía computada deberán ser enviados para su almacenamiento al sistema de digitalización [pacs] con el que cuenta actualmente la unidad médica con el fin de que el expediente de los pacientes está completo. ¿es correcto?"

Respuesta:

Es correcta su apreciación, los estudios generados en el equipo de tomografía computada deberán ser enviados para su almacenamiento al sistema de digitalización [pacs] con el que cuenta actualmente la unidad.

Se informa a los licitantes que cuentan con un plazo de seis horas para formular y remitir por CompraNet, las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas, mismas a las que se les dará contestación a través de la Plataforma Integral CompraNet.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación.

Para efectos de la notificación en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica <https://compranet.funcionpublica.gob.mx/> para efectos de su notificación.

Se da por terminada la presente junta, siendo las 11:30 horas, del día 19 del mes de diciembre del año 2024.





Acta de Junta de Aclaraciones

Licitación Pública Nacional

"Arrendamiento de Equipo de Tomografía Computada (con Inyector Dual de Medio de Contraste) y Equipo de Rayos X Portátil, con Importación de Estudios de Radiología e Imagen al Sistema de Digitalización para el Servicio de Radiodiagnóstico"

No. LA-50-GYR-050GYR051-N-6-2025

Esta Acta consta de 07 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social

Nombre	Cargo	Firma	Antefirma
Lic. David Adair Aragón Cadenas	Jefe de la Oficina de Adquisiciones (Área Contratante)		
L.C. Noel Cruz Sánchez	Jefe del Departamento de Abastecimiento (Área Contratante)		
Lic. Milton de Jesús Sánchez Avelar	Analista Coordinador C (Operador de Compranet)		
Ing. Guadalupe de Jesús Ramírez Cahuich	Jefa de la División de Ingeniería Biomédica (Área Técnica)		

Por el Organo Interno de Control

Nombre	Firma	Antefirma
Sin asistencia		

----- FIN DEL ACTA -----

