



GOBIERNO DE MEXICO



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
UMAE HE C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO"
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

ACTA DEL EVENTO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR046-T-99-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE "CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO", PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO NACIONAL GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024.

EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUE., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2024, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO", UBICADA EN CALLE 2 NORTE NO. 2004, C.P. 72000, COLONIA CENTRO, EN PUEBLA, PUE., LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE AL FINAL SE ENLISTAN, SUSCRIBEN Y FIRMAN, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN QUE SE MENCIONA EN EL PROEMIO DE ESTA ACTA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 4 DE LA CONVOCATORIA ANTES MENCIONADA Y EN BASE A LOS AL ARTÍCULO 134, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN I, 26 BIS, FRACCIÓN II, 27, 28, FRACCIÓN II, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35 Y 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 28, 31, 34, 35, 40, 41, 44, 45, 46 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 58, 81, 84, 86, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 104 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA., PARA CUBRIR NECESIDADES DEL 6 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

EN USO DE LA PALABRA LA LIC. YADHYRA LIZZETTE SALAS VEGA, TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO", QUIEN PRESIDE EL ACTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y NUMERAL 5.3.8 DE LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DECLARÓ FORMALMENTE INICIADO ESTE ACTO, HIZO LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PARTICIPANTES DE ESTE EVENTO, CON EL PROPÓSITO DE RUBRICAR PARA DEJAR CONSTANCIA LA PRESENTE ACTA.

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES GENERALES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR046-T-99-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO PARA LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO", MISMAS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA:

ACLARACIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA A LAS BASES DE LICITACIÓN

DICE:

Anexo 15

Table with 12 columns and 1 row. The main cell contains a detailed description of a surgical instrument: 'TIJERA DE CORTE Y COAGULACION DEL BISTURI ARMONICO PARA CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO CON MANGO TIPO TIJERA, DE 9 CM DE LONGITUD Y CUENTA CON ACTIVACION MANUAL INCLUYE EXTENSOR DE PIEZA DE MANO Y LLAVE DE AJUSTE.. NUM.CAT. FCS9. MARCA: JOHNSON & JOHNSON. CONSUMIBLE PARA EQUIPO: BISTUTRI ULTRASONICO. EQUIPO QUIRURGICO PORTATIL DE ULTRASONIDO, PARA CORTE Y COAGULACION. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: GENERADOR DE ENERGIA CON FRECUENCIA ULTRASONICA, CONTROLADO POR MICROPROCESADOR; ACTIVADOR; PANTALLA CON INDICADOR DE NIVEL DE POTENCIA Y ESTADO DE OPERACION; CONTROL DE VOLUMEN DE SONIDO Y DE POTENCIA DE TRABAJO. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SE?ALADOS SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.' The bottom row contains the numbers 178, 21401-0018, 379, 879, 0154, 00, 01, CJA, 6, PZA, 10, 24, and SE REQUIERE MUESTRA.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



GOBIERNO DE MEXICO



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
UMAE HE C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO"
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

ACTA DEL EVENTO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-T-99-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE "CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO", PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO NACIONAL GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024.



EMPRESAS QUE HAN MANIFESTADO INTERÉS EN PARTICIPAR

Fecha y hora de la emisión del reporte: 20/08/2024 11:25

Detalle del Proceso de Licitación

Código del Expediente: E-2024-0007893
Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR046-T-99-2024
Número de parte: 1

Empresas interesadas

Table with 6 columns: Num., Manifestante, Fecha y hora de inscripción de la oferta, Fecha de inscripción de interés, Acreditación de experiencia de la empresa, Acreditación de personalidad. Rows 1-18 list various companies like ARABERTEC, ADVANCED STERILIZATION, etc.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTA DEL EVENTO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA **LA-50-GYR-050GYR046-T-99-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE **"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO"**, PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO NACIONAL GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2024**.

19	EVM SOLUTIONS SA DE CV	20 de Agosto de 2024 a las 09:43		NO	NO
20	IDEM MEDICAL SA DE CV	15 de Agosto de 2024 a las 09:31		NO	NO
21	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	19 de Agosto de 2024 a las 09:22		NO	NO
22	INTERSURGICAL SA DE CV	14 de Agosto de 2024 a las 14:20	14 de Agosto de 2024 a las 14:21	SI	NO
23	IVETH MARICELA MAYORQUIN FLORES	15 de Agosto de 2024 a las 15:00	15 de Agosto de 2024 a las 15:01	SI	NO
24	JUAMA SA DE CV	14 de Agosto de 2024 a las 10:06		NO	NO
25	LA TIENDA ORTOPEDICA SA DE CV	16 de Agosto de 2024 a las 14:42		NO	NO
26	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	14 de Agosto de 2024 a las 11:42	14 de Agosto de 2024 a las 11:42	SI	NO
27	LIZBETH CHAVEZ TELLEZ	14 de Agosto de 2024 a las 12:31	14 de Agosto de 2024 a las 12:32	NO	NO
28	MED RENT SA DE CV	15 de Agosto de 2024 a las 10:04		NO	NO
29	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV	14 de Agosto de 2024 a las 18:27	14 de Agosto de 2024 a las 18:28	NO	NO
30	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	13 de Agosto de 2024 a las 16:28	13 de Agosto de 2024 a las 16:31	SI	NO
31	MIGUEL ANGEL VILLANUEVA PONCE	14 de Agosto de 2024 a las 10:05		NO	NO
32	NOVATEC MEDICAL SA DE CV	14 de Agosto de 2024 a las 14:31	14 de Agosto de 2024 a las 14:31	NO	NO
33	SOLUCIONES Y EQUIPOS DE PUEBLA SA DE CV	13 de Agosto de 2024 a las 16:21	19 de Agosto de 2024 a las 13:02	SI	NO
34	TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV	16 de Agosto de 2024 a las 17:48	16 de Agosto de 2024 a las 17:48	SI	NO
35	TERRAVISION DESARROLLO, CONSULTORIA Y ASESORIA SAS DE CV	16 de Agosto de 2024 a las 12:13		NO	NO
36	VICENTE GERARDO VENEGAS ARELLANO	15 de Agosto de 2024 a las 10:54	15 de Agosto de 2024 a las 10:55	NO	NO
37	VITER MEDICAL SA DE CV	13 de Agosto de 2024 a las 16:29	13 de Agosto de 2024 a las 16:21	SI	NO

Via México Pdo Miguel Alemán No. 105, Col. Escandón 1, CP. 1800, Miguel Alemán, Ciudad de México.
Tel. 55 3549 1977 <http://www.comprasnet.hacienda.gob.mx/>

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL PUNTO 4 DE LA CONVOCATORIA A LAS BASES SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA A TODAS Y CADA UNA DE LAS PREGUNTAS QUE PREVIAMENTE Y POR ESCRITO LOS LICITANTES HAN FORMULADO, CON SU RESPECTIVA RESPUESTA POR PARTE DE LOS

ACTA DEL EVENTO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-T-99-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE "CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO", PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO NACIONAL GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2024**.

REPRESENTANTES DE LAS DIVERSAS ÁREAS DEL INSTITUTO QUE TIENEN INGERENCIA EN ESTE PROCESO LICITATORIO, LAS CUALES SE TRANSCRIBEN ÍNTEGRAMENTE CON EL NOMBRE DEL LICITANTE QUE LA FORMULA, Y SU RESPECTIVA RESPUESTA, ANEXÁNDOSE AL EXPEDIENTE DE ESTA LICITACIÓN LOS FORMATOS ENTREGADOS POR LOS LICITANTES QUE CONTIENEN ÉSTAS, RUBRICADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES EN ESTE ACTO Y LOS REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES.

ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV

C).- DE CARÁCTER TÉCNICO


NÚMERO	PREGUNTAS	RESPUESTAS
ANEXO NÚMERO 15 REQUERIMIENTO POR CLAVE CON DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE PUEDA OFERTAR EN LA PARTIDA 120, UN INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA (20 MINUTOS), DE OTRA MARCA QUE NO SEA 3M, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, LA MUESTRA JUNTO CON EL AUTOLECTOR PARA PROBARLA SERÁN VALIDADAS POR EL SERVICIO SOLICITANTE
ANEXO NÚMERO 15 REQUERIMIENTO POR CLAVE CON DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE PUEDA OFERTAR EN ESTA PARTIDA UN INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA (20 MINUTOS), DE OTRA MARCA QUE NO SEA 3M, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, LA MUESTRA JUNTO CON EL AUTOLECTOR PARA PROBARLA SERÁN VALIDADAS POR EL SERVICIO SOLICITANTE

BAXTER, S.A. DE C.V.

C).- DE CARÁCTER TÉCNICO

Número	Preguntas	Respuestas
MUESTRAS	SOLICITAMOS A LA H. CONVOCANTE ACEPTAR QUE PARA LAS PARTIDAS 54 CLAVE 379-200-3208 00 01 CIRCUITO EXTRACORPÓREO (ST150) PRISMAFLEX Y 172 CLAVE 379-821-3629 00 01 SOLUCIÓN COADYUVANTE (PRISMA) SE EXIMA LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS Y SE PERMITA PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO PARA DICHAS PARTIDAS. ESTO DEBIDO A QUE LA DEPENDENCIA ACTUALMENTE TIENE EXPERIENCIA DE USO DE LOS INSUMOS REQUERIDOS.	NO SE ACEPTA; SE REQUIERE COMPROBAR LA FUNCIONALIDAD DE LA MUESTRA
ANEXO CONDICIONES	SE SOLICITA A LA H. CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL LUGAR DE ENTREGA PARA LOS EQUIPOS SERÁ LA MISMA LA DIRECCIÓN DE ENTREGA DE LOS BIENES	LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN LAS PARTIDAS 54 Y 172, SERÁ EN LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA, SITA EN CALLE 2 NORTE NO. 2004 COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 72000, PUEBLA, PUE. EN EL AREA DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS.
MUESTRAS	SOLICITAMOS A LA H. CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL FORMATO A UTILIZAR PARA LA ENTREGA DE MUESTRAS ES DE FORMATO LIBRE	FAVOR DE APEGARSE AL FORMATO DE ENTREGA DE MUESTRAS CONTEMPLADO AL FINAL DEL ANEXO 15
4. ANEXO CONDICIONES. DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EN LA ENTREGA DE LOS	VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES. SE SOLICITA A LA H. CONVOCANTE CONFIRMAR QUE NO SE REQUIERE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL PARA LAS PARTIDAS 54 CLAVE 379-200-3208 00 01 CIRCUITO EXTRACORPÓREO (ST150) PRISMAFLEX Y 172 CLAVE 379-821-3629 00 01 SOLUCIÓN COADYUVANTE (PRISMA)	SE CONFIRMA, NO ES NECESARIO REALIZAR UNA VISITA A LAS INSTALACIONES PARA LAS PARTIDAS 54 CLAVE 379-200-3208 00 01 CIRCUITO EXTRACORPÓREO (ST150) PRISMAFLEX Y 172 CLAVE 379-821-3629 00 01 SOLUCIÓN COADYUVANTE (PRISMA)

COMERCIALIZADORA ARVIEN SA DE CV

ACTA DEL EVENTO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-T-99-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE "**CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO**", PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO NACIONAL GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2024**.

A).- DE CARÁCTER LEGAL ADMINISTRATIVA

Número	Preguntas	Respuestas
PUNTO 4. JUNTA DE ACLARACIONES	<p>PUNTO 4-DE LA CONVOCATORIA</p> <p>EN LA FRACCION I DEL PUNTO 4 DE LA CONVOCATORIA SOLICITAN PRESENTAR ANEXO 12 ESCRITO MANIFESTANDO INTERÉS, SIN EMBARGO EN LA ACTUALIDAD LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET NO PERMITE ADJUNTAR ARCHIVOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA CUBRIR EL PRESENTE PUNTO BASTARÁ CON MANIFESTAR INTERÉS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA CON EL BOTÓN QUE HABILITAN.</p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>NO SE DEBERAN INTREGRAR A LA PROPOSICION, EN VIRTUD DE QUE EL SISTEMA COMPRANET EMITE LOS ACUSES DE MANIFIESTO DE INTERES Y MANIFIESTO DE PREGUNTAS ENVIADAS.</p>
PUNTO 4. JUNTA DE ACLARACIONES	<p>PUNTO 4 DE LA CONVOCATORIA</p> <p>EN LA FRACCION I DEL PUNTO 4 DE LA CONVOCATORIA SOLICITAN PRESENTAR EL ANEXO 3 PARA REALIZAR LAS PREGUNTAS EN JUNTA DE ACLARACIONES, SIN EMBARGO EN LA ACTUALIDAD EN LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET NO PERMITE ADJUNTAR ARCHIVOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI PARA CUBRIR EL PRESENTE PUNTO SERÁ SUFICIENTE CON EL ARCHIVO QUE PROPORCIONA LA PLATAFORMA COMPRANET PARA REALIZAR LAS PREGUNTAS</p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>NO SE DEBERAN INTREGRAR A LA PROPOSICION, EN VIRTUD DE QUE EL SISTEMA COMPRANET EMITE LOS ACUSES DE MANIFIESTO DE INTERES Y MANIFIESTO DE PREGUNTAS ENVIADAS.</p>
PUNTO 6. INCISO C DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR	<p>PUNTO 6 INCISO C</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO EN COMENTO NOS PERMITA PRESENTAR DE MANERA INDISTINTA EL ANEXO 7 (SIETE) EN CONJUNTO CON EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÀ PRESENTAR EL ANEXO 7 FIRMADO DE MANERA CONJUNTA CON EL FABRICANTE</p>
PUNTO 6. INCISO D DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR	<p>PUNTO 6 INCISO D</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO EN COMENTO NOS PERMITA PRESENTAR DE MANERA INDISTINTA EL ANEXO 8 (OCHO) EN CONJUNTO CON EL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÀ PRESENTAR EL ANEXO 8 FIRMADO DE MANERA CONJUNTA CON EL FABRICANTE</p>
PUNTO 6. INCISO G ANEXO 11	<p>PUNTO 6. INCISO G ANEXO 11</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE DEL ANEXO 11 PODREMOS PRESENTAR DE MANERA INDISTINTA CARTA DEL FABRICANTE, DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO</p> <p>¿FAVOR DE CONFIRMAR?</p>	<p>DEBERÁN ENTREGAR CARTA DEL FABRICANTE, DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O MAYORISTA EN ORIGINAL, EN PAPEL MEMBRETADO Y CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL MISMO, EN LA QUE ÉSTE MANIFIESTE RESPALDAR LA PROPOSICIÓN TÉCNICA QUE SE PRESENTE</p>
PUNTO 6. INCISO J OPINIONES.	<p>PUNTO 6, INCISO H</p> <p>SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, EMITIDA POR EL IMSS CON FECHA DE HASTA 3 DÍAS HÁBILES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>PODRA PRESENTAR OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, EMITIDA AL DIA DEL ENVIO DE SU PROPUESTA.</p>



GOBIERNO DE MEXICO



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
 UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
 UMAE HE C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO"
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

ACTA DEL EVENTO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-50-CYR-050GYR046-T-99-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE "CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO", PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO NACIONAL GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2024.

PUNTO 6. INCISO F PROPOSICION CONJUNTA	PUNTO 6. INCISO F PROPOSICION CONJUNTA ANEXO 10 EN CASO DE NO PARTICIPAR DE MANERA CONJUNTA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR EL ANEXO 10 CON LA LEYENDA "NO APLICA" SIN QUE SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, PODRA PRESENTARSE CON LA LEYENDA DE "NO APLICA".
--	---	---

C).- DE CARÁCTER TÉCNICO

Número	Preguntas	Respuestas
ANEXO 15	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ANEXO 15, APARTADO DE MUESTRAS NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS, ES DECIR QUE SIN IMPORTAR LA PRESENTACIÓN DE CADA CLAVE SE ENTREGUE UNA PIEZA POR CADA PARTIDA OFERTADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA MUESTRA REPRESENTATIVA PARA LOS CASOS EN QUE LA PRESENTACION SEA MAS DE UNA PIEZA
PUNTO 1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS CONFIRME QUE ES CORRECTO ENTENDER QUE TODOS LOS ANEXOS Y ESCRITOS SERÁN DIRIGIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO FAVOR DE CONFIRMAR	ES CORRECTO, TODOS LOS ANEXOS Y ESCRITOS SERÁN DIRIGIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV, S.A. DE C.V.

C).- DE CARÁCTER TÉCNICO

Número	Preguntas	Respuestas
ANEXO NUMERO 15, RENGLON 3	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA AGUJA PARA MARCAJE MAMARIO TIPO HAWKINS 20 G X 10 CM, CON BARBA LATERAL DE ANCLAJE Y CABLE FLEXIBLE DE 19 HILOS, YA QUE EN SU REQUERIMIENTO SOLICITAN UNA MARCA ESPECIFICA (KOPAN) Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, LA MUESTRA JUNTO CON LA PISTOLA PARA PROBARLA SERÁN VALIDADAS POR EL SERVICIO SOLICITANTE
ANEXO NUMERO 15, RENGLON 4	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA AGUJA DE BIOPSIA DE TEJIDOS POR VIA PERCUTANEA, DESECHABLE, AUTOMATICA, CALIBRE 16 G Y LONGITUD 16 CM, MUESCA 1.9 CM, COMPATIBLE CON PISTOLA PROMAG, YA QUE EN SU REQUERIMIENTO SOLICITAN UNA MARCA ESPECIFICA (MAGNUM) Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, LA MUESTRA JUNTO CON LA PISTOLA PARA PROBARLA SERÁN VALIDADAS POR EL SERVICIO SOLICITANTE
ANEXO NUMERO 15, RENGLON 5	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA AGUJA DE BIOPSIA DE TEJIDOS POR VIA PERCUTANEA, DESECHABLE, AUTOMATICA, CALIBRE 14 G Y LONGITUD 16 CM, MUESCA 1.9 CM, COMPATIBLE CON PISTOLA PROMAG, YA QUE EN SU REQUERIMIENTO SOLICITAN UNA MARCA ESPECIFICA (MAGNUM) Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, LA MUESTRA JUNTO CON LA PISTOLA PARA PROBARLA SERÁN VALIDADAS POR EL SERVICIO SOLICITANTE
ANEXO NUMERO 15, RENGLON 4 Y 5	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 6 PISTOLAS MODELO PROGRAM ULTRA (6 PARA EL SERVICIO DE RAYOS X Y 2 PARA EL SERVICIO DE ONCO QUIRURGICA), YA QUE EN SU REQUERIMIENTO SOLICITAN UNA MARCA ESPECIFICA (MAGNUM) Y LIMITA LA	SE ACEPTA, LA MUESTRA JUNTO CON LA PISTOLA PARA PROBARLA SERÁN VALIDADAS POR EL SERVICIO SOLICITANTE

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

ACTA DEL EVENTO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA **LA-50-GYR-050GYR046-T-99-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE "**CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO**", PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO NACIONAL GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2024**.

	LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA, ¿SE ACEPTA?	
ANEXO NUMERO 15, RENGLON 4 Y 5	SE SOLICITA INCLUIR LAS PISTOLAS DE BIOPSIA EN COMODATO, LIBRE DE CARGO PARA EL INSTITUTO Y HASTA EL TERMINO DE LOS CONSUMIBLES, ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE BASTARA CON ENTREGAR 6 PISTOLAS PARA CUMPLIR CON AMBAS PARTIDAS? FAVOR DE ACLARAR.	SE ACEPTA, LA MUESTRA JUNTO CON LA PISTOLA PARA PROBARLA SERÁN VALIDADAS POR EL SERVICIO SOLICITANTE


ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV

C).- DE CARÁCTER TÉCNICO

Número	Preguntas	Respuestas
ANEXO 15	PARTIDA 64 CLAVE 379.274.0023.00.01 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA CLAVE 379.375.0526.00.02 Y DESCRIPCIÓN RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C.ULTA. RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 1000 ML, CON GRADUACIONES CADA 100 ML EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHO DISPOSITIVO CONTIENE UN SOBRE CON SUBSTANCIAS QUÍMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADO SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO SENSATAC QUE CONSTA: DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFÉRICOS QUE TRANSMITEN LA PRESIÓN DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN COPLE CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCIÓN DEL SENSATAC. PRESENTACIÓN: PIEZA. COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA ULTA. PRESENTACIÓN: PIEZA. NÚMERO DE CATALOGO: M8275093. PARA SU USO EN EL EQUIPO MÉDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO:ULTA SIENDO CARACTERÍSTICAS ALTERNATIVAS QUE NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD AL SER SEMEJANTE A LA CLAVE REQUERIDA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26, QUINTO Y SEXTO PÁRRAFOS; 29, FRACCIÓN V Y ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP; EN CONCOMITANCIA CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN VI DEL RLAASSP, TODA VEZ QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN SE DEBERÁN ESTABLECER LAS CONDICIONES A FIN DE EVITAR FAVORECER A ALGÚN PARTICIPANTE Y REQUISITOS LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA O EN SU CASO REQUISITOS IMPOSIBLES DE CUMPLIR ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO 15 PARA LA PARTIDA 64 CLAVE 379.274.0023.00.01
ANEXO 15	PARTIDA 65 CLAVE 379.274.0049.00.01 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA CLAVE 379.375.0419.00.01 Y DESCRIPCIÓN RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C. FREEDOM. RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 300 ML, CON GRADUACIONES CADA 50 ML EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHO DISPOSITIVO CONTIENE UN SOBRE CON SUBSTANCIAS QUÍMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADO, SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO TRAC QUE CONSTA DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFÉRICOS QUE TRANSMITEN LA PRESIÓN DEL LECHO DE LA HERIDA AL	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO 15 PARA LA PARTIDA 65 CLAVE 379.274.0049.00.01

ACTA DEL EVENTO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-T-99-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE **"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO"**, PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO NACIONAL GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2024**.

	MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN COUPLE CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL TRAC. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 320058. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011. EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: FREEDOM.	
ANEXO 15	PARTIDA 65 CLAVE 379.274.0049.00.01 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, NOS PERMITA ENTREGAR EL NUMERO DE CATALOGO: M8275058, YA QUE EL CATALOGO INDICADO EN LA CLAVE 379.375.0419.00.01 ESTA DESCONTINUADO. CABE HACER MENCIÓN QUE LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SON LAS MISMAS	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL ANEXO 15 PARA LA PARTIDA 65 CLAVE 379.274.0049.00.01
ANEXO 15	PARTIDA 121 CLAVE 379.561.1957.00.01 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, NOS PERMITA ENTREGAR EL NUMERO DE CATALOGO: M8275052, YA QUE EL CATALOGO INDICADO EN LA CLAVE 379.561.0900.00.01 ESTA DESCONTINUADO. CABE HACER MENCIÓN QUE LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SON LAS MISMAS	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL ANEXO 15 PARA LA PARTIDA 121 CLAVE 379.561.1957.00.01
ANEXO 15	PARTIDA 122 CLAVE 379.561.1965.00.01 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA CLAVE 379.561.0918.00.01 Y DESCRIPCIÓN UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO(PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, OVALADO, DE 25.6 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE ESPESOR; 2 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7CM +/- 2 MM POR 32 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2; CON UN TRAC PAD DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTO ADHERIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION DE QUE CONTIENE 5 LUMENES, 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COUPLE CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA ATS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M6275053. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: ATS. SIENDO CARACTERÍSTICAS ALTERNATIVAS QUE NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD AL SER SEMEJANTE A LA CLAVE REQUERIDA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26, QUINTO Y SEXTO PÁRRAFOS; 29, FRACCIÓN V Y ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP; EN CONCOMITANCIA CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN VI DEL RLAASSP; TODA VEZ QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN SE DEBERÁN ESTABLECER LAS CONDICIONES A FIN DE EVITAR FAVORECER A ALGÚN PARTICIPANTE Y REQUISITOS LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA O EN SU CASO REQUISITOS IMPOSIBLES DE CUMPLIR; ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL ANEXO 15 PARA LA PARTIDA 122 CLAVE 379.561.1965.00.01


ACTA DEL EVENTO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA **LA-50-GYR-050GYR046-T-99-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE **"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO"**, PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO NACIONAL GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2024**.

ANEXO 15	PARTIDA 122 CLAVE 379.561.1965.00.01 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, NOS PERMITA ENTREGAR EL NUMERO DE CATALOGO: M8275053, YA QUE EL CATALOGO INDICADO EN LA CLAVE 379.561.0918.00.01 ESTA DESCONTINUADO. CABE HACER MENCIÓN QUE LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SON LAS MISMAS.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL ANEXO 15 PARA LA PARTIDA 122 CLAVE 379.561.1965.00.01
PAGINA 89, ENTREGA DE MUESTRAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE MI REPRESENTADA ESTA EN LA DISPONIBILIDAD DE PARTICIPA, SE ACEPTA?	SE ACEPTA MUESTRA REPRESENTATIVA PARA LOS CASOS EN QUE LA PRESENTACION SEA MAS DE UNA PIEZA
ANEXO 15	PARTIDA 121 CLAVE 379.561.1957.00.01 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA CLAVE 379.561.0900.00.01 Y DESCRIPCIÓN UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO (PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO, CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS, TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, OVALADO, DE 18 CM DE LARGO POR 12.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE ESPESOR; 2 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7CM +/- 2 MM POR 32 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2; CON UN TRAC PAD DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTO ADHERIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION DE QUE CONTIENE 5 LUMENES, 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLE CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA ATS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M6275052. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011. EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: ATS. SIENDO CARACTERÍSTICAS ALTERNATIVAS QUE NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD AL SER SEMEJANTE A LA CLAVE REQUERIDA. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26, QUINTO Y SEXTO PÁRRAFOS; 29, FRACCIÓN V Y ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP; EN CONCOMITANCIA CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN VI DEL RLAASSP; TODA VEZ QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN SE DEBERÁN ESTABLECER LAS CONDICIONES A FIN DE EVITAR FAVORECER A ALGÚN PARTICIPANTE Y REQUISITOS LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA O EN SU CASO REQUISITOS IMPOSIBLES DE CUMPLIR ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN EL ANEXO 15 PARA LA PARTIDA 121 CLAVE 379.561.1957.00.01

ACTA DEL EVENTO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-T-99-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE **"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO"**, PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO NACIONAL GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2024**.

A).- DE CARÁCTER LEGAL ADMINISTRATIVA

Número	Preguntas	Respuestas
13.2 CONDICIONES DE ENTREGA.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES QUE SEAN ADJUDICADOS A TRAVES DE SERVICIOS DE PAQUETERÍA CON ENTREGA A DETALLE ACOMPAÑADOS DE UN SOBRE CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA ENTREGA Y RECEPCION DE LOS BIENES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 13.2 CONDICIONES DE ENTREGA.
ANEXO 15 ENTREGA DE MUESTRAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REALIZAR LA ENTREGA DE LAS MUESTRAS SOLICITADAS A TRAVES DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA, CON EL COMPROMISO DE QUE ESTAS SEAN ENTREGADAS EN EL PLAZO ESTABLECIDO. FAVOR DE CONSIDERAR.	SE ACEPTA SIENDO ENTERA RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE QUE LAS MUESTRAS LLEGUEN A TIEMPO. LAS MUESTRAS DEBEN ENTREGARSE ETIQUETADAS CON CLAVE Y DESCRIPCION, NOMBRE DEL PROVEEDOR Y SE ENTREGAN DEL 26 y 27 DE AGOSTO 2024 DE 09:00 A 13:00 HORAS, EN: DIVISION DE INGENIERIA BIOMEDICA PRIMER PISO, TORRE DE ENSEÑANZA DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA, SITA EN CALLE 2 NORTE No. 2004 COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 72000, PUEBLA, PUE
ANEXO 15 ENTREGA DE MUESTRAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE TELEFONO (Y EXTENSION) DEL RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LAS MUESTRAS, CON EL FIN DE MANTENER COMUNICACIÓN DIRECTA CON ÉL Y PODER REALIZAR LA ENTREGA DE LAS MUESTRAS SIN CONTRATIEMPOS.	RESPONSABLE ING HANS ULRICH LAU CRUZ JEFE DE INGENIERIA BIOMEDICA TELEFONO 222 2424520 EXT 61904
ANEXO 15 ENTREGA DE MUESTRAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REALIZAR LA ENTREGA DE MUESTRAS REPRESENTATIVAS DE 1 PIEZA, PARA AQUELLAS PARTIDAS CUYA PRESENTACIÓN SOLICITADA ES CAJA CON MÁS DE 10 PIEZAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA MUESTRA REPRESENTATIVA PARA LOS CASOS EN QUE LA PRESENTACION SEA MAS DE UNA PIEZA

IVETH MARICELA MAYORQUIN FLORES

C).- DE CARÁCTER TÉCNICO

Número	Preguntas	Respuestas
TERMINOS Y CONDICIONES INCISO C)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR MUESTRAS POR PAQUETERÍA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIENDO ENTERA RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE QUE LAS MUESTRAS LLEGUEN A TIEMPO. LAS MUESTRAS DEBEN ENTREGARSE ETIQUETADAS CON CLAVE Y DESCRIPCION, NOMBRE DEL PROVEEDOR Y SE ENTREGAN DEL 26 y 27 DE AGOSTO 2024 DE 09:00 A 13:00 HORAS, EN: DIVISION DE INGENIERIA BIOMEDICA PRIMER PISO, TORRE DE ENSEÑANZA DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA, SITA EN CALLE 2 NORTE No. 2004 COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 72000, PUEBLA, PUE
TERMINOS Y CONDICIONES INCISO C)	EN CASO DE ACEPTAR ENTREGA DE MUESTRAS POR PAQUETERÍA / MENSAJERÍA, FAVOR DE INDICAR EL NOMBRE DE LA PERSONA ENCARGADA DE RECIBIR DICHAS MUESTRAS	RESPONSABLE ING HANS ULRICH LAU CRUZ JEFE DE INGENIERIA BIOMEDICA TELEFONO 222 2424520 EXT 61904

LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV

A).- DE CARÁCTER LEGAL ADMINISTRATIVA

Número	Preguntas	Respuestas
NUMERAL 1.1	LAS PROPOSICIONES EN SU CASO, DEBERÁN PRESENTARSE POR ESCRITO Y DE FORMA ESCANEADA EN TRES ARCHIVOS. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ARCHIVO "TRES" INCLUYE TODO LO SOLICITADO EN LOS NUMERALES 2, 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.3, 7.1 Y 7.2, SEGÚN CORRESPONDA?	ES CORRECTA SU APRECIACION, DEBERÀ PRESENTARSE POR ESCRITO Y DE FORMA ESCANEADA EN TRES ARCHIVOS.

ACTA DEL EVENTO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-T-99-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE **"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO"**, PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO NACIONAL GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2024**.

	¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
NUMERAL 2.1. FRACCION I. INCISOS B Y C	<p>SOLICITAN: ACUSE DEL RECIBO DEL TRAMITE DE PRORROGA DEL REGISTRO SANITARIO ASÍ COMO EL FORMATO DE SOLICITUD.</p> <p>ACTUALMENTE COFEPRIS EMITE UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO PARA LOS REGISTROS SOMETIDOS A PRORROGA, CUYA HOMOCLOVE DE TRÁMITE ES "COFEPRIS-2022-022-006 A" Y EL NOMBRE DE TRÁMITE ES "SOLICITUD DE SEGUNDA PRÓRROGA Y SUBSECUENTES". EL CUAL CONTIENE TODOS LOS DATOS DEL REGISTRO SANITARIO SOMETIDO A PRORROGA Y TAMBIÉN FUNGE COMO ACUSE DE TRÁMITE. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ESTE DOCUMENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS INCISOS B) Y C) DEL NUMERAL 2.1.</p> <p>¿SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
NUMERAL 4	<p>RESPECTO AL ANEXO NÚMERO 2 (DOS) Y ANEXO NÚMERO 3 (TRES), ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SE DEBERÁN INTEGRAR A LA PROPOSICIÓN, DERIVADO A QUE EL SISTEMA COMPRANET EMITE LOS ACUSES DE MANIFIESTO DE INTERES Y MANIFIESTO DE PREGUNTAS ENVIADAS?</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	ES CORRECTO, NO SE DEBERAN INTREGRAR A LA PROPOSICION, EN VIRTUD DE QUE EL SISTEMA COMPRANET EMITE LOS ACUSES DE MANIFIESTO DE INTERES Y MANIFIESTO DE PREGUNTAS ENVIADAS.
NUMERAL 6, PUNTO 3	<p>DE CONFORMIDAD AL OFICIO NO. 09 52 17 61 4220/0309, PUNTO 3.</p> <p>¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO PODEMOS INTEGRAR EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES Y SUS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES EMITIDAS POR EL INSTITUTO, CON LO QUE SE DEMUESTRA QUE TENEMOS INSCRITOS A NUESTROS TRABAJADORES EN EL REGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL Y ESTAMOS AL CORRIENTE EN EL PAGO?</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	ES CORRECTO, DEBERA INTEGRAR EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES Y SUS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES EMITIDAS POR EL INSTITUTO, CON LO QUE SE DEMUESTRA QUE SE ENCUENTRAN INSCRITOS SUS TRABAJADORES EN EL REGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL Y ESTAN AL CORRIENTE EN EL PAGO.
NUMERAL 6, PUNTO 4, INCISO B.	<p>II. COPIA SIMPLE DE LA FACTURA.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ENTREGAREMOS COPIA SIMPLE DE LA FACTURA.</p> <p>¿SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES PRESENTARLO DE ESTA MANERA?</p>	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
NUMERAL 6.1. INCISO A	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA UTILIZAR EL ANEXO NÚMERO 13 (TRECE) PARA PRESENTAR LA DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE) Y OMITIENDO PRECIOS E IMPORTES.</p> <p>¿SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES PRESENTARLO DE ESTA MANERA?</p>	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.

ACTA DEL EVENTO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA **LA-50-GYR-050GYR046-T-99-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE **"CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO"**, PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO NACIONAL GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2024**.

MEDICAL RECOVERY SA DE CV

C).- DE CARÁCTER TÉCNICO

Número	Preguntas	Respuestas
13.1 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LAS CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS INSUMOS QUE CONSTA ESTA LICITACIÓN SI LA EMPRESA GANADORA DEBE SUMINISTRAR EL TOTAL DE LAS PARTIDAS DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA 64, 65, 121, 122, ¿ES CORRECTO?	DEBERA APEGARSE AL PUNTO 13.1 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.
13.1 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CON CUANTOS DÍAS COMO MÁXIMO SE DISPONE PARA LA ENTREGA DE EQUIPOS (SIN COSTO PARA EL INSTITUTO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS 64, 65, 121, 122) QUE SE DEBEN ENTREGAR AL HOSPITAL, UNA VEZ QUE SE HAYA DADO EL FALLO.	DEBERÀ ENTREGAR LOS EQUIPOS A MAS TARDAR 20 DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA EMISION DEL FALLO.
13.1 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUÁL ES EL TOTAL DE EQUIPOS DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA PARA LAS PARTIDAS 64, 65, 121, 122. QUE SE DEBEN ENTREGAR AL HOSPITAL.	EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÀ ENTREGAR 04 EQUIPOS DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA PARA LAS PARTIDAS 64, 65, 121, 122.
13.1 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EN QUE SERVICIO O ESPECIALIDAD DEL HOSPITAL SE REALIZARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS 64, 65, 121, 122, QUE SE ENTREGARAN EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.	LOS 04 EQUIPOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN Y ENVASE (CEYE)

SOLUCIONES Y EQUIPOS DE PUEBLA SA DE CV

C).- DE CARÁCTER TÉCNICO

Número	Preguntas	Respuestas
ANEXO 15 PARTIDA 26	PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR POR SUSTITUCION DEL FABRICANTE DEL CODIGO MS16161 EL CUAL QUEDÓ OBSOLETO, OFERTAR EL NUEVO CATALOGO: MS14560, MISMO QUE CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS Y DEL CUAL SE ENTREGARÁ MUESTRA, SE ACEPTA?	SE ACEPTA, LA COMPATIBILIDAD DE LA MUESTRA SERA VALIDADA POR EL SERVICIO SOLICITANTE
ANEXO 15 PARTIDA 80	PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA POR SUSTITUCION DEL FABRICANTE DEL CATALOGO MP01805 EL CUAL QUEDÓ OBSOLETO, OFERTAR EL NUEVO CATALOGO: MP05805, MISMO QUE CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS Y DEL CUAL SE ENTREGARÁ MUESTRA, SE ACEPTA?	SE ACEPTA, LA COMPATIBILIDAD DE LA MUESTRA SERA VALIDADA POR EL SERVICIO SOLICITANTE
ANEXO 15 PARTIDA 130	PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA POR SUSTITUCION DEL FABRICANTE DEL CATALOGO N7100 EL CUAL QUEDÓ OBSOLETO, OFERTAR EL NUEVO CATALOGO: N6100, MISMO QUE CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS Y DEL CUAL SE ENTREGARÁ MUESTRA, SE ACEPTA?	SE ACEPTA, LA COMPATIBILIDAD DE LA MUESTRA SERA VALIDADA POR EL SERVICIO SOLICITANTE
ANEXO 15 PARTIDA 42	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIA IMPRESA DEL CATÁLOGO 3375933 DEL PRODUCTO SOLICITADO YA QUE NO CONTAMOS DE MOMENTO CON UNA MUESTRA FÍSICA, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA; SE REQUIERE COMPROBAR LA FUNCIONALIDAD DE LA MUESTRA
ANEXO 15 PARTIDA 159	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIA IMPRESA DEL CATÁLOGO 5204644 DEL PRODUCTO SOLICITADO YA QUE NO CONTAMOS DE MOMENTO CON UNA MUESTRA FÍSICA, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA; SE REQUIERE COMPROBAR LA FUNCIONALIDAD DE LA MUESTRA

ACTA DEL EVENTO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-T-99-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE "CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO", PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO NACIONAL GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2024**.

ANEXO PARTIDA 160	15 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIA IMPRESA DEL CATÁLOGO 4322975 DEL PRODUCTO SOLICITADO YA QUE NO CONTAMOS DE MOMENTO CON UNA MUESTRA FÍSICA, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA; SE REQUIERE COMPROBAR LA FUNCIONALIDAD DE LA MUESTRA
----------------------	---	---

TECNO COMERCIAL PAKTLI SA DE CV

C).- DE CARÁCTER TÉCNICO

Número	Preguntas	Respuestas
PARTIDA 15	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DE DOS VÍAS. SOLICITAMOS A AL CONVOCANTE MENCIONE EL TIPO O LOS TIPOS DE CONECTORES QUE SOLICITAN,	SE SOLICITA APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO DE ACUERDO CON CATALOGO OPERATIVO EN DONDE SE MENCIONA NÚMERO DE CATÁLOGO DEL CONSUMIBLE REQUERIDO ASÍ COMO MARCA Y MODELO DEL EQUIPO EN EL QUE SERÁ UTILIZADO
PARTIDA 17	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DE DOS VÍAS. SOLICITAMOS A AL CONVOCANTE MENCIONE EL TIPO O LOS TIPOS DE CONECTORES QUE SOLICITAN,	SE SOLICITA APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO DE ACUERDO CON CATALOGO OPERATIVO EN DONDE SE MENCIONA NÚMERO DE CATÁLOGO DEL CONSUMIBLE REQUERIDO ASÍ COMO MARCA Y MODELO DEL EQUIPO EN EL QUE SERÁ UTILIZADO
PARTIDA 18	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DE DOS VÍAS. SOLICITAMOS A AL CONVOCANTE MENCIONE EL TIPO O LOS TIPOS DE CONECTORES QUE SOLICITAN,	SE SOLICITA APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO DE ACUERDO CON CATALOGO OPERATIVO EN DONDE SE MENCIONA NÚMERO DE CATÁLOGO DEL CONSUMIBLE REQUERIDO ASÍ COMO MARCA Y MODELO DEL EQUIPO EN EL QUE SERÁ UTILIZADO
PARTIDA 19	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DE DOS VÍAS. SOLICITAMOS A AL CONVOCANTE MENCIONE EL TIPO O LOS TIPOS DE CONECTORES QUE SOLICITAN,	SE SOLICITA APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO DE ACUERDO CON CATALOGO OPERATIVO EN DONDE SE MENCIONA NÚMERO DE CATÁLOGO DEL CONSUMIBLE REQUERIDO ASÍ COMO MARCA Y MODELO DEL EQUIPO EN EL QUE SERÁ UTILIZADO
PARTIDA 66	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR DOMO MARCA SMITHS MEDICAL, EN EL ENTENDIDO DE QUE SE ENTREGARIAN CABLES PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD CON SUS EQUIPOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, LA COMPATIBILIDAD DE LA MUESTRA JUNTO CON LOS CABLES REFERIDOS SERA VALIDADA POR EL SERVICIO SOLICITANTE
PARTIDA 78	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE LA MEDIDA DE LA ESPONJA.	LA MEDIDA DE LA ESPONJA ES LA SIGUIENTE 120 X 80 MM
PARTIDA 153	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE EL RANGO QUE DEBE TENER EL MANOMETRO, CONSIDERANDO QUE LOS MANUALES DE RESUCITACION REFIEREN MANEJO DE PRESIONES DE 0 A 60 MMHG. CONSIDERANDO QUE LOS ADITAMENTOS DE SEGURIDAD (MANOMETRO Y VALVULA PEEP) ELEVAN EL PRECIO DEL INSUMO APROXIMADAMENTE EN UN 40%, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE REQUIERE EL INSUMO CON DICHS ADITAMENTOS	EL RANGO DEL MANOMETRO EN EL RESUCITADOR PUEDE SER 0- 60MMHG SOLO SI ESTE ES REGULABLE PARA LIBERAR PRESION ENTRE 20 - 30 MMHG
PARTIDA 154	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE EL RANGO QUE DEBE TENER EL MANOMETRO, CONSIDERANDO QUE LOS MANUALES DE RESUCITACION REFIEREN MANEJO DE PRESIONES DE 0 A 60 MMHG. CONSIDERANDO QUE LOS ADITAMENTOS DE SEGURIDAD (MANOMETRO Y VALVULA PEEP) ELEVAN EL PRECIO DEL INSUMO APROXIMADAMENTE EN UN 40%, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE REQUIERE EL INSUMO CON DICHS ADITAMENTOS	EL RANGO DEL MANOMETRO EN EL RESUCITADOR PUEDE SER 0- 60MMHG SOLO SI ESTE ES REGULABLE PARA LIBERAR PRESION ENTRE 15 - 20 MMHG
MUESTRAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER ENTREGAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS EN AQUELLAS PARTIDAS DONDE LA PRESENTACION ES CAJA CON X NUMERO DE PIEZA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA MUESTRA REPRESENTATIVA PARA LOS CASOS EN QUE LA PRESENTACION SEA MAS DE UNA PIEZA

ACTA DEL EVENTO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRONICA **LA-50-GYR-050GYR046-T-99-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE "**CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO**", PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO NACIONAL GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2024**.

PARTIDA 16	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DE DOS VÍAS. SOLICITAMOS A AL CONVOCANTE MENCIONE EL TIPO O LOS TIPOS DE CONECTORES QUE SOLICITAN,	SE SOLICITA APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO DE ACUERDO CON CATALOGO OPERATIVO EN DONDE SE MENCIONA NÚMERO DE CATÁLOGO DEL CONSUMIBLE REQUERIDO ASÍ COMO MARCA Y MODELO DEL EQUIPO EN EL QUE SERÁ UTILIZADO
PARTIDA 20	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MENCIONE SI REQUIERE BRAZALETE DE UNA O DE DOS VÍAS. SOLICITAMOS A AL CONVOCANTE MENCIONE EL TIPO O LOS TIPOS DE CONECTORES QUE SOLICITAN,	SE SOLICITA APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO DE ACUERDO CON CATALOGO OPERATIVO EN DONDE SE MENCIONA NÚMERO DE CATÁLOGO DEL CONSUMIBLE REQUERIDO ASÍ COMO MARCA Y MODELO DEL EQUIPO EN EL QUE SERÁ UTILIZADO
PARTIDA 52	¿ES CORRECTO ENTENDER QIE REQUIEREN QUE EL CIRCUITO TENGAS 2 TRAMPAS DE AGUA?	SE REQUIERE CIRCUITO SIN TRAMPAS DE AGUA
PARTIDA 53	¿ES CORRECTO ENTENDER QIE REQUIEREN QUE EL CIRCUITO TENGA 2 TRAMPAS DE AGUA?	SE REQUIERE CIRCUITO SIN TRAMPAS DE AGUA
PARTIDA 61	¿ES CORRECTO ENTENDER QIE REQUIEREN QUE EL CIRCUITO TENGA 2 TRAMPAS DE AGUA?	LA PARTIDA 61 NO HACE REFERENCIA A UN CIRCUITO
PARTIDA 62	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LO QUE REQUIERE LA CONVOCANTE ES UNICAMENTE LAS ESPONJAS PORTA ELECTRODOS?	ES CORRECTO
PARTIDA 66	EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, LE SOLICITO MENCIONE LA CANTIDAD DE CABLES QUE TENDRIAMOS QUE ENTREGAR.	DEBERÀ ENTREGAR 16 CABLES.
PARTIDA 79	¿SERÀ CORRECTO OFERTAR ESPONJA PARA ELECTRODO DE 9 X 9 XM?	SE SOLICITA APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO DE ACUERDO CON CATALOGO OPERATIVO EN DONDE SE MENCIONA NÚMERO DE CATÁLOGO DEL CONSUMIBLE REQUERIDO ASÍ COMO MARCA Y MODELO DEL EQUIPO EN EL QUE SERÁ UTILIZADO

VITER MEDICAL SA DE CV

C).- DE CARÁCTER TÉCNICO

Número	Preguntas	Respuestas
ANEXO 15, PARTIDAS 63, 190, 191, 194, 195, 199, 200 Y 201	EN LA COLUMNA DEL ANEXO 15, OBSERVACIONES, SOLICITAN MUESTRAS, NOS PODRÍAN INFORMAR EL NOMBRE DE LA PERSONA, TELÉFONO, LUGAR, HORARIO Y DÍAS EN QUE SE RECIBIRÁN, FAVOR DE ACLARAR	LAS MUESTRAS DEBEN ENTREGARSE ETIQUETADAS CON CLAVE Y DESCRIPCION, NOMBRE DEL PROVEEDOR Y SE ENTREGAN DEL 26 y 27 DE AGOSTO 2024 DE 09:00 A 13:00 HORAS, EN: DIVISION DE INGENIERIA BIOMEDICA PRIMER PISO, TORRE DE ENSEÑANZA DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD C.M.N. MANUEL AVILA CAMACHO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA, SITA EN CALLE 2 NORTE No. 2004 COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 72000, PUEBLA, PUE

DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 4 DE LA CONVOCATORIA Y AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 46 DE SU REGLAMENTO, SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE LAS OBSERVACIONES GENERALES Y ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES DERIVADAS DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, SERAN CONSIDERADAS COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PROPIA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACIÓN.

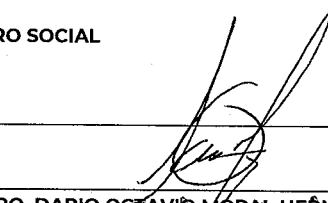
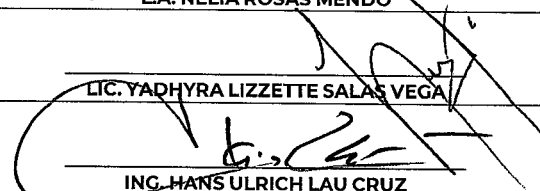


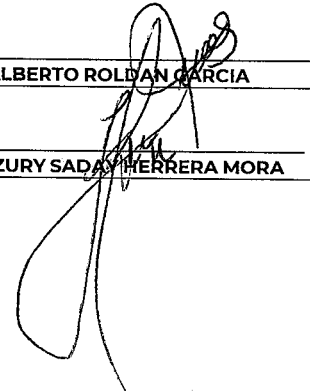
ESTA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE EL ACTA DE ESTE EVENTO SE PONE, PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN, A DISPOSICIÓN, EN EL TABLERO DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. "MANUEL ÁVILA CAMACHO", EN CALLE 2 NORTE NO. 2004 C.P. 72000, COLONIA CENTRO, EN PUEBLA, PUE. POR UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES; SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO, ASÍ MISMO SE COMUNICA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DÍA **28 DE AGOSTO DE 2024 A LAS 10:00 HORAS**.

Handwritten signatures and the number 15 are present at the bottom of the page.

ACTA DEL EVENTO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-T-99-2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE "**CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO**", PARA LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO NACIONAL GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL **EJERCICIO 2024**.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-T-99-2024**, SIENDO LAS 11:50 HORAS DEL MISMO DIA, MES Y AÑO, LEVANTANDO LA PRESENTE ACTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES Y PARA DEBIDA CONSTANCIA, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DEL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ELLA ACTUARON, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE ELLOS RESTE VALIDEZ O EFECTOS A LA MISMA., PODRÁN CONSULTARLA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx>

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	 MTRO. DARIO OCTAVIO MORAL HERNANDEZ
JEFE DE GRUPO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	 L.A. NELIA ROSAS MENDO
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	 LIC. YADHYRA LIZZETTE SALAS VEGA
JEFE DIVISIÓN INGENIERIA BIOMÉDICA	 ING. HANS ULRICH LAU CRUZ
ENCARGADO DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	 ALBERTO ROLDAN GARCIA
ANALISTA COORDINADOR	 C.P. ZURY SADA HERRERA MORA