




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUE., SIENDO LAS 09:30 HORAS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO", UBICADA EN CALLE 2 NORTE NO. 2004, C.P. 72000, COLONIA CENTRO, EN PUEBLA, PUE., LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE AL FINAL SE ENLISTAN, SUSCRIBEN Y FIRMAN, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL QUE SE MENCIONA EN EL PROEMIO DE ESTA ACTA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.2 DE LA CONVOCATORIA ANTES MENCIONADA Y EN BASE A LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 36 SEGUNDO PÁRRAFO, 39 FRACCIÓN I, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 FRACCIÓN I, 49, 50, 51, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Y 96, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), 92, 93,94, 95, 108 Y 126 SU REGLAMENTO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA., PARA CUBRIR NECESIDADES DEL DIA SIGUIENTE DEL FALLO **AL 30 DE JUNIO DE 2026.**

MTRO. JORGE JESUS RESENDIZ ROSALES, ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO", QUIEN PRESIDE EL ACTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y NUMERAL 5.3.8 DE LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DECLARÓ FORMALMENTE INICIADO ESTE ACTO, HIZO LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PARTICIPANTES DE ESTE EVENTO, CON EL PROPÓSITO DE RUBRICAR PARA DEJAR CONSTANCIA DE LA PRESENTE ACTA

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES GENERALES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026 PARA LA CONTRATACION DE "SMI MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA)**, PARA LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. "MANUEL AVILA CAMACHO", MISMAS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA:

SE INFORMA QUE SE RECIBIERON LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE ACLARACION:

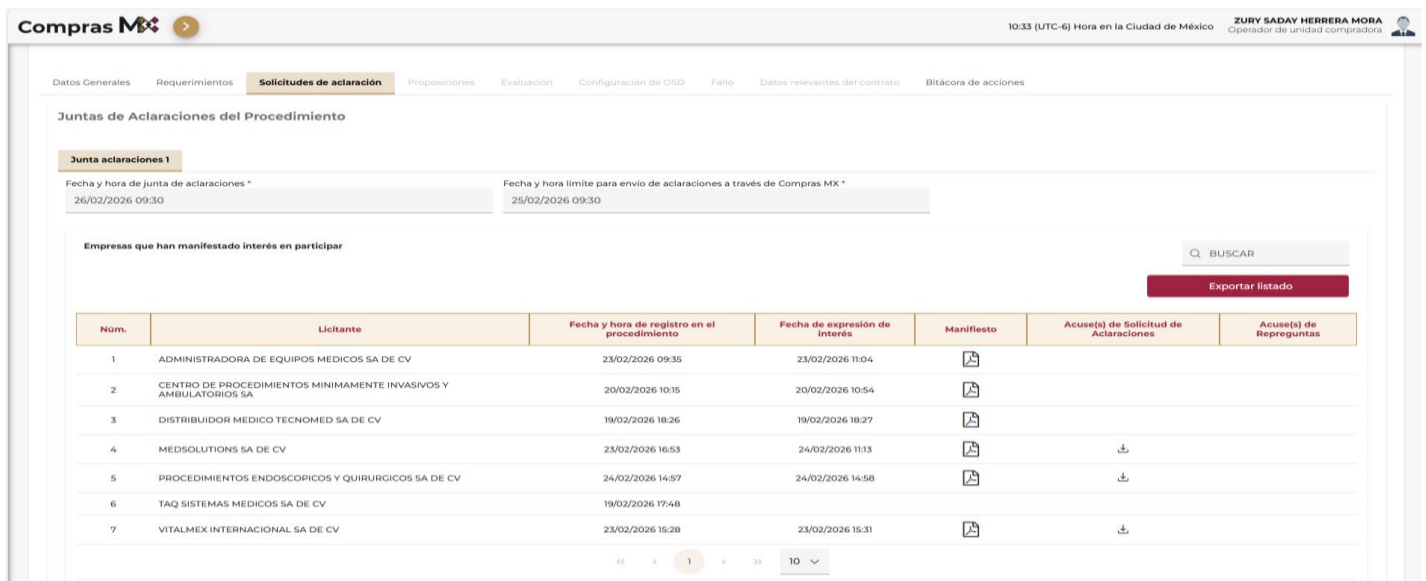

Compras MX 10:33 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México ZURY SADAY HERRERA MORA Coordinador de unidad contratadora

Datos Generales Requerimientos **Solicitudes de aclaración** Proposiciones Evaluación Configuración de OSD Fallo Datos relevantes del contrato Bitácora de acciones

Junta de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones * 26/02/2026 09:30 Fecha y hora limite para envio de aclaraciones a través de Compras MX * 25/02/2026 09:30

Empresas que han manifestado interés en participar

Q BUSCAR Exportar listado

Num.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
1	ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	23/02/2026 09:35	23/02/2026 11:04			
2	CENTRO DE PROCEDIMIENTOS MINIMAMENTE INVASIVOS Y AMBULATORIOS SA	20/02/2026 10:15	20/02/2026 10:54			
3	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	19/02/2026 18:26	19/02/2026 18:27			
4	MEDSOLUTIONS SA DE CV	23/02/2026 16:53	24/02/2026 11:13			
5	PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS Y QUIRURGICOS SA DE CV	24/02/2026 14:57	24/02/2026 14:58			
6	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	19/02/2026 17:48				
7	VITALMEX INTERNACIONAL SA DE CV	23/02/2026 15:28	23/02/2026 15:31			

« < 1 > » 10



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

PREGUNTAS:

NOMBRE DEL LICITANTE: **MEDSOLUTIONS S.A. DE C.V.**

Número	Preguntas	Respuestas
CARTA DE RESPALDO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA ESTE EVENTO SERA NECESARIO PRESENTAR CARTA DE RESPALDO. FAVOR DE CONFIRMAR.	DEBERA ENTREGAR CARTA DE RESPALDO A NOMBRE DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO
OPINION DE CUMPLIMIENTO IMSS	ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE IMPIDA EXPEDIR LA OPINION DE CUMPLIMIENTO CON FECHA DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR OPINION DE CUMPLIMIENTO CON UNA FECHA MAXIMA DE EXPEDICION DE ENTRE 3 Y 5 DIAS PREVIOS A LA PRESENTACION DE PROPUESTAS. SE ACEPTA?	DEBERÀ PRESENTAR SUS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO VIGENTES, EXPEDIDAS CON MAXIMO 3 DIAS NATURALES ANTERIORES A LA PRESENTACION DE PROPUESTAS.
CONVOCATORIA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI PARA ESTE EVENTO SERA SUFICIENTE PRESENTAR FORMATO DE CARTA CON LA LEYENDA "NO APLICA" PARA TODOS AQUELLOS REQUISITOS QUE NO APLIQUEN A MI REPRESENTADA.	SE ACEPTA SU PROPUESTA
CARTA DE RESPALDO	EN CASO DE REQUERIR CARTA DE RESPALDO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI PARA CUMPLIR ESTE REQUISITO SERA SUFICIENTE PRESENTAR CARTA DE RESPALDO A NOMBRE DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. SE ACEPTA?	DEBERA ENTREGAR CARTA DE RESPALDO A NOMBRE DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO
REGISTRO SANITARIO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME	DEBERA PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO A NOMBRE DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

	SI PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO SERA SUFICIENTE PRESENTAR REGISTRO SANITARIO A NOMBRE DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.	
ANEXO TECNICO/FICHAS TECNICAS	A FIN DE HACER LA CODIFICACION DE EQUIPOS QUE SE AJUSTE A SUS NECESIDADES SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS COMPARTA LAS FICHAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS.	DEBERÁ APEGARSE AL ARCHIVO EQUIPOS DE ENDOSCOPIA, PUBLICADO EN EL ANEXO 4 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN
ANEXO TECNICO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS COMPARTA POR FAVOR LA RELACION DE EQUIPOS REQUERIDOS PARA CUBRIR LA DEMANDA DE FORMA OPTIMA. GRACIAS	FAVOR DE APEGARSE AL ANEXO 4 DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO, EN EL CUAL VAN LOS EQUIPOS SOLICITADOS
PRESUPUESTO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS COMPARTA LAS CANTIDADES MINIMA Y MAXIMA DEL PRESUPUESTO DESTINADO PARA CUBRIR EL SERVICIO EN SU UNIDAD. GRACIAS	FAVOR DE APEGARSE A LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DE INSUMOS
ANEXO TECNICO/EQUIPOS OFERTADOS	EN EL CASO DE OFERTAR EQUIPAMIENTO NUEVO O USADO, DADO QUE LA IMPORTACIÓN DE ESTE TIPO DE PRODUCTOS NO ESTÁ SUJETA AL CUMPLIMIENTO DE UN AVISO DE IMPORTACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA POR NO SER PRODUCTOS SIDERÚRGICOS O MÁQUINAS TRAGAMONEDAS, PARA CUBRIR CABALMENTE ESTE NUMERAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTAS FACTURAS DE LOS EQUIPOS EN LAS CUALES SE INDICAN LOS PEDIMENTOS DE IMPORTACION CUANDO ESTOS SEAN EQUIPOS IMPORTADOS¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, PODRÁ PRESENTAR CARTAS FACTURAS DE LOS EQUIPOS EN LAS CUALES SE INDICAN LOS PEDIMENTOS DE IMPORTACION CUANDO ESTOS SEAN EQUIPOS IMPORTADOS



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

NOMBRE DEL LICITANTE: **PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS Y QUIRURGICOS S.A. DE C.V.**

Número	Preguntas	Respuestas
ANEXO T2 PUNTO 11.4.2	FUENTE DE LUZ, SOLICITAN INTENSIDAD DE 300 WATTS SEPARADA O INTEGRADA AL PROCESADOR ENTENDEMOS QUE ESTO SOLO APLICA PARA LOS PROVEEDORES QUE OFERTEN TECNOLOGIA DE XENON YA QUE LAS FUENTES DE LUZ DE LED NO TIENEN INTENSIDAD DE 300 WATTS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	UTILIZAMOS EN NUESTRO CENTRO TORRES CON TECNOLOGIA LED POR LO CUAL NO HAY INCONVENIENTE
ANEXO 3 REQUERIMIENTO EL RENGLON 21 CUCOP 33903-0012	ENTEROSCOPIA INDICA MINIMO 15 Y MAXIMO 15 SIN EMBARGO EN EL ANEXO T11 DISTRIBUCION DE EQUIPO INDICA 0 EN EL ENTEROSCOPIO EN EL CASO DE QUE SI REQUIERAN HACER ESTOS PROCEDIMIENTOS SOLICITAMOS NOS PERMITAN QUE ESTE EQUIPO SEA CONSIDERADO COMO ITINERANTE YA QUE ESTE EQUIPO ES DE ALTA ESPECIALIDAD Y EL NUMERO DE PROCEDIMIENTOS ES BAJO PARA TENER EL EQUIPO FIJO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SOLICITUD, SE REALIZARA GESTION DE AGENDA OPORTUNA PARA SOLICITAR EL EQUIPO EN CUANDO SEA REQUERIDO
3.3 PROPUESTA TÉCNICA L)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO CON FECHA DE EMISIÓN DE HASTA UN DÍA HÁBIL ANTERIOR A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SIEMPRE QUE LA MISMA SE ENCUENTRE VIGENTE Y EN SENTIDO POSITIVO AL MOMENTO DE SU PRESENTACIÓN. LO ANTERIOR, EN VIRTUD DE EVITAR CONTRATIEMPOS TÉCNICOS DURANTE LA CARGA DE LA PROPUESTA EN EL SISTEMA.	DEBERÀ PRESENTAR SUS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO VIGENTES, EXPEDIDAS CON MAXIMO 3 DIAS NATURALES ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

<p>ANEXO TÉCNICO, DESCRIPCIÓN AMPLIA DEL SERVICIO</p>	<p>SE ESTABLECE QUE EL PROCEDIMIENTO SE ADJUDICARÁ POR PARTIDA, SEÑALANDO LA EXISTENCIA DE 10 PARTIDAS AGRUPADAS EN 3 PAQUETES. SIN EMBARGO, EN LA TABLA DENOMINADA "MÍNIMOS Y MÁXIMOS POR PROCEDIMIENTOS POR UMAE" SE CONTEMPLAN 21 PARTIDAS CON CLAVE CEPIM.</p> <p>POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PRECISE LA FORMA EN QUE DEBERÁ INTEGRARSE LA PROPUESTA ECONÓMICA</p>	<p>DEBERA INTEGRARSE DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE LA CONVOCATORIA, EL CUAL INCLUYE 40 PARTIDAS</p>
<p>TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.18 EXPERIENCIA</p>	<p>EN EL APARTADO DE EXPERIENCIA SE SOLICITA ACREDITAR CONTRATOS CELEBRADOS EN EL PERIODO 2018-2021; SIN EMBARGO, EN LA "15.2 TABLA DE PONDERACIÓN" SE ESTABLECE QUE LA EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA CORRESPONDE AL PERIODO 2021-2025. POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PRECISE CUÁL ES EL PERIODO CORRECTO QUE DEBERÁ CONSIDERARSE PARA LA ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA.</p>	<p>SE CONSIDERA QUE EL PERIODO PRECISO DEBERÁ SER EL CORRESPONDEINTE DEL 2021-2025</p>
<p>TERMINOS Y CONDICIONES 4.2.19 ESPECIALIDAD</p>	<p>EN EL APARTADO DE ESPECIALIDAD SE SOLICITA ACREDITAR CONTRATOS DEL PERIODO 2020-2024; SIN EMBARGO, EN LA "15.2 TABLA DE PONDERACIÓN" SE ESTABLECE QUE LA EVALUACIÓN DE ESPECIALIDAD CORRESPONDE AL PERIODO 2021-2025. POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PRECISE CUÁL ES EL PERIODO CORRECTO QUE</p>	<p>SE CONSIDERA QUE EL PERIODO PRECISO DEBERÁ SER EL CORRESPONDEINTE DEL 2021-2025</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

	DEBERÁ CONSIDERARSE PARA LA ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA.	
ANEXO TÉCNICO	<p>EN EL DOCUMENTO SE SEÑALA QUE EL LICITANTE DEBERÁ ELABORAR EL ANEXO TÉCNICO MEDIANTE SU TRANSCRIPCIÓN EN ARCHIVO DIGITAL WORD EDITABLE Y PDF NO MODIFICABLE.</p> <p>POR LO ANTERIOR, RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONE EL ANEXO TÉCNICO, ASÍ COMO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, EN VERSIÓN WORD EDITABLE, A EFECTO DE EVITAR ERRORES DE TRANSCRIPCIÓN Y ASEGURAR QUE LA INFORMACIÓN SEA PRESENTADA DE MANERA ÍNTEGRA Y CONFORME A LO REQUERIDO.</p>	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA
ANEXO T4 CATALOGO DE BIENES DE CONSUMO BASICO	<p>PROCEDIMIENTO 10.23.010, 10.23.024 BCB27 SOLICITAN CATETER CON BALON DE EXTRACCIÓN TRIPLE LUMEN 8.5 A 18 MM SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR CATETER CON BALON DE EXTRACCIÓN TRIPLE LUMEN DE 9.0 A 18 MM CON MEDIDAS INTERMEDIAS ESTO NO AFECTA EN NADA LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO YA QUE LAS MARCAS PRINCIPALES DE INSUMOS A NIVEL NACIONAL TIENEN ESTA CARACTERISTICA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	SE ACEPTA SU PROPUESTA PODRA OFERTAR CATETER CON BALON DE EXTRACCIÓN TRIPLE LUMEN DE 9.0 A 18 MM CON MEDIDAS INTERMEDIAS



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

NOMBRE DEL LICITANTE: **VITALMEX INTERNACIONAL S.A. DE C.V.**

Número	Preguntas	Respuestas
CONVO ANEXO NÚMERO 3 (TRES) REQUERIMIENTO EQUIPOS ENDOSCOPIA ANEXO T2 EQUIPO	ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBE OFERTAR CON CANTIDAD 1: EL NUMERAL 16 SCCB ENTEROSCOPIO ASISTIDO CON BALÓN DEBIDO A QUE ES NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 33903-0012 ENTEROSCOPIA SOLICITADO EN EL ANEXO NÚMERO 3 (TRES) REQUERIMIENTO, ADEMÁS DE ESTAR CORRECTAMENTE DESCRITO EN EL ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA LA APRECIACION, SI SE REQUIERE
TYC ENDOSCOPIA 4.2.7 FECHA DE FABRICACIÓN EQUIPO AT ENDOSCOPIA 3. EQUIPO MÉDICO	ES CORRECTO ENTENDER QUE LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO DEBE CUMPLIR 5 AÑOS CEROS MESES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, LA FECHA DE FABRICACIÓN NO DEBERA EXCEDER 5 AÑOS CERO MESES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.
ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA PMI ANEXO T11 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO	SCCB TORRE BÁSICA DE VISUALIZACIÓN ENDOSCÓPICA DE TUBO DIGESTIVO ADULTO QUE INCLUYE: CARRO TRANSPORTADOR, UN VIDEOGASTROSCOPIO Y UN VIDEOCOLONOSCOPIO Y UN ELECTROCOAGULADOR BÁSICO. *EQUIPO ITINERANTE PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE EQUIPO NO FORME PARTE DE LA OFERTA DEL ANEXO T2 "EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA PMI", YA QUE DICHA TORRE NO ESTÁ SIENDO REQUERIDA EN EL ANEXO T11 DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y ADEMÁS QUE LAS DOS TORRES AVANZADAS SOLICITADAS, MISMAS CON LAS QUE TRABAJA EL SERVICIO ACTUAL, CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO DE ESTE HOSPITAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA COMO EQUIPO ITINERANTE YA QUE SE ESTARÁN TRABAJANDO LAS TRES SALAS DE FORMA SIMULTANEA
ANEXO T2EQUIPO MEDICO DE SMI PARA PMI	531.447.0120 VIDEOGASTROSCOPIO (ADULTO/PEDIÁTRICO).PUNTO: 9.3.5DICE: CON PROFUNDIDAD EN EL CAMPO DE OBSERVACIÓN < A 5 MM. O 6MM. HASTA 100	SE ACEPTA PROPUESTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

	<p>MMPREGUNTA:SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:CON PROFUNDIDAD EN EL CAMPO DE OBSERVACIÓN > A 5 MM. O 6MM. HASTA 100 MMTOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.¿SE ACEPTA?</p>	
<p>ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA PMI</p>	<p>531.447.0120 VIDEOGASTROSCOPIO (ADULTO/PEDIÁTRICO).</p> <p>PUNTO: 9.7</p> <p>DICE:</p> <p>CON ZOOM ELECTRÓNICO O DIGITAL (SEGÚN TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE) DE 1.5X O MAYOR</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>CON ZOOM ELECTRÓNICO O DIGITAL (SEGÚN TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE) DE 1.5X O MAYOR EN EL VIDEOENDOSCOPIO O EN EL VIDEOPROCESADOR.</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA</p>
<p>ANEXO T2EQUIPO MEDICO</p>	<p>531.447.0120 VIDEOGASTROSCOPIO</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPUESTA</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

<p>DE SMI PARA PMI</p>	<p>(ADULTO/PEDIÁTRICO).PUNTO: 9.8DICE: CON ZOOM ÓPTICO ELECTRÓNICO U OBSERVACIÓN ÓPTICO DIGITAL (SEGÚN TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE).PREGUNTA:SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:CON ZOOM ÓPTICO ELECTRÓNICO O ZOOM ELECTRÓNICO U OBSERVACIÓN ÓPTICO DIGITAL (SEGÚN TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE) EN EL VIDEOENDOSCOPIO O EN EL VIDEOPROCESADOR.TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.¿SE ACEPTA?</p>	
<p>ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA PMI</p>	<p>531.217.0235 VIDEOCOLONOSCOPIO. PUNTO: 10.6 DICE: CON PROFUNDIDAD EN EL CAMPO DE OBSERVACIÓN MENOR O IGUAL A 7 MM HASTA 100 MM. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: CON PROFUNDIDAD EN EL CAMPO DE OBSERVACIÓN MAYOR O IGUAL A 7 MM HASTA 100 MM. TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPOSTA</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

	<p>SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
<p>ANEXO T2EQUIPO MEDICO DE SMI PARA PMI</p>	<p>531.217.0235 VIDEOCOLONOSCOPIO.PUNTO: 10.10DICE: CON ZOOM ÓPTICO U OBSERVACIÓN ÓPTICO DIGITAL.PREGUNTA:SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:CON ZOOM ÓPTICO O ZOOM ELECTRÓNICO U OBSERVACIÓN ÓPTICO DIGITAL EN EL VIDEOENDOSCOPIO O EN EL VIDEOPROCESADOR.TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPUESTA</p>
<p>ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA PMI</p>	<p>TORRE DE VISUALIZACIÓN ENDOSCÓPICA DE ALTA ESPECIALIDAD PARA TUBO DIGESTIVO ADULTO QUE INCLUYE: UN VIDEOGASTROSCOPIO, UN VIDEOCOLONOSCOPIO, UN VIDEODUODENOSCOPIO TERAPÉUTICO Y UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CON COAGULACIÓN DE ARGÓN.</p> <p>PUNTO: 11.4.2</p> <p>DICE:</p> <p>INTENSIDAD DE 300 WATTS SEPARADA O INTEGRADA AL PROCESADOR.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>INTENSIDAD DE 300 WATTS O SU EQUIVALENTE EN WATTS SEPARADA O INTEGRADA AL PROCESADOR.</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPUESTA</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

	<p>TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
<p>ANEXO T2EQUIPO MEDICO DE SMI PARA PMI</p>	<p>TORRE DE VISUALIZACIÓN ENDOSCÓPICA DE ALTA ESPECIALIDAD PARA TUBO DIGESTIVO ADULTO QUE INCLUYE: UN VIDEOGASTROSCOPIO, UN VIDEOCOLONOSCOPIO, UN VIDEODUODENOSCOPIO TERAPÉUTICO Y UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CON COAGULACIÓN DE ARGÓN.PUNTO: 11.4.5DICE: CON LÁMPARA DE EMERGENCIA DE XENÓN O HALÓGENO DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTEPREGUNTA:SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:CON LÁMPARA DE EMERGENCIA DE XENÓN O HALÓGENO O LED DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE (OPCIONAL EN CASO DE OFERTAR TECNOLOGÍA LED).TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPUESTA</p>
<p>ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA PMI</p>	<p>531.316.0094 VIDEODUODENOSCOPIO TERAPÉUTICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ENDOSCOPIO CON PORCIÓN FLEXIBLE QUE ES USADO PARA LA EXAMEN VISUAL Y TRATAMIENTO DEL ÁMPULA DE VÁTER EN EL DUODENO QUE TRANSMITE IMÁGENES AL USUARIO POR MEDIO DEL UN MONITOR UTILIZANDO UN SISTEMA DE VIDEO CCD PARA TORRE DE ENDOSCOPIA BÁSICA.</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPUESTA</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

	<p>PUNTO: 12.2.5</p> <p>DICE:</p> <p>CON PROFUNDIDAD EN EL CAMPO DE OBSERVACIÓN < 5 MM HASTA 60 MM.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>CON PROFUNDIDAD EN EL CAMPO DE OBSERVACIÓN > 5 MM HASTA 60 MM.</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
<p>ANEXO T2EQUIPO MEDICO DE SMI PARA PMI</p>	<p>531.328.0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CON COAGULACIÓN DE ARGÓN (ADULTO/PEDIÁTRICO).PUNTO 13.3.1DICE:CON CORTE PURO CON POTENCIA MÍNIMA DE 300 WATTS.PREGUNTA:SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:CON CORTE PURO O AUTOCUT CON POTENCIA MÍNIMA DE 300 WATTS.TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPOSTA</p>
<p>ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI</p>	<p>531.328.0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CON COAGULACIÓN DE ARGÓN</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPOSTA</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

<p>PARA PMI</p>	<p>(ADULTO/PEDIÁTRICO).</p> <p>PUNTO 13.3.2</p> <p>DICE:</p> <p>CON MEZCLA BLEND Y/O MODO CON POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>CON MEZCLA BLEND O DRYCUT Y/O MODO CON POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS.</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
<p>ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA PMIANEXO T11 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO</p>	<p>531.923.0321 ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO. EQUIPO QUE PERMITE LA VISUALIZACIÓN ULTRASONOGRÁFICA Y ENDOSCÓPICA DEL TUBO DIGESTIVO, QUE DENTRO DE LAS CARACTERÍSTICAS MAS RELEVANTES,</p> <p>INCLUYA: PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE EQUIPO NO FORME PARTE DE LA OFERTA DEL ANEXO T2 "EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA PMI", YA QUE DICHO EQUIPO NO ESTÁ SIENDO REQUERIDO EN EL ANEXO T11 DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y ADEMÁS NO ESTÁN SOLICITANDO PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL MISMO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA , YA QUE NO HAY REQUERIMIEBNTO PARA USG ENDOSCOPICO</p>
<p>ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA PMI</p>	<p>SCCB ENTEROSCOPIO ASISTIDO CON BALÓN. ENTEROSCOPIO DE UNO O DOS BALONES: EQUIPO PARA ENTEROSCOPIA DE UNO O</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPUESTA</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

	<p>DOS BALONES, UTILIZADO PARA LA OBSERVACIÓN, EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL INTESTINO DELGADO.</p> <p>PUNTO: 15.2.2</p> <p>DICE:</p> <p>RANGO DE OBSERVACIÓN EN EL RANGO DE 3 - 100 MM. O DE 5 - 100 MM. COMO MÍNIMO.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>RANGO DE OBSERVACIÓN EN EL RANGO DE 2 O 3 - 100 MM. O DE 5 - 100 MM. COMO MÍNIMO.</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
<p>ANEXO 2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA PMI</p>	<p>SCCB ENTEROSCOPIO ASISTIDO CON BALÓN. ENTEROSCOPIO DE UNO O DOS BALONES: EQUIPO PARA ENTEROSCOPIA DE UNO O DOS BALONES, UTILIZADO PARA LA OBSERVACIÓN, EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL INTESTINO DELGADO. PUNTO: 15.2.5 DICE: PRESIÓN DE BALÓN DE 5.4 A 5.6 KPA +/- 2.6 KPA. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: PRESIÓN DE BALÓN DE 5.4 A 5.6 KPA +/- 2 A 2.6 KPA. TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPOSTA</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

	UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.¿SE ACEPTA?	
ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA PMI	<p>531.316.0102 EQUIPO DE CÁPSULA ENDOSCÓPICA PARA VISUALIZACIÓN DEL TRACTO DIGESTIVO (ADULTO/PEDIÁTRICO). CAPAZ DE INTERACTUAR CON CÁPSULAS DE ESÓFAGO, INTESTINO DELGADO Y/O DE COLON, QUE DENTRO DE LAS CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES, INCLUYA:</p> <p>PUNTO: 16.5</p> <p>DICE:</p> <p>ESTACIÓN DE TRABAJO CON MONITOR A COLOR, TECLADO Y MOUSE.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>ESTACIÓN DE TRABAJO O EQUIPO DE CÓMPUTO CON MONITOR A COLOR, TECLADO Y MOUSE.</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA OFERTA RESPECTO AL EQUIPO DE CAPSULA ENDOSCOPICA
ANEXO T2EQUIPO MEDICO DE SMI PARA PMI	<p>537.336.0212 GRABADOR DE PH CON IMPEDANCIA ESOFÁGICO 24 HRS (ADULTO/PEDIÁTRICO). EQUIPO DE MEDICIÓN DE PH-METERÍA CON IMPEDANCIA AMBULATORIA DE 24 HRS. PARA ESÓFAGO QUE DENTRO DE LAS</p>	SE ACEPTA LA PROPOSTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

	<p>CARACTERÍSTICAS MAS RELEVANTES INCLUYA:PUNTO: 17.2.4DICE: CORRELACIÓN DE SÍNTOMAS DE REFLUJOPREGUNTA:SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:CORRELACIÓN DE SÍNTOMAS DE REFLUJO O IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE EPISODIOS DE REFLUJO.TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.¿SE ACEPTA?</p>	
<p>ANEXO T2 EQUIPO MEDICO DE SMI PARA PMI</p>	<p>531.606.0275 MANÓMETRO ESOFÁGICO/ANO-RECTAL DE ALTA RESOLUCIÓN (ADULTO/PEDIÁTRICO). EQUIPO PARA MEDIR LA MOTILIDAD DEL TRACTO DIGESTIVO ALTO (ESÓFAGO) Y BAJO (RECTO) A TRAVÉS DE UN CATÉTER DE ESTADO SÓLIDO DE 32 SENSORES PARA ESÓFAGO Y OTRO CATÉTER DE 8 SENSORES PARA ANORRECTO. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS:</p> <p>PUNTO: 18.5.5</p> <p>DICE:</p> <p>MODEM INTEGRADO (SEGÚN TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE)</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>MODEM INTEGRADO (OPCIONAL SEGÚN TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE)</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA</p>	<p>EL MODEM DEBE ESTAR INTEGRADO EN CUALQUIER TECNOLOGIA OFERTADA</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

	<p>FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
<p>ANEXO T3INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI</p>	<p>ENDO DIG 1NÚMERO: IQX168DICE: PINZA PARA BIOPSIA BILIAR O PANCREÁTICA, REUSABLE. (SI ES DESECHABLE UBICARLA EN BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO)PREGUNTA:SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:PINZA PARA BIOPSIA BILIAR O PANCREÁTICA, REUSABLE O PINZA PARA BIOPSIA BILIAR O PANCREÁTICA O DE GASTROENTEROLOGÍA REUSABLE. (SI ES DESECHABLE UBICARLA EN BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO)TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA</p>
<p>ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI</p>	<p>ENDO DIG 1</p> <p>NÚMERO: IQX171</p> <p>DICE:</p> <p>PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO TRÍPODE O PUEDE SER DE CUATRO HILOS.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO TRÍPODE O PUEDE SER DE CUATRO HILOS REUSABLE O DESECHABLE.</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

	<p>TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
<p>ANEXO T4. BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI</p>	<p>PROCEDIMIENTOS:10.22.003 ENTEROSCOPIA10.23.022 POLIPECTOMÍA DE TUBO DIGESTIVO ALTO Y/O BAJO ADULTO.ID_BCB: BCB8DICE:ASA ENDOSCÓPICA PARA POLIPECTOMÍA DE TRES MEDIDAS DIFERENTES Y DE 230 CM DE LONGITUD. COMPATIBLE CON LOS TUBOS OFERTADOS.PREGUNTA:SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:ASA ENDOSCÓPICA PARA POLIPECTOMÍA DE TRES MEDIDAS DIFERENTES Y DE 230 CM O MAYOR DE LONGITUD. COMPATIBLE CON LOS TUBOS OFERTADOS.TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA</p>
<p>ANEXO T4. BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI</p>	<p>PROCEDIMIENTO:</p> <p>10.22.003 ENTEROSCOPIA</p> <p>ID_BCB: BCB78</p> <p>DICE:</p> <p>KIT DE ESFINTEROTOMÍA POR ENTEROSCOPIA QUE INCLUYE: GUÍA DE ALTO RENDIMIENTO (O GUIA HIDROFILICA) DE 450 A 600 CM DE LONGITUD Y 0.035 DE DIÁMETRO. BALÓN DE EXTRACCIÓN EN EL</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

	<p>RANGO DE 9 A 15 MM PARA ENTEROSCOPIA DE 200CM DE LONGITUD O MAYOR. SISTEMA DE COLOCACIÓN DE PRÓTESIS BILIAR DE 8.5, 10, 11.5 FR. DE 5 A 15 CM DE LONGITUD. Y CATÉTER DE 200 CM A 230 CM O MAYOR COMPATIBLE CON LA SONDA, VISIÓN FRONTAL PARA ARGÓN PLASMA.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>KIT DE ESFINTEROTOMÍA POR ENTEROSCOPIA QUE INCLUYE: GUÍA DE ALTO RENDIMIENTO (O GUIA HIDROFILICA) DE 450 A 600 CM DE LONGITUD Y 0.035 DE DIÁMETRO. BALÓN DE EXTRACCIÓN EN EL RANGO DE 8.5 A 15 MM PARA ENTEROSCOPIA DE 200CM DE LONGITUD O MAYOR. SISTEMA DE COLOCACIÓN DE PRÓTESIS BILIAR DE 8.5, 10, 11.5 FR. DE 5 A 15 CM DE LONGITUD. Y CATÉTER DE 200 CM A 230 CM O MAYOR COMPATIBLE CON LA SONDA, VISIÓN FRONTAL PARA ARGÓN PLASMA.</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
<p>ANEXO T4. BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI</p>	<p>PROCEDIMIENTO:10.22.006 PANENDOSCOPIA CON TOMA DE BIOPSIA Y CEPILLADO ADULTO.ID_BCB: BCB33DICE:CEPILLO DE CITOLOGÍA, LONGITUD DE TRABAJO DE EN EL RANGO DE 120 A 140 CM., PROTEGIDO, COMPATIBLE CON EL BRONCSCOPIO O GASTROSCOPIO OFERTADO Y UTILIZADO.PREGUNTA:SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

	<p>PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: CEPILLO DE CITOLOGÍA, LONGITUD DE TRABAJO DE EN EL RANGO DE 120 A 180 CM., PROTEGIDO, COMPATIBLE CON EL BRONCOSCOPIO O GASTROSCOPIO OFERTADO Y UTILIZADO. TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>ANEXO T4. BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI</p>	<p>PROCEDIMIENTO: 10.23.002 ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, VARICEALES ESOFÁGICAS ADULTO. ID_BCB: BCB104 DICE: SET DE LIGADURA VARICEAL, CON AL MENOS 6 BANDAS, PARA ADULTO Y/O PEDIÁTRICO 8.6 A 11.5 MM. COMPATIBLE CON EL DIÁMETRO EXTERNO DEL BARRIL Y DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: SET DE LIGADURA VARICEAL, CON AL MENOS 6 BANDAS, PARA ADULTO Y/O PEDIÁTRICO ENTRE 8.6 A 13 MM. COMPATIBLE CON EL DIÁMETRO EXTERNO DEL BARRIL O DEL ENDOSCOPIO Y DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO. TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE</p>	<p>ESPECIFICAR CASA COMERCIAL DEL KIT DE LIGADURAS, YA QUE AUNQUE SE OFERTE DE 8.6 EN ADELANTE, EL DIAMETRO PUEDE QUEDAR FLOJO A LA PUNTA DEL ENDOSCOPIO,</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

	<p>DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
<p>ANEXO T4. BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI</p>	<p>PROCEDIMIENTOS:10.23.010 COLANGIOGRAFÍA CON ESFINTEROTOMÍA BILIAR Y LITOTRÍCIA MECÁNICA PARA COLEDOCOLITIASIS COMPLEJA.10.23.024 COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA PARA EXTRACCIÓN DE LITOS BÁSICA ADULTO.ID_BCB: BCB27DICE:CATÉTER CON BALÓN DE EXTRACCIÓN TRIPLE LUMEN 8.5 A 18 MM (INCLUIR MEDIDAS INTERMEDIAS) CON PUNTA DISTAL, Y LONGITUD DE 195 A 210 CM., ESTÉRIL Y DESECHABLE.PREGUNTA:SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:CATÉTER CON BALÓN DE EXTRACCIÓN TRIPLE LUMEN EN EL RANGO DE 8.5 A 18 MM (INCLUIR MEDIDAS INTERMEDIAS) CON PUNTA DISTAL, Y LONGITUD DE 195 A 210 CM., ESTÉRIL Y DESECHABLE.TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA</p>
<p>ANEXO T4. BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI</p>	<p>PROCEDIMIENTO:</p> <p>10.23.015 GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA ADULTO.</p> <p>ID_BCB: BCB17</p> <p>DICE:</p> <p>BOTÓN DE REPUESTO O RECAMBIO SEGÚN CALIBRE SOLICITADO (24 FR.). DE DIFERENTES LONGITUDES 0.8 A 3.5 CMS.</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

	<p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>BOTÓN DE REPUESTO O RECAMBIO O MIC-KEY, SEGÚN CALIBRE SOLICITADO (24 FR.) DE DIFERENTES LONGITUDES EN EL RANGO DE 0.8 A 3.5 CMS.</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
<p>ANEXO T4. BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO</p>	<p>PROCEDIMIENTO:10.23.023 COLANGIOGRAFÍA CON ESFINTEROTOMÍA BILIAR Y COLOCACIÓN DE PRÓTESIS BILIAR Y PANCREÁTICA COMPLEJA. ID_BCB: BCB124DICE:STENT METÁLICO AUTOEXPANDIBLE CUBIERTA Y NO CUBIERTA DE NITINOL (O CUBIERTA EQUIVALENTE)BILIAR DE 6, 8, 10 MM. X 4, 6, 8 CM., DE LONGITUD.PREGUNTA:SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:STENT METÁLICO AUTOEXPANDIBLE CUBIERTA Y NO CUBIERTA DE NITINOL (O CUBIERTA EQUIVALENTE)BILIAR EN EL RANGO DE 6 A 10 MM. X 4, 6, 8 CM., DE LONGITUD.TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA</p>
<p>ANEXO T4. BIENES DE CONSUMO</p>	<p>PROCEDIMIENTO:</p>	<p>ACEPTAMOS LA NO OFERTACION YA QUE NO SE SOLICITA USG ENDOSCOPICO</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

<p>BÁSICO</p> <p>ANEXO NÚMERO 3 (TRES) REQUERIMIENTO</p>	<p>10.23.025 DRENAJE ENDOSCÓPICO DE PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA NO OFERTAR ESTE PROCEDIMIENTO, YA QUE NO FORMA PARTE DEL "ANEXO NÚMERO 3 (TRES) REQUERIMIENTO" SOLICITADO PARA ESTA UMAE.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
<p>ANEXO T4. BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO ANEXO NÚMERO 3 (TRES) REQUERIMIENTO</p>	<p>BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO: 10.22.902DICE:AGUJA DE ASPIRACIÓN PARA LESIONES Y BIOPSIA DE 19 A 25 GA., ESTÉRILES, CON EXTENSIÓN DE 8 CM., CON JERINGA INCLUIDA DE 5 Ó 10 CC., CON CAMISA PARA AJUSTE PREVIO A LA TOMA, CON SEGUROS DE LA CAMISA Y DE LA AGUJA, CON GUÍA METÁLICA, COMPATIBLE CON EL US ENDOSCÓPICO.PREGUNTA:SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA NO OFERTAR ESTE BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO YA QUE NO HAY NINGÚN PROCEDIMIENTO ASOCIADO A ESTE INSUMO QUE FORME PARTE DEL "ANEXO NÚMERO 3 (TRES) REQUERIMIENTO" SOLICITADO PARA ESTA UMAE.¿SE ACEPTA?</p>	<p>ES CORRECTO, NO SE ESTA SOLICITANDO SUMINISTROS PARA USG ENDOSCOPICO</p>
<p>ANEXO T4. BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO</p>	<p>BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO: 10.23.901</p> <p>DICE:</p> <p>PRÓTESIS METÁLICA, AUTOEXPANDIBLE, REMOVIBLE, TOTALMENTE CUBIERTA DE SILICÓN (O CUBIERTA EQUIVALENTE), CON DIÁMETRO EN EL RANGO DE 16 A 25 MM. Y UNA LONGITUD DE 5 A 18 CM., CON SISTEMA DE POSICIONAMIENTO (SEGÚN TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE).</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

	<p>PRÓTESIS METÁLICA, AUTOEXPANDIBLE, REMOVIBLE, TOTALMENTE CUBIERTA DE SILICÓN (O CUBIERTA EQUIVALENTE), CON DIÁMETRO EN EL RANGO DE 16 A 25 MM. Y UNA LONGITUD EN EL RANGO DE 5 A 18 CM., CON SISTEMA DE POSICIONAMIENTO (SEGÚN TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE).</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
<p>ANEXO T4. BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO</p>	<p>BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO: 10.23.908DICE:PRÓTESIS BILIAR, METÁLICA DE NITINOL (O CUBIERTA EQUIVALENTE)TOTALMENTE CUBIERTA, AUTOEXPANDIBLE, DE 10 MM., DE DIÁMETRO Y 4 CM., DE LONGITUD, CON INTRODUCOR DE 6 FR., GUÍA 0.035" PULGADAS, DE 200 CM., DE LONGITUD.PREGUNTA:SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:PRÓTESIS BILIAR, METÁLICA DE NITINOL (O CUBIERTA EQUIVALENTE)TOTALMENTE CUBIERTA, AUTOEXPANDIBLE, DE 10 MM., DE DIÁMETRO Y 4 CM., DE LONGITUD, CON INTRODUCOR DE 6 FR.O SISTEMA DE IMPLANTACIÓN DE 9FR., GUÍA 0.035" PULGADAS, DE 200 CM., DE LONGITUD O MAYOR.TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA</p>
<p>ANEXO T4. BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO</p>	<p>BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO: 10.23.909</p>	<p>SE ACEPTA YA QUE NO HAY CAMBIO EN LAS CARACTERISTICAS</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

	<p>DICE:</p> <p>PRÓTESIS ESOFÁGICA DE 18 MM. DE DIÁMETRO Y 7 A 12 CM., DE LONGITUD, CON GUÍA.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>PRÓTESIS ESOFÁGICA DE 18 MM. DE DIÁMETRO Y EN EL RANGO DE 7 A 12 CM., DE LONGITUD, CON GUÍA.</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
<p>ANEXO T4. BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO</p>	<p>BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO: 10.23.917DICE:EXTENSIÓN YEYUNAL PARA GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA 8.5 FR A 12 FR.; DE SILICONA, BALÓN DE RETENCIÓN, ANILLO DE RETENCIÓN, CONECTOR UNIVERSAL, PUERTO DE DESCOMPRESIÓN GÁSTRICA, MÚLTIPLES PUERTOS DE SALIDA, EXTREMO DISTAL EN PUNTA, CON CONTRAPESO DE TUNGSTENO. KIT QUE INCLUYA MATERIAL PARA SU COLOCACIÓN.PREGUNTA:SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:EXTENSIÓN YEYUNAL PARA GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA 8.5 FR A 12 FR.; DE SILICONA, BALÓN DE RETENCIÓN, ANILLO DE RETENCIÓN, CONECTOR UNIVERSAL, PUERTO DE DESCOMPRESIÓN GÁSTRICA, MÚLTIPLES PUERTOS DE SALIDA, EXTREMO DISTAL EN PUNTA, CON CONTRAPESO DE TUNGSTENO</p>	<p>SE ACEPTA LA OFERTA DE LA EXTENSION YEYUNAL PARA GASTROSTOMIA</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

	<p>O SONDA DE ALIMENTACIÓN YEYUNAL DE MÍNIMO 12 FR. CON PUNTA DISTAL RECORTABLE, PUERTO DE ACCESO, RADIOPACA Y ANILLO DE RETENCIÓN. KIT QUE INCLUYA MATERIAL PARA SU COLOCACIÓN. TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>ANEXO T4. BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO</p>	<p>BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO: 10.23.918</p> <p>DICE:</p> <p>CATÉTER DE ABLACIÓN CON ARGÓN HIBRIDA CON LONG DE MAS DE 1.9 METROS Y DIÁMETRO DE 2.3 MM O SONDA DE ARGÓN CON LONGITUD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PACIENTE.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>CATÉTER DE ABLACIÓN CON ARGÓN HIBRIDA CON LONG DE MAS DE 1.9 METROS Y DIÁMETRO DE 2.3 MM O SONDA DE ARGÓN CON FILTRO INTEGRADO CON LONGITUD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PACIENTE.</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>	<p>SE ACEPTA PROPUESTA DE CATETER DE ABLACIÓN CON ARGON HIBRIDA</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

<p>ANEXO T4. BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO</p>	<p>¿SE ACEPTA?</p> <p>BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO: 10.23.919DICE:POLVO HEMOSTÁTICO PARA COAPTACIÓN DE SANGRADO NO VARICEAL.PREGUNTA:SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:POLVO HEMOSTÁTICO PARA COAPTACIÓN DE SANGRADO NO VARICEAL Ó HEMOSPRAY PARA LA HEMOSTASIA ENDOSCOPICA.TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA LA OFERTA DEL POLVO HEMOSTATICO</p>
<p>ANEXO T4. BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO</p>	<p>BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO: 10.23.920</p> <p>DICE:</p> <p>SONDA DE COAGULACIÓN BIPOLAR PARA LESIONES SANGRANTES NO VARICEAL.</p> <p>PREGUNTA:</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>SONDA DE COAGULACIÓN BIPOLAR O COAGULACIÓN PLASMA ARGÓN PARA LESIONES SANGRANTES NO VARICEAL</p> <p>TOMANDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE PROPONE MI REPRESENTADA, NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD, PARA EL CUAL SERÁ UTILIZADO ESTE PRODUCTO, COMO PARTE DEL SERVICIO A BRINDAR, DE VERNOS FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA LA OFERTA DE LA SONDA DE COAGULACIÓN</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

<p>3.3. ANEXO TECNICO4.2.2. TERMINOS Y CONDICIONES</p>	<p>ES CORRECTO ENTENDER QUE, EN EL CASO DE QUE ALGÚN EQUIPO Y/O BIENES DE CONSUMO (BÁSICO O COMPLEMENTARIO), DE ORIGEN NACIONAL O INTERNACIONAL, EL LICITANTE ADVIERTA QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO,, DEBERÁ PRESENTAR UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES :A) CARTA DE LA COFEPRIS EN LA QUE SE INDIQUE QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO. OB) "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO" DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF) PUBLICADO EL 07-07-2025, EN EL QUE IDENTIFIQUE AQUELLOS QUE OFERTE DEBIDAMENTE REFERENCIADO. SIN SER NECESARIO PRESENTAR ALGÚN OTRO CERTIFICADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERA PRESENTAR: A) CARTA DE LA COFEPRIS EN LA QUE SE INDIQUE QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO. OB) "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO" DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF) PUBLICADO EL 07-07-2025, EN EL QUE IDENTIFIQUE AQUELLOS QUE OFERTE DEBIDAMENTE REFERENCIADO</p>
<p>3.3. ANEXO TECNICO, 4.2.4.2. TERMINOS Y CONDICIONES</p>	<p>SE ESTABLECE QUE SE DEBERÁ PRESENTAR , COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO-13485:2016 EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD APLICABLE PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS A NOMBRE DEL FABRICANTE O COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO FDA VIGENTE, O EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA (CEE), O CERTIFICADO DE CALIDAD DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE COFEPRIS, O MINISTERIO DE SALUD DE JAPÓN, VIGENTE EN EL IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN ACOMPAÑADO DE SU TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ADEMÁS DE LOS CERTIFICADOS MENCIONADOS EN EL REFERIDO NUMERAL LAS CERTIFICACIONES QUE SE ENLISTAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • HEALTH CANADA, • CONFORMITE EUROPEENNE (CE), • ISO-9001:2015 , • JAPANESE INDUSTRIAL STANDART (JIS) 	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

	<ul style="list-style-type: none"> • TECHNISHER UBERWACHUGS VERIEN (TUV) • AMERICAN NATIONAL ESTÁNDAR INSTITUTE/ASSOCIATIONFOR THE ADVANCEMENTOF MEDICAL INSTRUMENTATION (ANSI/AAMI) <p>¿SE ACEPTA?</p>	
4.2.6 AVISO DE IMPORTACIÓN, TERMINOS Y CONDICIONES.	EN EL CASO DE OFERTAR EQUIPAMIENTO NUEVO O USADO, DADO QUE LA IMPORTACIÓN DE ESTE TIPO DE PRODUCTOS NO ESTÁ SUJETA AL CUMPLIMIENTO DE UN AVISO DE IMPORTACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA POR NO SER PRODUCTOS SIDERÚRGICOS O MÁQUINAS TRAGAMONEDAS, PARA CUBRIR CABALMENTE ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTAS FACTURAS DE LOS EQUIPOS EN LAS CUALES SE INDICAN LOS PEDIMENTOS DE IMPORTACION CUANDO ESTOS SEAN EQUIPOS IMPORTADOS¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, PODRÁ PRESENTAR CARTAS FACTURAS DE LOS EQUIPOS EN LAS CUALES SE INDICAN LOS PEDIMENTOS DE IMPORTACION CUANDO ESTOS SEAN EQUIPOS IMPORTADOS
4.2.7. TERMINOS Y CONDI, FORMATO T30, ANEXO TECNICO 3.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA H. CONVOCANTE NOS CONFIRME A PARTIR DE QUE AÑO SE PODRAN OFERTAR LOS EQUIPOS USADOS , YA QUE DE ACUERDO AL FORMATO T30 ES A PARTIR DE 2019, Y EN NUMERAL 4.2.7. DE TERMINOS Y CONDICIONES ES A PARTIR DE 2020. FAVOR DE ACLARAR	PODRAN OFERTAR LOS EQUIPOS USADOS A PARTIR DEL AÑO 2020.
4.2.7. TERMINOS Y CONDICIONES	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA H. CONVOCANTE, QUE EN CASO DE OFERTAR EQUIPOS USADOS DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA Y A FIN DE COMPROBAR QUE LOS EQUIPOS SON FUNCIONALES Y SE ENCUENTRAN EN PERFECTAS CONDICIONES DE OPERACIÓN PODREMOS PRESENTAR "DICTAMEN TÉCNICO" Y/O UNA ORDEN DE SERVICIO,Y/O PÓLIZA Y/O BITÁCORA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ESTE DOCUMENTO PODRA SER EXPEDIDO POR EL LICITANTE, YA QUE SON EQUIPOS DE SU PROPIEDAD Y ES EL QUE BRINDA LOS MANTENIMIENTOS A LOS EQUIPOS, ¿SE ACEPTA?	EN CASO DE OFERTAR EQUIPOS USADOS DEBERÁ PRESENTAR DICTAMEN TÉCNICO Y/O UNA ORDEN DE SERVICIO,Y/O PÓLIZA Y/O BITÁCORA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ESTE DOCUMENTO DEBERA SER EXPEDIDO POR EL LICITANTE
3.3., 4.1.1., 5.1.1., ANEXO TEC 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4.2.TERMINOS Y CONDI	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA H. CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE FACILITAR LA CARGA Y DESCARGA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS EN EL SISTEMA COMPRAS MX Y	SE ACEPTA SU PROPUESTA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

	QUE NO SE EXCEDA LA CAPACIDAD Y POR ENDE NO SE PUEDA ENVIAR LA PROPUESTA, NOS PERMITA PRESENTAR UN COMPILADO DE REGISTROS SANITARIOS, OTRO DE CERTIFICADOS Y OTRO DE CATÁLOGOS Y/O MANUALES. ¿SE ACEPTA?	
4.2.11 VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES.	ES CORRECTO ENTENDER QUE AL SER OPCIONAL LAS VISITA A INSTALACIONES INSTITUCIONALES , EN CASO DE NO REALIZAR LA VISITA NO APLICA EL ESCRITO DE PROYECTO DE INSTALACIONAL GLOBAL DE LOS EQUIPOS . FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTO, EN CASO DE NO REALIZAR LA VISITA NO APLICA EL ESCRITO DE INSTALACION GLOBAL DE LOS EQUIPOS
3.3. PROPUESTA TÉCNICA L) CONVOCATORIA	SOLICITAMOS A ESTA H. CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA PRESENTAR OPINION IMSS CON FECHA DE TRES DIAS PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA, SE ACEPTA?	DEBERÀ PRESENTAR SUS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO VIGENTES, EXPEDIDAS CON MAXIMO 3 DIAS NATURALES ANTERIORES A LA PRESENTACION DE PROPUESTAS.
4.2.2., 4.2.4.2.TERMINOS Y CONDICIONES	SOLICITAMOS A ESTA H. CONVOCANTE, NOS COMPARTA LOS FORMATOS T32 Y T33, O EN SU CASO CONFIRMAR QUE PUEDEN SER ALABORADOS EN FORMATO LIBRE, FAVOR DE ACLARAR.	FAVOR DE ELABORAR EN FORMATO LIBRE

SE COMUNICA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DÍA **06 DE MARZO DE 2026 A LAS 09:30 HORAS.**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA **LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026**, SIENDO LAS 13:25 HORAS DEL MISMO DIA, MES Y AÑO, LEVANTANDO LA PRESENTE ACTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES Y PARA DEBIDA CONSTANCIA, FIRMANDO ELECTRONICAMENTE LAS PERSONAS QUE EN ELLA ACTUARON, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS ASISTENTES NO INVALIDA SU CONTENIDO Y EFECTOS, INFORMÁNDOLES QUE CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, ÉSTAS SE HACEN DE CONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (COMPRAS MX).

ASÍ MISMO PARA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE DIFUNDIRÁ LA PRESENTE ACTA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [HTTPS://COMPRASMX.BUENGOBIERNO.GOB.MX](https://comprasmx.buengobierno.gob.mx)

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

<p>_____</p> <p>DR. CONRADO ARMANDO LOPEZ SERRANO JEFE DIVISIÓN MEDICINA ADMINISTRADOR DE CONTRATO</p>	<p>_____</p> <p>DR. MAYO ALEXANDER PAYAN GOMEZ JEFE DEPARTAMENTO CLINICO DE ENDOSCOPIA AREA TECNICA</p>
---	--



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO INTEGRAL MINIMA INVASION (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) 2026 PARA LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL C.M.N MANUEL AVILA CAMACHO, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2026.

AREA ADMINISTRATIVA

<p>_____ MTRO. JORGE JESUS RESENDIZ ROSALES ENCARGADO DIRECCION ADMINISTRATIVA</p>	<p>_____ LAE. YADHYRA LIZZETTE SALAS VEGA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO</p>
<p>_____ C.P. ZURY SADAY HERRERA MORA ANALISTA COORDINADOR OFICINA DE ADQUISICIONES</p>	

HOJA DE FIRMAS ELECTRÓNICAS DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR046-N-10-2026.



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.



2026
año de
Margarita
Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>
