

The background features a large, semi-transparent watermark of the IMSS logo. The logo consists of a stylized figure of a person with arms raised, enclosed within a rounded square frame. Below this frame, the letters 'IMSS' are written in a bold, sans-serif font.

Se manifiesta que el
archivo publicado es
la mejor versión
disponible con la
que cuenta el
Instituto Mexicano
del Seguro Social.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato Número
15BI0496

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T23-2015

Contrato para la adquisición de Equipo Médico, correspondiente a los Programas de "Equipamiento Asociado a Obra 2015", para las Unidades Médicas: Hospital General Regional 230 Camas en Reynosa, Tamaulipas, Hospital General de Zona 165 Camas en Villa de Álvarez, Colima, Hospital General Regional 250 Camas en León, Guanajuato y "Programa de Reposición" (Diversas Unidades), que celebran por una parte el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, a quien en lo sucesivo se denominará "**EL INSTITUTO**" representado en este acto por el **LICENCIADO FERNANDO JUAN JOSÉ GÓMEZ DE LARA**, en su carácter de Apoderado Legal y, por la otra, la empresa **BIOABAST, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se denominará "**EL PROVEEDOR**" representada por **MARYCARMEN SILVA HERRERA**, en su carácter de Apoderado Legal, en su carácter de Apoderado Legal, a quienes de manera conjunta se les denominará "**LAS PARTES**" al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I.- "**EL INSTITUTO**" declara, a través de su Apoderado Legal, que:

I.1.- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para celebrar los actos jurídicos necesarios, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251 fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- El Licenciado Fernando Juan José Gómez de Lara se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de "**EL INSTITUTO**", de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número 122,655 de fecha 25 de agosto de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo Francisco García Villegas Sánchez Cordero, Notario Público número 248 del Distrito Federal, actuando como suplente en el protocolo de la Notaría número 15 del Distrito Federal, de la que es titular el Doctor Eduardo García Villegas, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

I.4.- La Maestra Patricia Belmont Zapata, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico de "**EL INSTITUTO**" interviene como Área Contratante en el procedimiento del cual se deriva el presente instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 69 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15B10496

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T23-2015

I.5.- El Ingeniero Jesús Guajardo Briones, Titular de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria de "EL INSTITUTO" interviene en la firma del presente contrato como Área Requirente en el procedimiento del cual se deriva este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.6.- El Ingeniero Miguel Ángel Rojas González, Titular de la División de Equipamiento Médico y la Ingeniera Amelia Patiño González, Titular de la Subjefatura de División de Investigación, Equipamiento y Desarrollo de Proyectos Sustentables, ambos de "EL INSTITUTO" intervienen en la firma del presente contrato como Área Técnica en el procedimiento del cual se deriva este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.7.- El Licenciado Luis Enrique Mendoza Flores, Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos de la Delegación Regional Colima de "EL INSTITUTO" interviene como Administrador del presente contrato, responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el presente instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.8.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de Equipo Médico, correspondiente a los Programas de "Equipamiento Asociado a Obra 2015", para las Unidades Médicas: Hospital General Regional 230 Camas en Reynosa, Tamaulipas, Hospital General de Zona 165 Camas en Villa de Álvarez, Colima, Hospital General Regional 250 Camas en León, Guanajuato y "Programa de Reposición" (Diversas Unidades).

I.9.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, de acuerdo a los oficio(s) de Liberación de Inversión (OLI), emitido(s) por el Titular de la División de Análisis del Programa de Inversión Física, mismo(s) que se agrega(n) al presente contrato como **Anexo 1 (uno)**.

I.10.- El presente contrato fue adjudicado a "EL PROVEEDOR" mediante el procedimiento de Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio electrónica número LA-019GYR040-T23-2015, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 26 Ter, 27, 28 fracción II, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 Bis fracción I, 37 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0496

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T23-2015

I.11.- Con fecha 07 de septiembre de 2015 la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a través de la División de Equipo y Mobiliario Médico, emitió el Acta de Fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede, resultando adjudicado **"EL PROVEEDOR"** con la(s) partida(s) que se detallan en la misma.

I.12.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la convocatoria y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la convocatoria respectiva, así como al resultado de la Junta de Aclaraciones.

I.13.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en Calle Durango número 291 P.H., Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700 México, Distrito Federal.

II.- **"EL PROVEEDOR"** declara, a través de su Apoderado Legal, que:

II.1.- Es una sociedad mercantil debidamente constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 2,526 de fecha 19 de junio de 2009, otorgada ante la fe del Licenciada Estela Álvarez Narváez, Titular de la Notaría Pública número 219 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta capital, bajo el folio mercantil electrónico número 399439-1.

II.2.- Se encuentra representada para la celebración de este contrato por Marycarmen Silva Herrera, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 22,669 de fecha 15 de abril de 2014, pasada ante la fe del Licenciado David F. Dávila Gomez, Notario Público número 190 del Distrito Federal; manifestando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

II.3.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en la compra, venta, importación, exportación, ensamble, distribución, consignación y arrendamiento de aparatos y equipos médicos, eléctricos, electrónicos, de computación, mobiliario hospitalario e instrumento de cirugía.

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes: **BIO090619UG7.**
- Registro Patronal ante **"EL INSTITUTO"**: **Y 68 78431 10 2.**

II.5.- Cuenta con el documento correspondiente, vigente y expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.27 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2015 y de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"** para efectos de la suscripción del presente contrato.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0496

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T23-2015

II.6.- Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por **“EL INSTITUTO”** exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

II.7.- Cuenta por sí o por conducto de quien subcontrate para el cumplimiento del objeto del presente contrato con el documento correspondiente, vigente, expedido por **“EL INSTITUTO”** relativo a la opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de **“EL INSTITUTO”** en la sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y su modificación publicada en el mismo de fecha 03 de abril del año en curso, el cual exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de **“EL INSTITUTO”**.

II.8.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que **“EL PROVEEDOR”** se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.9.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **“EL PROVEEDOR”** en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **“EL INSTITUTO”** deberá proporcionar la información que en su momento se requiera relativa al presente contrato.

II.10.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

II.11.- Para efectos legales y de notificación relacionados con el presente contrato en términos de lo establecido en el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos que deriven del presente contrato, el ubicado en Camino Real a Xochitepec número 108, Colonia la Noria, Delegación Xochimilco, Código Postal 16030, México, Distrito Federal, teléfono (55) 6550-0252, correo electrónico marycarmen.silva@bioabast.com.

Hechas las declaraciones anteriores, **“LAS PARTES”** convienen en otorgar el presente Contrato, de conformidad con las siguientes:



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0496

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T23-2015

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" adquiere de "EL PROVEEDOR" y éste se obliga a suministrar Equipo Médico, correspondiente al Programa de "Equipamiento Asociado a Obra 2015", para la Unidad Médica Hospital General de Zona 165 Camas en Villa de Álvarez, Colima, cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el **anexo 2 (dos)**, así como a las condiciones de la convocatoria, junta de aclaraciones y acta de fallo del procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el portal de compras gubernamentales CompraNet 5.0.


SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- Como contraprestación por el efectivo y satisfactorio suministro de los bienes objeto del presente contrato, "EL INSTITUTO" pagará a "EL PROVEEDOR" la cantidad de **\$3,728,165.42 (TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) dicha cantidad se ejercerá con base en los precios unitarios que se indican en el **Anexo 2 (dos)** de este contrato y acta de fallo del procedimiento del cual deriva el presente contrato.

"**LAS PARTES**" convienen que el presente instrumento jurídico se celebra bajo la modalidad de precios fijos, de acuerdo a los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- Para el trámite de pago "EL PROVEEDOR" deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes: IMS421231145, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, para la validación de dichos comprobantes "EL PROVEEDOR" deberá cargar en internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página de "EL INSTITUTO", el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

"EL PROVEEDOR" se obliga a no cancelar ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) los comprobantes fiscales digitales a favor de "EL INSTITUTO", previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del presente contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las Áreas de Trámite de Erogaciones de dicha justificación y Reposición del comprobante fiscal digital en su caso.

El pago de los bienes se efectuará en pesos mexicanos, en una sola exhibición o pagos parciales por partida completa entregada, a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega de la representación impresa del comprobante fiscal digital y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes a entera satisfacción de "EL INSTITUTO" en la División de Trámite de Erogaciones ubicada en calle Gobernador Tiburcio Montiel número 15 (Esquina con Gómez Pedraza), Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</p>	<p>Contrato Número 15B10496</p> <p>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LA-019GYR040-TZ3-2015</p>
---	---	--

Hidalgo, Código Postal, 11850, México, Distrito Federal, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas, previa validación y autorización que para tal efecto realice el Administrador del presente contrato.

La documentación comprobatoria a entregar por parte de "EL PROVEEDOR" será:

- a) Remisiones del pedido originales debidamente selladas y firmadas que amparen los bienes entregados a entera satisfacción en la Unidad receptora de "EL INSTITUTO" conforme al formato indicado en la convocatoria del procedimiento del cual deriva el presente contrato.
- b) Original del Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión (según aplique el caso).
- c) Copia del pedimento de importación (en su caso).
- d) Copia del Contrato.
- e) Copia de la Fianza.
- f) Carta garantía de los bienes, expedida por "EL PROVEEDOR".
- g) En su caso, Nota de Crédito por sanciones o penalizaciones en las que se indique:
 - Numero de Contrato
 - Numero de Proveedor
- h) Hoja de Entrega de Nota de Recepción emitida por el Sistema Institucional PREI Millenium, para la cual "EL PROVEEDOR" podrá ponerse en contacto con el Administrador del presente contrato, a fin de que se realice el registro de la recepción de los bienes a entera satisfacción en el Sistema de Compras de "EL INSTITUTO" (PREI Millenium), entregando una copia de la representación impresa del comprobante fiscal digital y documentación enlistada en los puntos anteriores debidamente requisitadas.

En caso de aplicar, de igual manera, "EL PROVEEDOR" deberá entregar Nota de Crédito a favor de "EL INSTITUTO" por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia de los bienes.

El pago se realizará por medio de transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que "EL INSTITUTO" tiene en operación, para tal efecto, "EL PROVEEDOR" se obliga a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, clabe, banco y sucursal a nombre de "EL PROVEEDOR" a menos que éste acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada de pago, a través del esquema intrabancario si la cuenta bancaria de "EL PROVEEDOR" está contratada con Banorte S.A., BBVA BANCOMER, S.A. o HSBC, S.A., a través del esquema electrónico intrabancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Intrabancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto de los mencionados.

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" junto con la factura de cobro respectiva, la "Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social" vigente y positiva.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0496

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T23-2015

Por lo anterior, **"EL PROVEEDOR"** deberá entregar solicitud de pago electrónico (intrabancario o interbancario) y presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e Identificación Oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** presente su (CFDI) o factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"** las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que **"EL PROVEEDOR"** presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

"EL PROVEEDOR" para efectos de transferir los derechos de cobro deberá contar con el consentimiento de **"EL INSTITUTO"** para lo cual deberá notificarlo por escrito a **"EL INSTITUTO"** a través del administrador del contrato con un mínimo de **5 (cinco)** días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los comprobantes cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en caso de que **"EL PROVEEDOR"** celebre Contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** reciba pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL INSTITUTO"**.

El pago de los bienes quedará condicionado al descuento que **"EL INSTITUTO"** efectuará a **"EL PROVEEDOR"** por concepto de penas convencionales y/o deducciones aplicables, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- **"EL PROVEEDOR"** se obliga a suministrar a **"EL INSTITUTO"** los bienes que se mencionan en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, conforme a lo siguiente:

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.- Los plazos y lugar de entrega de los bienes a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"** serán los señalados en de la **Guía de Distribución y Requisitos de Instalación y Capacitación**, incluida en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato. Asimismo, el plazo de entrega se contabilizará a partir del día natural siguiente al Acto de comunicación de Fallo; lo anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 46 de la Ley



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0496

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T23-2015

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 quinto párrafo de su Reglamento.

Para la logística de la entrega de los bienes, "EL PROVEEDOR" se deberá coordinar con el Administrador del presente contrato o con el personal de la Unidad Recepción que este le indique.

Los Servidores Públicos señalados en el "Directorio de Responsables de la recepción de los bienes" incluido en las condiciones de la convocatoria del procedimiento del cual deriva el presente contrato serán los responsables de la recepción de los bienes a entera satisfacción de "EL INSTITUTO". Lo anterior, con la finalidad de garantizar que los bienes cumplan cabalmente con cada especificación y característica contenida en la cédula de descripción de artículo (oferta técnica de "EL PROVEEDOR") conforme a lo establecido en el **Anexo 3 (tres)** la cual forma parte integral del presente contrato.

Asimismo, el Administrador del presente contrato, así como los Responsables de la Recepción de los Bienes, serán los responsables de suscribir las "Actas Administrativas Circunstanciadas de Entrega, Recepción, Instalación, Capacitación y Puesta en Operación de Bienes de Inversión" o "Actas Administrativas Circunstanciadas de Rechazo de Bienes de Inversión", según sea el caso, conforme a los formatos que se agregan en la convocatoria y junta de aclaraciones del procedimiento del cual deriva el presente contrato.

En caso de que la Unidad Médica, no se encuentre en condiciones de recibir los bienes a entera satisfacción de "EL INSTITUTO" el Administrador del presente contrato, deberá solicitar por escrito a la Coordinación de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a más tardar con 15 (quince) días hábiles de antelación a los plazos de entrega de los bienes, la elaboración del convenio modificatorio, dentro de la vigencia del mismo; señalando las causas por las cuales los bienes no puedan ser recibidos, e indicando la nueva fecha de entrega, de conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento, indicando la fecha límite de entrega.

Para tal efecto, "EL PROVEEDOR", se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103 fracción II del citado Reglamento.

CONDICIONES DE ENTREGA.- La entrega de los bienes se realizará bajo el esquema de Delivered Duty Paid (DDP) "Entregada Derechos Pagados".

"EL PROVEEDOR" deberá entregar junto con los bienes una "Remisión del Pedido" en el formato Institucional, mismo que se agrega en la convocatoria del procedimiento del cual deriva el presente contrato, la cual deberá recabar en 3 (tres) tantos originales, foliada y debidamente requisitada en todos sus rubros; en esta remisión del pedido la Unidad Médica receptora de los bienes, asentará, sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula de "EL INSTITUTO" de la persona que recibe, conforme a lo señalado en los formatos de las Actas Administrativas, incluidas en la convocatoria y junta de aclaraciones del procedimiento del cual deriva el presente contrato y sello con la clave presupuestal PREI correspondiente a la



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0496

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T23-2015

unidad receptora. Este documento, será requisito indispensable para el trámite del pago correspondiente por parte de **“EL PROVEEDOR”**.

“EL PROVEEDOR” deberá cubrir todos los gastos para mantener asegurados los bienes y absorber todos los riesgos, hasta la recepción de los mismos a entera satisfacción de **“EL INSTITUTO”** conforme a lo señalado en la “Guía de Distribución y Requisitos de Instalación y Capacitación” incluida en las condiciones de la convocatoria y junta de aclaraciones del procedimiento del cual deriva el presente contrato.

La recepción de los bienes estará sujeta, en primer lugar a la recepción de la documentación completa descrita en el presente Instrumento jurídico.

La documentación a que se refiere el párrafo anterior, puede estar compuesta por lo siguiente, según cada caso:

- Remisión del Pedido (en la que se hará referencia entre otros datos al número de contrato, clave, descripción, precio, cantidad y fecha de entrega).
- Lista de empaque en la que se detallen las características del embalaje, dimensiones y peso del(os) bien(es).
- Original de Carta de Garantía de los bienes por el periodo establecido en el presente contrato.
- Carta con el compromiso de Capacitación (de acuerdo a lo solicitado en el presente instrumento jurídico).
- Programa Calendarizado o Calendario de Servicios de Mantenimiento Preventivo.
- Juego(s) de Manuales originales de Servicios para Mantenimiento Correctivo.
- Juego(s) de Manuales originales de Operación del bien.
- Manuales de Administración y de Configuración de sistemas informáticos, de conformidad a lo estipulado en el “Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión” incluida en la convocatoria y junta de aclaraciones del procedimiento del cual deriva el presente contrato.

En segundo lugar, la verificación total del embarque, el bien deberá de entregarse perfectamente empacado, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para **“EL INSTITUTO”**.

Al configurarse alguno(os) de los supuestos de rechazo enmarcados en el “Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de Bienes de Inversión”, misma que se encuentra incluida en la convocatoria y junta de aclaraciones del procedimiento del cual deriva el presente contrato, se procederá a levantar el “Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Bienes de Inversión con las acciones legales conducentes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0496

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T23-2015

Los bienes deberán de ser entregados con la Información mínima obligatoria de tipo sanitario para los dispositivos médicos, sujeta al cumplimiento de la NOM -137-SSA1-2008, Etiquetado de Dispositivos Médicos, con la siguiente información:

- A. Nombre o denominación, domicilio completo, teléfono y correo electrónico del fabricante.
- B. Nombre o razón social, domicilio completo, teléfono y correo electrónico del representante en México.
- C. Plazo de garantía expresado en tiempo, por ejemplo 36 (treinta y seis) meses. Aunque la cobertura real deberá iniciar cuando se levante acta circunstanciada donde conste la instalación y puesta en marcha y capacitación a entera satisfacción de "EL INSTITUTO" estipulando en la misma, la fecha de término.

Cada uno de ellos deberá de estar marcado con la siguiente información:

- Denominación genérica del producto.
- Denominación distintiva del producto.
- Datos del fabricante
 - a. Bienes Nacionales: Hecho en México por: razón social y domicilio.
 - b. Bienes Internacionales: Hecho en: país, razón social y domicilio.
- País de origen. Leyenda alusiva o gentilicio.
- Número de registro otorgado por la Secretaría de Salud.
- Número de serie.
- Contenido.
- Instrucciones de uso.
- Todo incidente adverso que pueda ocasionar el uso del producto cuando aplique.
- Leyendas de advertencia o precaución o ambas cuando las características de los dispositivos así lo requieran.
- Para el caso de equipos y agentes de diagnóstico en los que intervengan fuentes de radiación declarar la leyenda: "Peligro, material radiactivo para uso exclusivo en medicina".
- "Producto estéril", "No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga señales de haber sufrido ruptura previa", y las leyendas alusivas o el símbolo correspondiente que indiquen el proceso de esterilización tales como: "Esterilizado con óxido de etileno", "Esterilizado con radiación gamma", "Esterilizado con calor seco o húmedo", para productos estériles.
- "Desechable", "Usar solamente una vez" u otras leyendas alusivas o símbolo correspondiente, en los productos para ser usados una sola vez.
- Cuando por las características del producto se requieran temperaturas especiales de almacenamiento, éstas deberán ser indicadas y expresarse en °C, así como las condiciones de humedad especiales requeridas por el producto o cualquier otra condición específica, cuando aplique, tal como la protección a la luz, mismas que serán indicadas en la etiqueta o contraetiqueta correspondiente.
- La clave o descripción del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud vigente correspondiente al dispositivo médico.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0496

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T23-2015

La información contenida en las etiquetas o contra-etiquetas debe corresponder a lo expresado en los proyectos de marbete autorizados por la Secretaría de Salud de conformidad con las disposiciones aplicables y no podrán ser modificadas.

En tercer lugar, la recepción de los bienes estará sujeta, a la verificación de cada uno de los bienes que se están entregando, los cuales deberán cumplir cabalmente con cada especificación y característica contenida en la cédula de descripción de artículo (oferta técnica de "EL PROVEEDOR") la cual forma parte integral del presente Instrumento jurídico y se encuentra agregada en el **Anexo 2 (dos)** y se verificará una a una, por el grupo de trabajo designado por la Unidad.

También se verificarán el cumplimiento de guías mecánicas, especificaciones especiales y equipos accesorios con los que cuente el bien que se está entregando.

En cuarto lugar se verificará el cumplimiento del programa de capacitación, que haya contemplado todas las funciones y características del bien adquirido, cambio y reemplazo de consumibles, así como mantenimientos periódicos por parte del usuario para el buen manejo y aprovechamiento del bien, a entera satisfacción de "EL INSTITUTO".

"EL PROVEEDOR" se compromete a entregar los bienes objeto del presente contrato, cuyas características, alcances y especificaciones se encuentran establecidas en el **Anexo 2 (dos)** así como a las condiciones de la convocatoria, junta de aclaraciones y acta de fallo del procedimiento del cual deriva el presente contrato. del presente instrumento jurídico, debiendo cumplir con los siguientes rubros:

- 2.2.1 RECEPCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN
- 2.2.2 CAPACITACIÓN.
- 2.2.3 MANUALES.

CALIDAD.- "EL INSTITUTO" se reserva el derecho de verificar en cualquier tiempo durante el procedimiento y posterior a su adjudicación, los Registros Sanitarios con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con la intención de corroborar la veracidad de la información proporcionada por "EL PROVEEDOR".

QUINTA.- CANJE.- "EL INSTITUTO" por conducto del Administrador del presente contrato, a petición del responsable administrativo de la Unidad Médica, podrá solicitar a "EL PROVEEDOR" el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el presente contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio. Dicha solicitud se formalizará a "EL PROVEEDOR" dentro del período de 5 (cinco) días hábiles siguientes al momento en que el Administrador del presente contrato haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Quando concurra alguno de los supuestos anteriores, "EL PROVEEDOR" deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 6 (seis) días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos a entera satisfacción de "EL INSTITUTO" en un plazo no mayor de 30

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 11 de 20

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0496

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T23-2015

(treinta) días naturales, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte de "EL INSTITUTO" siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien. En caso de canje de los bienes, el servicio no deberá ser interrumpido, se realizará de manera subrogada y los gastos por estos conceptos correrán por cuenta de "EL PROVEEDOR".

Todos los gastos que se generen con motivo de la reparación o canje, así como los gastos por concepto de traslado de los derechohabientes, correrán por cuenta de "EL PROVEEDOR" previa notificación de "EL INSTITUTO".

SEXTA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES" convienen en que la vigencia del presente contrato será a partir de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2015.

SÉPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de "EL INSTITUTO" a través del Administrador del contrato para tal efecto.

"EL PROVEEDOR", deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por "EL PROVEEDOR" se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.- "EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o deficiencias presentadas de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOVENA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por "EL PROVEEDOR" conforme a la legislación aplicable en la materia.

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

"EL PROVEEDOR" en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. "EL INSTITUTO" a través del Área fiscalizadora competente podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0496

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T23-2015

"EL PROVEEDOR" podrá solicitar a "EL INSTITUTO" a través del Área competente, por escrito y previo al cobro de cualquier factura, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 B último párrafo de la Ley del Seguro Social, en el supuesto que durante la vigencia del presente contrato, se generen cuentas por liquidar a su cargo, líquidas y exigibles a favor de "EL INSTITUTO" le sean aplicados como descuento en los recursos que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales.

DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga para con "EL INSTITUTO" a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, "EL PROVEEDOR" manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL INSTITUTO" por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a "EL PROVEEDOR" para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de "EL INSTITUTO" de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 45 fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a "EL INSTITUTO", las garantías que se enumeran a continuación:

A) GARANTÍA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" deberá entregar conjuntamente con los bienes, escrito en papel membretado de éste, firmado por su representante legal, por el que se garantice los bienes objeto del presente contrato conforme al plazo establecido en su propuesta técnica incluida en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato (36, 42 ó 48 meses), con cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, contados a partir de la fecha de entrega de los bienes a entera satisfacción de "EL INSTITUTO", conforme al Anexo número 5-D (cinco-D) de la convocatoria de la cual deriva el presente contrato.

La cual deberá contemplar los aspectos descritos en los numerales 14.1.1 Capacitación, 14.1.2 Tiempos máximos de reparación o atención de fallas, 14.1.3 Mantenimiento correctivo y/o preventivo y 14.1.4 Consumibles y refacciones de la convocatoria que sirvió de base para la elaboración del presente instrumento jurídico, la cual está disponible para su consulta en el portal de compras gubernamentales CompraNet 5.0.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0496

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T23-2015

B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este instrumento jurídico, en términos del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del "Instituto Mexicano del Seguro Social", por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra en la convocatoria del procedimiento del cual deriva el presente contrato, en la División de contratos, ubicada en la calle Durango número 291 10º Piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700 México, Distrito Federal.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato se liberará de forma inmediata a "EL PROVEEDOR" una vez que "EL INSTITUTO" le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a "EL PROVEEDOR" siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo cual deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes:

- a) Se rescinda administrativamente este contrato.
- b) Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes suministrados, en comparación con los ofertados.
- c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al presente contrato, no entregue "EL PROVEEDOR" en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento jurídico, establecido en la Cláusula Décima Primera inciso b).
- d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

De conformidad con el artículo 81 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0496

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T23-2015

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL INSTITUTO" aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes a entera satisfacción de "EL INSTITUTO", por el equivalente al 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, en cada uno de los supuestos siguientes:

- a) Cuando "EL PROVEEDOR" no entregue a entera satisfacción de "EL INSTITUTO" los bienes que le hayan sido requeridos, en los plazos previstos en la Cláusula Cuarta del presente instrumento jurídico. En este supuesto, la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de 4 (cuatro) días naturales, como entrega con atraso.
- b) Cuando "EL PROVEEDOR" no reponga dentro del plazo señalado en la Cláusula Quinta del presente contrato, los bienes que "EL INSTITUTO" haya solicitado para su canje.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida que se trate. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

El Administrador del presente contrato será el encargado de realizar el trámite de la aplicación de las penas convencionales, objeto del presente instrumento jurídico y de comunicar los incumplimientos cuando así lo amerite el caso.

"EL INSTITUTO" descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR" autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en párrafos anteriores, sobre los pagos que a él deberán de cubrirse, durante el período en que incurra y/o se mantenga el incumplimiento con motivo del suministro de los bienes.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, a cargo de "EL INSTITUTO".

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL INSTITUTO" o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0496

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T23-2015

instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

La terminación anticipada del presente contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables por la terminación anticipada serán pagados siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA QUINTA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en cualquiera de las causales que de manera enunciativa más no limitativa se señalan a continuación:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, a más tardar dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración de este contrato.
3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en este instrumento jurídico y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que **"EL PROVEEDOR"** haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.
5. En caso de que **"EL PROVEEDOR"** no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
8. Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.
9. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a **"EL INSTITUTO"** la sanción impuesta a **"EL PROVEEDOR"** con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley Federal de Competencia Económica y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
10. En caso de que durante la vigencia de éste contrato la renovación del Registro Sanitario no resulte favorable por la autoridad sanitaria; o bien, se reciba comunicado por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en el sentido de que **"EL PROVEEDOR"** ha sido sancionado, o se le ha revocado el Registro Sanitario correspondiente.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0496

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T23-2015

11. En caso de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), dictamine que respecto de los bienes existe alerta médica durante la vigencia del presente instrumento jurídico.
12. Si **"EL PROVEEDOR"** no permite a **"EL INSTITUTO"** la administración y verificación a que se refiere la cláusula **Vigésima** señalada en el presente contrato.

DÉCIMA SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- **"EL INSTITUTO"**, en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

- a) Si **"EL INSTITUTO"** considera que **"EL PROVEEDOR"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **"EL PROVEEDOR"** de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de **5 (cinco)** días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.
- b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **"EL PROVEEDOR"** dentro de los **15 (quince)** días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda este contrato, **"EL INSTITUTO"** no aplicarán las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que **"EL INSTITUTO"** determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los **20 (veinte)** días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"**, por concepto de la entrega de los bienes por **"EL PROVEEDOR"** hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"**, bajo su responsabilidad podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato, **"EL PROVEEDOR"** entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0496

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T23-2015

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, "EL INSTITUTO" elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido este contrato, "EL INSTITUTO" establecerá, de conformidad con "EL PROVEEDOR" un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que "EL PROVEEDOR" subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En cualquier momento durante la vigencia del presente contrato, "EL PROVEEDOR" o "EL INSTITUTO" podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en "EL INSTITUTO" solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

La solicitud se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, además hará referencia al número de contrato, al servidor público encargado de su administración, objeto, vigencia y el monto del contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.

DÉCIMA OCTAVA.- RELACIÓN LABORAL.- "LAS PARTES" convienen en que "EL INSTITUTO", no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con "EL PROVEEDOR", ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de "EL PROVEEDOR".

Por lo anterior, no se le considerará a "EL INSTITUTO" como patrón, ni aún substituto, y "EL PROVEEDOR", expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

"EL PROVEEDOR" se obliga a liberar a "EL INSTITUTO" de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0496

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T23-2015

DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento, "EL INSTITUTO" podrá celebrar por escrito convenio modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

PRÓRROGAS.- Asimismo se podrán acordar prórrogas al plazo de entrega originalmente pactado por caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a "EL INSTITUTO", todo lo cual deberá estar debidamente acreditado en el expediente de contratación respectivo. "EL PROVEEDOR" puede solicitar la modificación del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificación a los derechos y obligaciones estipuladas por "LAS PARTES" en el presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

VIGÉSIMA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.- Será responsabilidad del servidor público indicado en el apartado de declaraciones de "EL INSTITUTO" de este instrumento jurídico, administrar y verificar el cumplimiento del presente contrato; de conformidad con lo establecido en el penúltimo y último párrafo del artículo 84 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente de dicho servidor público, tendrá carácter de **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** la persona que lo sustituya en el cargo.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante del presente contrato.

- Anexo 1 (uno) "Oficio(s) de Liberación de Inversión (OLI)"
- Anexo 2 (dos) "Propuesta Técnica y Económica"
- Anexo 3 (tres) "Guía de Distribución con Requisitos de Instalación y Capacitación y Domicilio"

VIGÉSIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.

VIGÉSIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0496

LICITACIÓN PÚBLICA
 INTERNACIONAL
 LA-019GYR040-T23-2015

mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas "LAS PARTES" del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por sextuplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día **22 de septiembre de 2015**, quedando un ejemplar en poder de "EL PROVEEDOR" y los demás en poder de "EL INSTITUTO".

"EL INSTITUTO"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

"EL PROVEEDOR"
BIOABAST, S.A. DE C.V.

LICENCIADO FERNANDO JUAN JOSÉ GÓMEZ DE LARA
 Representante Legal

MARYCARMEN SILVA HERRERA
 Apoderado Legal

ÁREA CONTRATANTE

ÁREA REQUIRENTE

MAESTRA PATRICIA BELMONT ZAPATA
 Titular de la División de Equipo y Mobiliario Médico

INGENIERO JESÚS GUJARDO BRIONES
 Titular de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria

ÁREA TÉCNICA

ÁREA TÉCNICA

INGENIERO MIGUEL ÁNGEL ROJAS GONZÁLEZ
 Titular de la División de Equipamiento Médico

INGENIERA AMELIA PATIÑO GONZÁLEZ
 Titular de la Subjefatura de División de Investigación, Equipamiento y Desarrollo de Proyectos Sustentables

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

LICENCIADO LUIS ENRIQUE MENDOZA FLORES
 Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos de la Delegación Regional Colima

Las firmas que anteceden, forman parte del contrato número **15BI0496** celebrado entre el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** y la empresa denominada **BIOABAST, S.A. DE C.V.**, de fecha 22 de septiembre de 2015.

JASS/AAL/RAOV

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
 DIVISIÓN DE CONTRATOS
 NIVEL CENTRAL

Página 20 de 20

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0496

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T23-2015

ANEXO 1 (UNO)

"OFICIO(S) DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN (OLI)"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 3 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

SIN TEXTO

l

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO
E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Ing. Jesús Guajardo Briones
Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria

Fecha del OLI Capítulo Equipamiento

Presente

México, D.F., a 12 de junio de 2015

Oficio de solicitud del área requirente: 095384611300/901
El Titular de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, solicita la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) referente al presupuesto 2015 por un monto de \$67,980,802.45 correspondiente al Programa Equipo Asociado a Obra, para realizar la adquisición de 112 bienes destinados al Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 166 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1).

Tipo OLI:	Adquisición
Oficio de Liberación de Inversión (OLI)	
No. 09900116B3000/BMI/	110 0694

Descripción del Programa de Inversión Física 2015						
Clave de cartera SHCP	No. solicitud de SHCP	Unidad Responsable	Modalidad	Forma de financiamiento	Nombre del Programa o Proyecto	
1250GYR0003	37323	GYR	K012	4	Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 166 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1)	
		No.		Localización de bienes	Costo del bien fiscal	Número de Proyecto PREI
		06		Celipa	761,467,892	12580001

Autorización de gasto

Se emite el presente OLI de conformidad al acuerdo ACDO.AS3.HCT.270515/100.P.DF, artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156.A de su Reglamento; 25 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.3 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y al oficio circular 0990011670000/697, firmado por el entonces Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2015.

Unidad Responsable del Gasto (URG): 09 Nivel Central
Número de bienes: 112
Monto original con IVA: 67,980,802.45

(sesenta y siete millones novecientos ochenta mil seiscientos dos pesos 45/100 m.n.)

Por tanto, el monto señalado se ha registrado en el Sistema Financiero PREI Millenium para que la URG ejerza los recursos conforme al Anexo 1 que se adjunta, y con base en los artículos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,
El Coordinador

Mtro. Jorge David Esquivel Anchondo

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO
E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Ing. Jesús Guajardo Briones
Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria

Fecha del OLI Capítulo Equipamiento

Presente

México, D.F., a 12 de junio de 2015

Oficio de solicitud del área requeriente:	0953845119007001
El Titular de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, solicita la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) referente al presupuesto 2015 por un monto de \$67,980,602.45 correspondiente al Programa Equipo Asociado a Obra, para realizar la adquisición de 112 bienes destinados al Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1).	

Tipo OLI:	Adquisición
Oficio de Liberación de Inversión (OLI)	
No. 09900116B3000/BMI/	110 10694

Normatividad

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.

Es importante considerar las disposiciones contenidas en el "Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", además de los "Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", para la adquisición en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

ANEXOS

Con copia para:
Lic. Georgina Sánchez Aragón, Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Colima @
Mtro. Daniel Saúl Brod Krause, Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica. (SICGC)

SICGC Se enviará por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.
@ Se enviará por correo electrónico institucional.



OLI No.: 1180594

Clave de Cartera SHCP : 1250GYR003
No. solicitud de SHCP : 37323

Nombre del programa o proyecto : Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1)

No. de programa o proyecto PREI : 1206001

Tipo de Bien	ID de Transacción	ID de Solicitud	CUR	PREI Múltiple Presupuesto del Destino del Bien				SAI				PREI	PREI Múltiple Control de Compromisos				Método autorizada						
				Municipio/Estado		Ubicación	UJ	Costo de Costo	GPO-GEN	ESP	DIF		VAR	ID de Artículo	Descripción	URS	URS Updada Es	UI	Centro de Costo	Cuenta	Periodo Pysas	Nº de meses	Importe Total con IVA
Aparatos Médicos	1178912	000157899	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	531-033	0396	35	01	18313	ANESTESIA UNIDAD DE EQUIPO R	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,037,000	1,037,000.00	
Aparatos Médicos	1178913	000157893	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	531-316	0394	03	04	18342	VIDEODIAGNÓSCOPIO ADULTO CON TOR	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	2	1,021,000	2,042,000.00	
Aparatos Médicos	1178914	000157409	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-282	0333	02	01	18377	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOT	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	0	146,721	1,215,698.00	
Aparatos Médicos	1178915	000157476	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-497	2085	02	01	18379	INCUBADORA PARA RECÉN NACIDO	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	7	290,300	1,788,900.00	
Aparatos Médicos	1178916	000157485	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-781	0307	31	01	18300	RESECTOSCOPIO DE FILLO CONTINUO	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,222,181	1,528,181.00	
Aparatos Médicos	1178917	000157509	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-941	0380	03	02	18416	VENTILADOR VOLUMÉTRICO NEONATA	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	8	865,300	4,321,000.00	
Aparatos Médicos	1178918	000157529	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-924	0321	06	01	18417	ULTRASONOGRAFÍA INTERMEDIO EQUI	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	530,647	976,647.00	
Aparatos Médicos	1178919	000157542	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-929	0331	05	01	18418	ULTRASONOGRAFÍA AVANZADO EQUIP	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	2	1,236,600	2,478,200.00	
Aparatos Médicos	1178920	000157557	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-924	0325	05	01	18419	ULTRASONOGRAFÍA OBSTETRI	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	2	1,044,000	2,088,000.00	
Aparatos Médicos	1178921	000157562	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-924	0351	05	01	18420	ULTRASONOGRAFÍA OBSTETRI	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,170,000	2,040,000.00	
Aparatos Médicos	1178922	000157569	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-953	0364	05	01	18400	UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA U	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	5	807,400	4,037,000.00	
Aparatos Médicos	1178923	000157577	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-953	0372	06	01	18401	UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIO	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	6	804,337	4,027,210.00	
Aparatos Médicos	1178924	000157582	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-941	1812	01	01	18402	VENTILADOR DE ALTA PRESIÓN	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	696,000	1,218,000.00	
Aparatos Médicos	1178925	000157594	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-941	0366	05	01	18403	RESPIRADOR DE VOLUMEN DIRECTO	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	2	1,201,000	2,402,000.00	
Aparatos Médicos	1178926	000157602	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-941	0316	05	01	18404	RESPIRADOR CON SERVICIO DE SA	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	5	801,500	4,017,500.00	
Mobiliario Médico	1178927	000157605	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-217	0348	01	01	11731	UNIDAD DIAGNÓSCOPIO DERMATOLÓGICO	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,000,000	1,000,000.00	
Mobiliario Médico	1178928	000157611	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-284	0351	01	01	11732	ECCARDIÓGRAFO DIGITAL PERSONAL D	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,000,000	1,000,000.00	
Mobiliario Médico	1178929	000157616	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-284	0340	01	01	11733	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DE	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,000,000	1,000,000.00	
Mobiliario Médico	1178930	000157623	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-284	0340	01	01	11734	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DE	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,000,000	1,000,000.00	
Mobiliario Médico	1178931	000157630	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-284	0340	01	01	11735	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DE	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,000,000	1,000,000.00	
Mobiliario Médico	1178932	000157637	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-284	0340	01	01	11736	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DE	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,000,000	1,000,000.00	
Mobiliario Médico	1178933	000157644	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-284	0340	01	01	11737	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DE	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,000,000	1,000,000.00	
Mobiliario Médico	1178934	000157651	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-284	0340	01	01	11738	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DE	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,000,000	1,000,000.00	
Mobiliario Médico	1178935	000157658	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-284	0340	01	01	11739	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DE	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,000,000	1,000,000.00	
Mobiliario Médico	1178936	000157665	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-284	0340	01	01	11740	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DE	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,000,000	1,000,000.00	
Mobiliario Médico	1178937	000157672	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-284	0340	01	01	11741	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DE	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,000,000	1,000,000.00	
Mobiliario Médico	1178938	000157679	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-284	0340	01	01	11742	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DE	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,000,000	1,000,000.00	
Mobiliario Médico	1178939	000157686	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-284	0340	01	01	11743	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DE	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,000,000	1,000,000.00	
Mobiliario Médico	1178940	000157693	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-284	0340	01	01	11744	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DE	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,000,000	1,000,000.00	
Mobiliario Médico	1178941	000157700	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-284	0340	01	01	11745	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DE	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,000,000	1,000,000.00	
Mobiliario Médico	1178942	000157707	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-284	0340	01	01	11746	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DE	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,000,000	1,000,000.00	
Mobiliario Médico	1178943	000157714	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-284	0340	01	01	11747	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DE	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,000,000	1,000,000.00	
Mobiliario Médico	1178944	000157721	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-284	0340	01	01	11748	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DE	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,000,000	1,000,000.00	
Mobiliario Médico	1178945	000157728	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-284	0340	01	01	11749	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DE	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,000,000	1,000,000.00	
Mobiliario Médico	1178946	000157735	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-284	0340	01	01	11750	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DE	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,000,000	1,000,000.00	
Mobiliario Médico	1178947	000157742	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-284	0340	01	01	11751	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DE	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,000,000	1,000,000.00	
Mobiliario Médico	1178948	000157749	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-284	0340	01	01	11752	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DE	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,000,000	1,000,000.00	
Mobiliario Médico	1178949	000157756	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-284	0340	01	01	11753	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DE	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,000,000	1,000,000.00	
Mobiliario Médico	1178950	000157763	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-284	0340	01	01	11754	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DE	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,000,000	1,000,000.00	
Mobiliario Médico	1178951	000157770	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-284	0340	01	01	11755	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DE	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,000,000	1,000,000.00	
Mobiliario Médico	1178952	000157777	11	VILLA ALVAREZ	0814000	000104	200200	631-284	0340	01	01	11756	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DE	09	09230007	090001	130000	13350109	2915400	1	1,000,000	1,000,000.00	
Mobiliario Médico	1178953	0001577																					

DIVISION DE COMERCIO
BOGOTÁ

TESTIMONIOS

P



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Contrato Número
15B10496**

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T23-2015

**ANEXO 2 (DOS)
"PROPUESTA TECNICA Y ECONÓMICA"**

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 44 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

SIN TEXTO



BIOABAST S.A. DE C.V.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,

para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	9
PARTIDA	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD		
CLAVE SAI	531.053.0356.05.01 000000000016313		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AISYS
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, CATALOGO 9, CATALOGO 10, CATALOGO 11, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2.
HOJA 1 DE 20	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

<p>ESPECIFICACIONES</p> <p>DESCRIPCIÓN TECNICA DEL LICITANTE</p> <p>1. DEFINICION</p> <p>1.1 Unidad de anestesia general, para administración de oxígeno, óxido nitroso, otros gases medicinales v agentes anestésico.</p> <p>2. DESCRIPCION:</p> <p>2. 1.- Gabinete:</p> <p>2.1.1.- Montaje para dos vaporizadores o dosificador electrónico.</p> <p>2.1.2.- Ventilador interconstruido.</p> <p>2.1.3.- Con al menos cuatro contactos eléctricos interconstruidos.</p> <p>2.1.4.- Yugos para cilindros de O2 y N2O.</p> <p>2.1.5.- Con al menos un cajón.</p>

<p>ESPECIFICACIONES</p> <p>DESCRIPCIÓN TECNICA DEL LICITANTE</p> <p>1. DEFINICION</p> <p>1.1 Unidad de anestesia general, para administración de oxígeno, óxido nitroso, otros gases medicinales y agentes anestésico. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 1-2.</p> <p>2. DESCRIPCION:</p> <p>2.1.- Gabinete: CATALOGO 1 PAGINA 1.</p> <p>2.1.1.- Montaje para tres vaporizadores electronicos. CATALOGO 1 PAGINA 4. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 11-31.</p> <p>2.1.2.- Ventilador interconstruido. CATALOGO 1 PAGINA 1, 3.</p> <p>2.1.3.- Con cuatro contactos eléctricos interconstruidos. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-3.</p> <p>2.1.4.- Yugos para cilindros de O2 y N2O. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-3, 11-3, 11-5.</p> <p>2.1.5.- Tres cajones. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA A.</p> <p>2.1.6.- Mesa de trabajo. CATALOGO 1 PAGINA 1.</p>

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO,D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail:bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,

para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	9
PARTIDA	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD		
CLAVE SAI	531.053.0356.05.01		
	000000000016313		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

2.1.6.- Mesa de trabajo.
 2.1.7.- Montaje en máquina para monitor de signos vitales.
 2.1.8.- Cuatro ruedas, al menos dos de ellas con freno o sistema de freno central.
 2.1.9.- Manómetros digitales codificados de acuerdo al código americano de colores (02- verde, N20- azul, aire- amarillo).
 2.1.9.1.- Tres para toma mural (02, N20, aire).
 2.1.9.2.- Dos para cilindros (02, N20).
 2.1.10.- Batería de respaldo interna con capacidad mínima de 90 min.
 2.1.11.- Con iluminación para el área de trabajo.

2.2.- Vaporizador o dosificador electrónico de la misma marca que la unidad de anestesia:
 2.2.1.- Suministrar dos vaporizadores (desflurane y isoflurano).
 2.2.2.- Con compensación en flujo, presión y temperatura.
 2.2.3.- Indicador visual del nivel de llenado de agente anestésico.
 2.2.4.- Adaptador para llenado del vaporizador en caso de requerirse.
 2.3.- Suministro de gas fresco:
 2.3.1.- Flujómetro virtual, con representación gráfica y numérica:
 2.3.1.1.- Control de ajuste en pantalla o control manual del flujo total del gas fresco y despliegue de la fracción inspirada de oxígeno FiO2).

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AISYS
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, CATALOGO 9, CATALOGO 10, CATALOGO 11, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2.
HOJA 2 DE 20	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.7.- Montaje en máquina para monitor de signos vitales. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA A, 2-2.**
 2.1.8.- Cuatro ruedas, dos de ellas con freno. **CATALOGO 1 PAGINA 2-2.**
 2.1.9.- Manómetros digitales codificados de acuerdo al código americano de colores (02- verde, N20- azul, aire- amarillo). **CATALOGO 2 PAGINA 2, 10. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-8.**
 2.1.9.1. Tres para toma mural (02, N20, aire). **CATALOGO 1 PAGINA 7.**
 2.1.9.2.- Tres para cilindros (02, N20, aire). **CATALOGO 1 PAGINA 7. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 11-5.**
 2.1.10.- Batería de respaldo interna con capacidad de 90 min. **CATALOGO 1 PAGINA 6.**
 2.1.11.- Con iluminación para el área de trabajo. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-2.**
 2.2.- Vaporizador electrónico de la misma marca que la unidad de anestesia: **CATALOGO 1 PAGINA 4. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 11-31. CATALOGO 12 PAGINA 1. SE ANEXA TRADUCCION SIMPLE.**
 2.2.1.- Suministrar dos vaporizadores (desflurane y isoflurano). **CATALOGO 1 PAGINA 4.**



BIOABAST S.A. DE C.V.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,

para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	9
PARTIDA	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD		
CLAVE SAI	531.053.0356.05.01		
	000000000016313		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

- 2.3.1.2.- Despliegue en pantalla del flujómetro virtual para cada gas medicinal codificado de acuerdo al código americano de colores: O2- verde, aire- amarillo, N2O- azul.
- 2.3.2.- Con mezclador electrónico.
- 2.3.3.- Guarda hipóxica mínima de 25%.
- 2.3.4.- Flush o suministro de oxígeno directo.
- 2.4.- Circuito del paciente:
 - 2.4.1.- Un canister
 - 2.4.1.1.- Con capacidad mínima de 700 ml u 800 g.
 - 2.4.1.2.- Reusable y esterilizable.
 - 2.4.1.3.- Con filtro de polvo, en caso de requerirse.
 - 2.4.1.4.- Con Sistema que permita el cambio de cal sodada durante la ventilación mecánica sin ocasionar fugas.
 - 2.4.2.- Con trampa de agua, recipiente, canister externo o sistema de calentamiento interconstruido.
- 2.4.3.- Salida de gas fresco para circuito auxiliar.
- 2.4.4.- Con sistema de conmutación entre circuito circular y circuito auxiliar (tipo Bain).
- 2.4.5.- Sistema de evacuación de gases activo o pasivo.
- 2.4.6.- Todos los elementos en contacto con el gas espirado por el paciente deberán ser esterilizables y libres de látex.
- 2.4.7.- Válvula ajustable de presión (APL).
- 2.4.8.- Válvula de sobrepresión.

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AISYS
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, CATALOGO 9, CATALOGO 10, CATALOGO 11, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2.

HOJA 3 DE 20

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

- 2.2.2.- Con compensación en flujo, presión y temperatura. **CATALOGO 12 PAGINA 1.**
- 2.2.3.- Indicador visual del nivel de llenado de agente anestésico. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 13-2, 13-3.**
- 2.2.4.- Adaptador para llenado del vaporizador. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 13-10.**
- 2.3.- Suministro de gas fresco:
 - 2.3.1.- Flujómetro virtual, con representación gráfica y numérica: **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-10.**
 - 2.3.1.1.- Control de ajuste en pantalla del flujo total del gas fresco y despliegue de la fracción inspirada de oxígeno FIO2. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-10, 3-11.**
 - 2.3.1.2.- Despliegue en pantalla del flujómetro virtual para cada gas medicinal codificado de acuerdo al código americano de colores: O2- verde, aire- amarillo, N2O- azul. **CATALOGO 2 PAGINA 2, 10.**
 - 2.3.2.- Con mezclador electrónico. **CATALOGO 1 PAGINA 7.**
 - 2.3.3.- Guarda hipóxica de 21%. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 11-10. SEGÚN ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.**
 - 2.3.4.- Suministro de oxígeno directo. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-4.**
- 2.4.- Circuito del paciente:



BIOABAST S.A. DE C.V.

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	9
PARTIDA	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD		
CLAVE SAI	531.053.0356.05.01 00000000016313 NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AISYS CARESCAPE Monitor B650
CATALOGO	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, CATALOGO 9, CATALOGO 10, CATALOGO 11, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2.
HOJA 4 DE 20	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.4.9.- Válvula de conmutación bolsa-ventilador.

2.4.10.- Brazo ajustable para bolsa de ventilación manual.

2.5.- Ventilador microprocesado e interconstruido de la misma marca que la máquina de anestesia.

2.5.1.- Teclado sensible al tacto o de membrana o perilla selectora.

2.5.2.- Despliegue de mensajes v parámetros en español.

2.5.3.- Pantalla:

2.5.3.1.- Tipo LCD, LCD TFT o tecnología superior.

2.5.3.2.- Tamaño mínimo de 12".

2.5.3.3.- Policromática.

2.5.3.4.- Configurable por el usuario.

2.5.3.5.- Despliegue de parámetros en forma numérica.

2.5.3.6.- Despliegue mínimo de tres curvas simultáneas.

2.5.4.- Modos de ventilación

2.5.4.1.- Controlado por volumen.

2.5.4.2.- Controlado por presión.

2.5.4.3.- SIMV (Ventilación Mandataria Intermitente Sincronizada).

2.5.4.4.- Presión Soporte.

2.5.4.5.- Ventilación por presión con volumen garantizado, VCRP o autoflow.

2.5.5.- Controles y ajuste de:

2.5.5.1.- Volumen corriente que cubra como mínimo el rango de 20 a 1400 ml.

2.5.5.2.- Presión límite que cubra como mínimo el rango de 12 a 70 cmH2O.

2.4.1.- Un canister. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-5.**

2.4.1.1.- Con capacidad de 800 g. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 8-4.**

2.4.1.2.- Reusable y esterilizable. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 8-4, 10-5.**

2.4.1.3.- Con filtro de polvo. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 8-7.**

2.4.1.4.- Con Sistema que permite el cambio de cal sodada durante la ventilación mecánica sin ocasionar fugas. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 3-35, 11-5.**

2.4.2.- Con recipiente interconstruido. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 8-4.**

2.4.3.- Salida de gas fresco para circuito auxiliar. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 3-38.**

2.4.4.- Con sistema de conmutación entre circuito circular y circuito auxiliar (tipo Bain). **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-6.**

2.4.5.- Sistema de evacuación de gases pasivo. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 11-12.**

2.4.6.- Todos los elementos en contacto con el gas espirado por el paciente deberán ser esterilizables y libres de látex. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 1-2, 10-5.**

2.4.7.- Válvula ajustable de presión (APL). **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-5.**

2.4.8.- Válvula de sobrepresión. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 11-3.**

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	9
PARTIDA	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD		
CLAVE SAI	531.053.0356.05.01		
	000000000016313		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

- 2.5.5.3.- Presión inspiratoria que cubra como mínimo el rango de 5 a 60 cmH2O.
- 2.5.5.4.- Frecuencia respiratoria que cubra como mínimo el rango de 4 a 80 respiraciones por minuto.
- 2.5.5.5.- PEEP electrónico que cubra como mínimo el rango de 5 a 20 cmH2O.
- 2.5.5.6.- Relación I:E y relación I:E inversa.
- 2.5.5.7.- Pausa inspiratoria.
- 2.5.5.8.- Sensibilidad por flujo o presión.
- 2.5.5.9.- Presión soporte.
- 2.5.6.- Despliegue numérico en pantalla del ventilador o del monitor de signos
- 2.5.6.1.- Fracción inspirada y espirada de oxígeno (FiO2) por tecnología paramagnética.
- 2.5.6.2.- Volumen corriente.
- 2.5.6.3.- Volumen minuto.
- 2.5.6.4.- Presión media.
- 2.5.6.5.- Presión pico.
- 2.5.6.6.- PEEP.
- 2.5.6.7.- Frecuencia respiratoria.
- 2.5.6.8.- Compliance y/o resistencia pulmonar.
- 2.5.6.9.- MAC (concentración alveolar mínima).
- 2.5.6.10.- Presión plateau o meseta.
- 2.5.7.- Despliegue de curvas en pantalla del ventilador o del monitor de signos vitales:
 - 2.5.7.1.- Curva de flujo.
 - 2.5.7.2.- Curva de presión.
 - 2.5.7.3.- Despliegue de lazos: presión I volumen y flujo I volumen, con almacenamiento de referencia de al menos un lazo.

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AISYS
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, CATALOGO 9, CATALOGO 10, CATALOGO 11, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2.

HOJA 5 DE 20

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

- 2.4.9.- Válvula de conmutación bolsa-ventilador. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2.5.**
- 2.4.10.- Brazo ajustable para bolsa de ventilación manual. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-6.**
- 2.5.- Ventilador microprocesado e interconstruido de la misma marca que la máquina de anestesia. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 1-2.**
- 2.5.1.- Teclado de membrana y perilla selectora. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-8.**
- 2.5.2.- Despliegue de mensajes y parámetros en español. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-10.**
- 2.5.3.- Pantalla: **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-10.**
- 2.5.3.1.- Tipo LCD. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 11-8.**
- 2.5.3.2.- Tamaño de 12.1". **CATALOGO 1 PAGINA 4.**
- 2.5.3.3.- Policromática. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 12-6.**
- 2.5.3.4.- Configurable por el usuario. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 12-6.**
- 2.5.3.5.- Despliegue de parámetros en forma numérica. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-10.**

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

**ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	9
PARTIDA	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD		
CLAVE SAI	531.053.0356.05.01 000000000016313		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE			

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AISYS CARESCAPE Monitor B650
CATALOGO	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, CATALOGO 9, CATALOGO 10, CATALOGO 11, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2.

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.5.8.- Sistema de alarmas audibles y visuales priorizadas en tres niveles (despliegue y ajuste en pantalla del ventilador):
 2.5.8.1.- FiO2 (alta y baja).
 2.5.8.2.- Volumen minuto o volumen corriente (alta y baja).
 2.5.8.3.- Presión de vías aéreas (alta y baja).
 2.5.8.4.- Apnea.
 2.5.8.5.- Presión baja de suministro de gas.
 2.5.8.6.- Falla en el suministro eléctrico.
 2.5.8.7.- Falla en medición O2, para tecnología paramagnética.
 2.5.8.8.- Fuga en circuito de paciente.
 2.5.8.9.- Falla en sensor de presión.
 2.5.8.10.- Falla en sensor de flujo.
 2.5.9.- inhabilitación de alarmas para el modo bypass cardiaco.
 2.5.10.- Conmutación a ventilación manual.
 2.5.11.- Compensación de volumen o desacoplo de gas fresco.
 2.5.12.- Indicador de fuente de alimentación, AC o OC.
 2.5.13 Indicadora batería baja.
 2.6.- Sistema de comprobación que verifique el funcionamiento neumático y electrónico de la unidad de anestesia.
 2.7.- Monitor de signos vitales.
 2.7.1.- Monitor modular.
 2.7.2.- Pantalla sensible al tacto, teclado de membrana o perilla selectora.
 2.7.3.- Pantalla policromática con tecnología LCD TFT o tecnología superior de 15" como mínimo.

2.5.3.6.- Despliegue de tres curvas simultáneas. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-11.**
 2.5.4.- Modos de ventilación. **CATALOGO 1 PAGINA 3.**
 2.5.4.1.- Controlado por volumen. **CATALOGO 1 PAGINA 3**
 2.5.4.2.- Controlado por presión. **CATALOGO 1 PAGINA 3.**
 2.5.4.3.- SIMV (Ventilación Mandataria Intermitente Sincronizada). **CATALOGO 1 PAGINA 3.**
 2.5.4.4.- Presión Soporte. **CATALOGO 1 PAGINA 3.**
 2.5.4.5.- Ventilación por presión con volumen garantizado. **CATALOGO 1 PAGINA 3.**
 2.5.5.- Controles y ajuste de: **CATALOGO 1 PAGINA 3.**
 2.5.5.1.- Volumen corriente en rango de 20 a 1500 ml. **CATALOGO 1 PAGINA 3.**
 2.5.5.2.- Presión límite en rango de 12 a 100 cmH20. **CATALOGO 1 PAGINA 3.**
 2.5.5.3.- Presión inspiratoria en rango de 5 a 60 cmH20. **CATALOGO 1 PAGINA 3.**
 2.5.5.4.- Frecuencia respiratoria en rango de 4 a 100 respiraciones por minuto. **CATALOGO 1 PAGINA 3.**
 2.5.5.5.- PEEP electrónico en rango de 4 a 30 cmH20. **CATALOGO 1 PAGINA 3.**

HOJA 6 DE 20

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO,D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail:bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	9
PARTIDA	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD		
CLAVE SAI	531.053.0356.05.01		
	00000000016313		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AISYS
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, CATALOGO 9, CATALOGO 10, CATALOGO 11, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2.

HOJA 7 DE 20

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

- 2.7.4.- Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación.
- 2.7.5.- Despliegue de curvas fisiológicas de al menos 8 curvas simultáneas.
- 2.7.6.- Despliegue de mensajes parámetros en es añal.
- 2.7.7.- Tendencias gráficas y numéricas para todos los parámetros de 24 horas como mínimo.
- 2.7.8.- Batería de respaldo interna con capacidad mínima de 120 min.
- 2.7.9.- Monitoreo de los siguientes parámetros desplegados en el monitor de signos vitales o en el ventilador.
- 2.7.10.- ECG
- 2.7.10.1.- Despliegue numérico de frecuencia cardiaca.
- 2.7.10.2.- Al menos 7 derivaciones seleccionables por el usuario.
- 2.7.10.3.- Despliegue simultáneo de al menos dos curvas a elegir de entre 7 derivaciones de ECG como mínimo.
- 2.7.10.4.- Análisis del segmento ST.
- 2.7.10.5.- Análisis de arritmias.
- 2.7.10.6.- Control de activación de filtros en la señal.
- 2.7.10.7.- Detección de marcapasos.
- 2.7.10.8.- Protección contra descarga de desfibrilador.
- 2.7.11.- CO2
- 2.7.11.1.- Por medio de mainstream, sidestream o microstream.
- 2.7.11.2.- Despliegue de curva y valores numéricos; inspirado y espirado.
- 2.7.12.- SpO2
- 2.7.12.1.- Curva de pletismografía.

- 2.5.5.6.- Relación I:E y relación I:E inversa. **CATALOGO 1 PAGINA 3.**
- 2.5.5.7.- Pausa inspiratoria. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 11-19.**
- 2.5.5.8.- Sensibilidad por flujo. **CATALOGO 1 PAGINA 3.**
- 2.5.5.9.- Presión soporte. **CATALOGO 1 PAGINA 3.**
- 2.5.6.- Despliegue numérico en pantalla del ventilador y del monitor de signos vitales: **MANUAL DE USUARIO. 2 PAG-A. CATALOGO 1 PAG.3**
- 2.5.6.1.- Fracción inspirada y espirada de oxígeno (FiO2) por tecnología paramagnética. **CATALOGO 1 PAGINA 5. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-10, 6-2.**
- 2.5.6.2.- Volumen corriente. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-10.**
- 2.5.6.3.- Volumen minuto. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-10.**
- 2.5.6.4.- Presión media. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-10.**
- 2.5.6.5.- Presión pico. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-10.**
- 2.5.6.6.- PEEP. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-10.**
- 2.5.6.7.- Frecuencia respiratoria. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-10.**
- 2.5.6.8.- Compliance pulmonar. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 3-17.**

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.



BIOABAST S.A. DE C.V.

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

**ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	9
PARTIDA	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD		
CLAVE SAI	531.053.0356.05.01		
	00000000016313		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Dutex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AISYS
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, CATALOGO 9, CATALOGO 10, CATALOGO 11, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2.
HOJA 8 DE 20	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE


2.7.12.2.- Despliegue numérico de saturación de oxígeno.
 2.7.13.- Temperatura en mínimo dos canales.
 2.7.13.1.- Despliegue numérico de ambas temperaturas de manera simultánea.
 2.7.14.- Presión arterial no invasiva
 2.7.14.1.- Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media).
 2.7.14.2.- Ajuste automático de la presión de acuerdo al tipo de paciente seleccionado.
 2.7.14.3.- Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.
 2.7.15.- Respiración
 2.7.15.1.- Curva de respiración.
 2.7.15.2.- Despliegue numérico de frecuencia respiratoria.
 2.7.16.- Presión arterial invasiva
 2.7.16.1.- Cuatro canales de presión invasiva como mínimo.
 2.7.16.2.- Etiquetado del sitio de medición de los transductores.
 2.7.16.3.- Ajuste automático de escalas.
 2.7.17.- Espirómetro
 2.7.17.1.- Curva de flujo.
 2.7.17.2.- Volumen minuto inspirado y/o espirado.
 2.7.17.3.- Volumen corriente inspirado y espirado.
 2.7.17.4.- Despliegue de lazos: presión / volumen y flujo / volumen, con almacenamiento de referencia de al menos un lazo.
 2.7.17.5.- Despliegue numérico de la compliance pulmonar del paciente y/o resistencia de la vía aérea

2.5.6.9.- MAC (concentración alveolar mínima). **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-10.**
 2.5.6.10.- Presión plateau. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 1-10. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 57.**
 2.5.7.- Despliegue de curvas en pantalla del ventilador y del monitor de signos vitales:
 2.5.7.1.- Curva de flujo. **CATALOGO 1 PAGINA 6.**
 2.5.7.2.- Curva de presión. **CATALOGO 1 PAGINA 6.**
 2.5.7.3.- Despliegue de lazos: presión-volumen y flujo-volumen, con almacenamiento de referencia de hasta 6 lazos. **CATALOGO 4 PAGINA 1.**
 2.5.8.- Sistema de alarmas audibles y visuales priorizadas en tres niveles (despliegue y ajuste en pantalla del ventilador): **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 7-2.**
 2.5.8.1.- FiO2 (alta y baja). **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 7-9.**
 2.5.8.2.- Volumen minuto y volumen corriente (alta y baja). **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 7-13.**
 2.5.8.3.- Presión de vías aéreas (alta y baja). **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 7-10, 7-11.**
 2.5.8.4.- Apnea. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 7-5.**

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	9
PARTIDA	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD		
CLAVE SAI	531.053.0356.05.01		
	000000000016313		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

- 2.7.18.1.- Despliegue numérico de 02 inspirado y espirado.
- 2.7.18.2.- Despliegue numérico de N20 inspirado y espirado.
- 2.7.18.- Gases:
- 2.7.18.3.- Identificación automática de agentes anestésicos.
- 2.7.18.4.- Despliegue numérico de la concentración de gas anestésico
- 2.7.18.5.- Despliegue numérico de la concentración alveolar mínima (MAC).
- 2.7.18.6.- Detección automática de agentes anestésicos simultáneos y despliegue numérico de la concentración más alta.
- 2.7.19.- Profundidad hipnótica:
- 2.7.19.1.- Despliegue numérico.
- 2.7.19.2.- Curva de EEG.
- 2.7.20.- Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los siguientes parámetros
- 2.7.20.1.- Frecuencia cardíaca.
- 2.7.20.2.- CO2
- 2.7.20.3.- Saturación de oxígeno.
- 2.7.20.4.- Temperatura.
- 2.7.20.5.- Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica y media).
- 2.7.20.6.- Frecuencia respiratoria.
- 2.7.20.7.- Presión arterial invasiva.
- 2.7.20.8.- Gases anestésicos.
- 2.7.20.9.- Profundidad hipnótica.

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AISYS
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, CATALOGO 9, CATALOGO 10, CATALOGO 11, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2.
HOJA 9 DE 20	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

- 2.5.8.5.- Presión baja de suministro de gas. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 7-11.**
- 2.5.8.6.- Falla en el suministro eléctrico. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 7-5.**
- 2.5.8.7.- Falla en medición O2, para tecnología paramagnética. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 6-2, 7-5, 7-12.**
- 2.5.8.8.- Fuga en circuito de paciente. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 7-9.**
- 2.5.8.9.- Falla en sensor de presión. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 7-9.**
- 2.5.8.10.- Falla en sensor de flujo. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 7-5, 7-6.**
- 2.5.9.- Inhabilitación de alarmas para el modo bypass cardiaco. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 3-14.**
- 2.5.10.- Conmutación a ventilación manual. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-5.**
- 2.5.11.- Compensación de volumen. **CATALOGO 1 PAGINA 1.**
- 2.5.12.- Indicador de fuente de alimentación, AC o DC. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-2.**
- 2.5.13 Indicadora batería baja. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-10.**
- 2.6.- Sistema de comprobación que verifique el funcionamiento neumático y electrónico de la unidad de anestesia. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 3-4, 5-5, 5-6, 5.7.**

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail:bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

**ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	9
PARTIDA	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD		
CLAVE SAI	531.053.0356.05.01 000000000016313 NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE			

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AISYS CARESCAPE Monitor B650
CATALOGO	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, CATALOGO 9, CATALOGO 10, CATALOGO 11, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2.
HOJA 10 DE 20	

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.7.21.- Inhabilitación de alarmas para el modo bypass cardiaco.
2.7.22.- Alarma de a nea.
2.7.23.- Alarma de arritmia.
2.7.24.- Con silenciador de alarmas.
2.8.- Relajación muscular:
2.8.1.- Despliegue numérico.
2.8.2.- Modos de estimulación: tren de cuatro, tetánico y estímulo único o simple.
2.9 Gasto cardiaco pantalla por termodilución:
2.9.1 Despliegue en del monitor de signos vitales. Termistor.
2.10.- Funcionamiento de la unidad de anestesia con modo bypass cardiaco.
2.11.- Capacidad a futuro de interfaz con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 de acuerdo con la tecnología del fabricante.
2.12.- Una manguera de suministro por cada gas de acuerdo al código americano de colores: (02-verde, N20-azul, aire- amarillo) con conector para toma mural de acuerdo a la instalación de cada unidad médica. Con regulador de presión externo para O2 aire, como mínimo. Y trampa de agua para aire.
3. ACCESORIOS: PARA ADULTO I PEDIÁTRICO:
3.1 Dos circuitos de paciente reusable, esterilizable y libre de látex con tubos corrugados de al menos 1.2 m de longitud, pieza en "Y" codo. Un circuito de paciente neonatal reusable.
3.2 Un circuito de reinhalación parcial, tipo Bain, semicerrado o equivalente.

2.7.- Monitor de signos vitales. **MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA A.**
2.7.1.- Monitor modular. **MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA A. CATALOGO 3 PAGINA 1.**
2.7.2.- Pantalla sensible al tacto y perilla selectora. **CATALOGO 3 PAGINA 2.**
2.7.3.- Pantalla policromática con tecnología LCD TFT de 15". **CATALOGO 3 PAGINA 2.**
2.7.4.- Salida analógica de ECG y sincronía para desfibrilación. **MANUAL DE USUARIO 2 PAG 21, 165.**
2.7.5.-Despliegue de curvas fisiológicas de 8 curvas simultáneas. **CATALOGO 3 PAG 2.**
2.7.6.- Despliegue de mensajes y parámetros en español. **MANUAL DE USUARIO 2 PAG 105.**
2.7.7.- Tendencias gráficas y numéricas para todos los parámetros de 24 horas. **MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 89, 91.**
2.7.8. Batería de respaldo interna con capacidad de 120 min. **CATALOGO 3 PAG 4.**
2.7.9.- Monitoreo de los siguientes parámetros desplegados en el monitor de signos vitales y en el ventilador: **MANUAL DE USUARIO 2 PAG A, CATALOGO 1 PAG 3.**
2.7.10.- ECG. **CATALOGO 5 PAGINA 2.**
2.7.10.1.- Despliegue numérico de frecuencia cardiaca. **CATALOGO 5 PAG 2.**

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail:bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,

para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	9
PARTIDA	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD		
CLAVE SAI	531.053.0356.05.01 00000000016313 NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AISYS
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650 CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, CATALOGO 9, CATALOGO 10, CATALOGO 11, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2.

HOJA 11 DE 20

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

- 3.3 Mascarillas transparente reusable, esterilizable y libre de látex tamaños: adulto, pediátrico y pequeña una de cada una.
- 3.4 Bolsa para ventilación reusable, esterilizable y libre de látex: una de 1 l, una de 2 l y una de 3 l; +/- 10%. Una de 500 ml para pacientes neonatales.
- 3.5 Un cable troncal, un sensor tipo dedal y un sensor multisitio, ambos reusables, para oximetría de pulso.
- 3.6 Un sensor reusable de temperatura (de piel o de superficie) y un sensor de temperatura esofágico o rectal.
- 3.7 Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto, uno adulto obeso y uno pediátrico; una manguera con conector para los brazaletes. **SEGÚN PRECISION No. 22 DE LA CONVOCANTE.**
- 3.8 Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos de cinco puntas. Para paciente neonatal un cable troncal y un cable de paciente para ECG de tres puntas.
- 3.9 Para CO2 por técnica mainstream: sensor reusable y cable, adaptador de vías aéreas reusable.
- 3.10 Para CO2 por técnica sidestream: 10 trampas de agua (en caso de requerirse), 20 líneas de muestra adaptadores endotraqueales.
- 3.11 Para CO2 por técnica microstream: 20 líneas de muestra adaptadores endotraqueales.
- 3.12 Para medición de la presión invasiva incluir al menos: 2 cables troncales ara transductor.

- 2.7.10.2.- Hasta 12 derivaciones seleccionables por el usuario. **CATALOGO 5 PAGINA 2.**
- 2.7.10.3.- Despliegue simultáneo de tres curvas a elegir de entre 12 derivaciones de ECG. **MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 168. CATALOGO 5 PAGINA 2.**
- 2.7.10.4.- Análisis del segmento ST en 12 derivaciones. **CATALOGO 5 PAGINA 2.**
- 2.7.10.5.- Análisis de arritmias. **CATALOGO 5 PAGINA 1.**
- 2.7.10.6.- Control de activación de filtros en la señal. **CATALOGO 5 PAGINA 2.**
- 2.7.10.7.- Detección de marcapasos. **CATALOGO 5 PAGINA 2.**
- 2.7.10.8.- Protección contra descarga de desfibrilador. **CATALOGO 5 PAGINA 2.**
- 2.7.11.- CO2. **CATALOGO 4 PAGINA 2.**
- 2.7.11.1.- Por medio de sidestream. **MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 250.**
- 2.7.11.2.- Despliegue de curva y valores numéricos; inspirado y espirado. **CATALOGO 4 PAGINA 2.**
- 2.7.12.- SpO2. **CATALOGO 5 PAGINA 3.**
- 2.7.12.1.- Curva de pletismografía. **CATALOGO 5 PAGINA 3.**
- 2.7.12.2.- Despliegue numérico de saturación de oxígeno. **CATALOGO 5 PAGINA 3.**
- 2.7.13.- Temperatura en mínimo dos canales. **CATALOGO 5 PAGINA 3.**

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	9
PARTIDA	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD		
CLAVE SAI	531.053.0356.05.01 000000000016313		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Dutex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AISYS
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, CATALOGO 9, CATALOGO 10, CATALOGO 11, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2.

HOJA 12 DE 20

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

3.13 Para monitorización de la profundidad hipnótica: cable troncal y sensor para profundidad hipnótica para uso pediátrico adulto.

3.14 Para monitorización de gasto cardiaco, cable de conexión.

3.15 Para relajación muscular: Sensor para adulto y pediátrico. **SEGÚN PRECISION No. 22 DE LA CONVOCANTE.**

3.16 Sensor de flujo reusable caja con 3 piezas. **SEGÚN PRECISION No. 22 DE LA CONVOCANTE.**

3.17 Se elimina. **SEGÚN PRECISION No. 22 DE LA CONVOCANTE.**

4. CONSUMIBLES:

4.1 Electrodo para ECG adulto I pediátrico y neonatales, 100 piezas de cada uno.

4.2 Filtro para sistema de evacuación de gases uno

4.3. Dos kits de transductor desechable por cada canal, (10 kits).

4.4 Veinte brazaletes desechables para medición de la presión no invasiva neonatal en dos medidas diferentes, una manguera con conector para los brazaletes.

4.5 Caja sensores para BIS o entropía caja con 25 piezas. **SEGÚN PRECISION No. 22 DE LA CONVOCANTE.**

4.6 Electrodo para estimulación neuromuscular. (50 piezas). **SEGÚN PRECISION No. 22 DE LA CONVOCANTE.**

5. REFACCIONES: 5.1 No requiere.

6. INSTALACIÓN:

6.1 Eléctrica: 120 V +/- 10%, 60Hz.

6.2 Neumática: Aire, oxígeno y N2O.

2.7.13.1.- Despliegue numérico de ambas temperaturas de manera simultánea. **CATALOGO 5 PAGINA 3.**

2.7.14.- Presión arterial no invasiva. **CATALOGO 5 PAGINA 3.**

2.7.14.1.- Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). **CATALOGO 5 PAGINA 3. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 211**

2.7.14.2.- Ajuste automático de la presión de acuerdo al tipo de paciente seleccionado. **CATALOGO 5 PAGINA 3.**

2.7.14.3.- Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. **CATALOGO 5 PAGINA 3.**

2.7.15.- Respiración. **CATALOGO 5 PAGINA 2.**

2.7.15.1.- Curva de respiración. **MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 196.**

2.7.15.2.- Despliegue numérico de frecuencia respiratoria. **CATALOGO 5 PAGINA 2.**

2.7.16.- Presión arterial invasiva. **CATALOGO 5 PAGINA 2.**

2.7.16.1.- Cuatro canales de presión invasiva. **MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 219.**

2.7.16.2.- Etiquetado del sitio de medición de los transductores. **MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 222.**

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	9
PARTIDA	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD		
CLAVE SAI	531.053.0356.05.01		
	00000000016313		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AISYS
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, CATALOGO 9, CATALOGO 10, CATALOGO 11, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2.
HOJA 13 DE 20	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

7. MANTENIMIENTO:
 7.1 Programa calendarizado o calendario de servicios, que incluya la descripción de las acciones a efectuar.
 8. **NORMAS CERTIFICADOS:** -
 8.1 Para producto de origen nacional: certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS e ISO 13485.
 8.2 Para producto extranjero: que cumpla con ISO 13485 al uno de los siguientes: FDA, CE o JIS.

2.7.16.3.- Ajuste automático de escalas. **MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 222.**
 2.7.17.- Espirometría. **CATALOGO 4 PAGINA 3.**
 2.7.17.1.- Curva de flujo y presión. **CATALOGO 4 PAGINA 3**
 2.7.17.2.- Volumen minuto inspirado y espirado. **CATALOGO 4 PAGINA 3. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 264.**
 2.7.17.3.- Volumen corriente inspirado y espirado. **CATALOGO 4 PAGINA 3. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 264.**
 2.7.17.4.- Despliegue de lazos: presión / volumen y flujo / volumen, con almacenamiento de referencia de hasta 6 lazos. **CATALOGO 4 PAGINA 1, 3.**
 2.7.17.5.- Despliegue numérico de la compliance pulmonar del paciente y resistencia de la vía aérea. **CATALOGO 4 PAGINA 1, 3.**
 2.7.18.- Gases: **CATALOGO 4 PAGINA 1.**
 2.7.18.1.- Despliegue numérico de O2 inspirado y espirado. **CATALOGO 4 PAGINA 2.**
 2.7.18.2.- Despliegue numérico de N2O inspirado y espirado. **CATALOGO 4 PAGINA 1.**
 2.7.18.3.- Identificación automática de agentes anestésicos. **CATALOGO 4 PAGINA 1. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 253.**

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

Licitación Pública Internacional
 Consolidada Bajo la Cobertura de
 Los Tratados de Libre Comercio
 No. LA-019GYR040-T23-2015,
 para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	9
PARTIDA	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD		
CLAVE SAI	531.053.0356.05.01		
	00000000016313		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AISYS
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, CATALOGO 9, CATALOGO 10, CATALOGO 11, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2.
HOJA 14 DE 20	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

--

<p>2.7.18.4.- Despliegue numérico de la concentración de gas anestésico. CATALOGO 4 PAGINA 1.</p> <p>2.7.18.5.- Despliegue numérico de la concentración alveolar mínima (MAC). CATALOGO 4 PAGINA 1.</p> <p>2.7.18.6.- Detección automática de agentes anestésicos simultáneos y despliegue numérico de la concentración más alta. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 257.</p> <p>2.7.19.- Profundidad hipnótica: CATALOGO 6 PAGINA 1.</p> <p>2.7.19.1.- Despliegue numérico. CATALOGO 6 PAGINA 2.</p> <p>2.7.19.2.- Curva de EEG. CATALOGO 6 PAGINA 1.</p> <p>2.7.20.- Alarmas audibles y visibles, priorizadas en tres niveles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los siguientes parámetros. CATALOGO 3 PAGINA 3. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 45.</p> <p>2.7.20.1.- Frecuencia cardíaca. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 173.</p> <p>2.7.20.2.- CO2. CATALOGO 4 PAGINA 2.</p> <p>2.7.20.3.- Saturación de oxígeno. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 208.</p> <p>2.7.20.4.- Temperatura. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 233.</p>

f



BIOABAST S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.


PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	9
PARTIDA	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD		
CLAVE SAI	531.053.0356.05.01 000000000016313		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Dutex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AISYS
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, CATALOGO 9, CATALOGO 10, CATALOGO 11, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2.

HOJA 15 DE 20

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

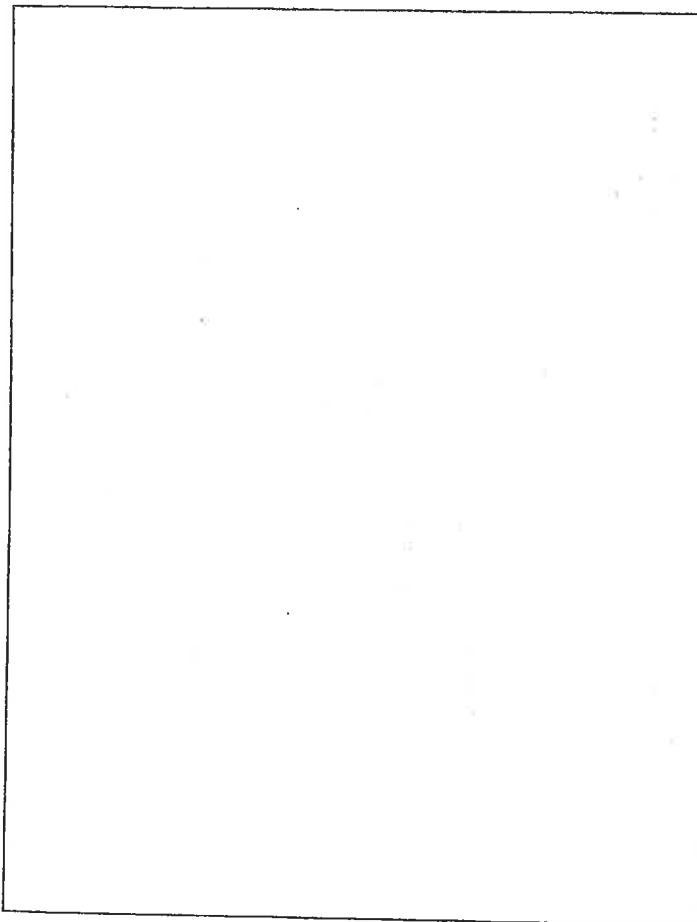

- 2.7.20.5.- Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica y media). **MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 216.**
- 2.7.20.6.- Frecuencia respiratoria. **MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 200.**
- 2.7.20.7.- Presión arterial invasiva. **MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 224.**
- 2.7.20.8.- Gases anestésicos. **CATALOGO 4 PAGINA 2.**
- 2.7.20.9.- Profundidad hipnótica. **MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 273.**
- 2.7.21.- Inhabilitación de alarmas para el modo bypass cardiaco. **MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 3-14.**
- 2.7.22.- Alarma de apnea. **CATALOGO 4 PAGINA 2.**
- 2.7.23.- Alarma de arritmia. **MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 182.**
- 2.7.24.- Con silenciador de alarmas. **CATALOGO 3 PAGINA 3.**
- 2.8.- Relajación muscular: **CATALOGO 7 PAGINA 1.**
- 2.8.1.- Despliegue numérico. **CATALOGO 7 PAGINA 2.**
- 2.8.2.- Modos de estimulación: tren de cuatro estímulos (TOF), contracción aislada (ST), estimulación en doble ráfaga (DBS) y estimulación tetánica. **CATALOGO 7 PAGINA 1.**
- 2.9.- Gasto cardiaco pantalla por termodilución: **CATALOGO 8 PAGINA 1.**

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

**ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	9
PARTIDA	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD		
CLAVE SAI	531.053.0356.05.01		
	00000000016313		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AISYS
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, CATALOGO 9, CATALOGO 10, CATALOGO 11, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2.
HOJA 16 DE 20	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

--

<p>2.9.1 Despliegue en pantalla del monitor de signos vitales. Termistor. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 10, 236.</p> <p>2.10.- Funcionamiento de la unidad de anestesia con modo bypass cardiaco. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 3-14.</p> <p>2.11.- Capacidad a futuro de interfaz con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 de acuerdo con la tecnología del fabricante. CATALOGO 3 PAGINA 1. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 20, 32.</p> <p>2.12.- Una manguera de suministro por cada gas de acuerdo al código americano de colores: (O2-verde, N20-azul, aire-amarillo) con conector para toma mural de acuerdo a la instalación de cada unidad médica. Con regulador de presión externo para O2 aire. Y trampa de agua para aire. CATALOGO 9 PAGINA 3, CATALOGO 11 PAGINA 2, 4.</p> <p>3. ACCESORIOS: PARA ADULTO Y PEDIÁTRICO:</p> <p>3.1 Dos circuitos de paciente reusable, esterilizable y libre de látex con tubos corrugados de 1.2 m de longitud, pieza en "Y" codo. Un circuito de paciente neonatal reusable. CATALOGO 9 PAG. 2. CATALOGO 11 PAG. 3.</p> <p>3.2 Un circuito de reinhalación parcial, tipo Bain. CATALOGO 11 PAG. 2.</p>
--

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	9
PARTIDA	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD		
CLAVE SAI	531.053.0356.05.01		
	00000000016313		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AISYS
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, CATALOGO 9, CATALOGO 10, CATALOGO 11, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2.

HOJA 17 DE 20

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

--

3.3 Mascarillas transparente reusable, esterilizable y libre de látex tamaños: adulto, pediátrico y pequeña una de cada una. **CATALOGO 11 PAG. 3.**

3.4 Bolsa para ventilación reusable, esterilizable y libre de látex: una de 1 l, una de 2 l y una de 3 l; +/- 10%. Una de 500 ml para pacientes neonatales. **CATALOGO 11 PAG. 3.**

3.5 Un cable troncal, un sensor tipo dedal y un sensor multisitio, ambos reusables, para oximetría de pulso. **CATALOGO 10 PAG.6.**

3.6 Un sensor reusable de temperatura piel y un sensor de temperatura esofágico. **CATALOGO 10 PAG. 8.**

3.7 Brazalete reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto, uno adulto obeso y uno pediátrico; una manguera con conector para los brazaletes. **SEGÚN PRECISION No. 22 DE LA CONVOCANTE. CATALOGO 10 PAG. 2, 7.**

3.8 Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de cinco puntas. Para paciente neonatal un cable troncal y un cable de paciente para ECG de tres puntas. **CATALOGO 10 PAG. 4.**

3.9 Para CO2 por técnica mainstream: sensor reusable y cable, adaptador de vías aéreas reusable. **NO APLICA, NO SE OFERTA ESTA TECNOLOGIA.**

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO,D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail:bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,

para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

**ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	9
PARTIDA	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD		
CLAVE SAI	531.053.0356.05.01 00000000016313 NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	ASYS CARESCAPE Mpnitor B650
CATALOGO	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, CATALOGO 9, CATALOGO 10, CATALOGO 11, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2.
HOJA 18 DE 20	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

--

<p>3.10 Para CO2 por técnica sidestream: 10 trampas de agua, 20 líneas de muestra y 20 adaptadores endotraqueales. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 250.</p> <p>3.11 Para CO2 por técnica microstream: 20 líneas de muestra adaptadores endotraqueales. NO APLICA, NO SE OFERTA ESTA TECNOLOGIA.</p> <p>3.12 Para medición de la presión invasiva: 2 cables troncales para transductor. CATALOGO 10 PAG. 5.</p> <p>3.13 Para monitorización de la profundidad hipnótica: cable troncal y sensor para profundidad hipnótica para uso pediátrico adulto. CATALOGO 10 PAG. 9.</p> <p>3.14 Para monitorización de gasto cardiaco, cable de conexión. CATALOGO 10 PAG. 7.</p> <p>3.15 Para relajación muscular: Sensor para adulto y pediátrico. SEGÚN PRECISION No. 22 DE LA CONVOCANTE. CATALOGO 7 PAG. 1.</p> <p>3.16 Sensor de flujo reusable caja con 3 piezas. SEGÚN PRECISION No. 22 DE LA CONVOCANTE. CATALOGO 11 PAG. 2.</p> <p>3.17 Se elimina. SEGÚN PRECISION No. 22 DE LA CONVOCANTE.</p> <p>4. CONSUMIBLES:</p> <p>4.1 Electrodo para ECG adulto y pediátrico y neonatales, 100 piezas de cada uno. CATALOGO 10 PAG. 9.</p>
--

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail:bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	9
PARTIDA	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD		
CLAVE SAI	531.053.0356.05.01		
	00000000016313		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AISYS
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, CATALOGO 9, CATALOGO 10, CATALOGO 11, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2.

HOJA 19 DE 20

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

--

4.2 Filtro para sistema de evacuación de gases uno. **SEGUN JUNTA DE ACTA DE ACLARACIONES, NO SE OFERTA.**

4.3. kits de transductor desechable por cada canal, (10 kits). **CATALOGO 10 PAG. 5.**

4.4 Veinte brazaletes desechables para medición de la presión no invasiva neonatal en dos medidas diferentes, una manguera con conector para los brazaletes. **CATALOGO 10 PAG. 3, 7.**

4.5 Caja sensores para entropía caja con 25 piezas. **SEGUN PRECISION No. 22 DE LA CONVOCANTE. CATALOGO 10 PAG. 9.**

4.6 Electrodo para estimulación neuromuscular. (50 piezas). **SEGUN PRECISION No. 22 DE LA CONVOCANTE. CATALOGO 10 PAG. 9.**

5. REFACCIONES:

5.1 No requiere.

6. INSTALACIÓN

6.1 Eléctrica: 120 V +/- 10%, 60Hz. **CATALOGO 1 PAGINA 6.**

6.2 Neumática: Aire, oxígeno y N2O. **CATALOGO 1 PAGINA 7.**

7. MANTENIMIENTO: **SE ANEXA CALENDARIO A PROPUESTA TECNICA.**

7.1 Programa calendarizado, que incluye la descripción de las acciones a efectuar. **SE ANEXA CALENDARIO A PROPUESTA TECNICA.**



BIOABAST S.A. DE C.V.

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015


LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	9
PARTIDA	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD		
CLAVE SAI	531.053.0356.05.01 000000000016313		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AISYS CARESCAPE Monitor B650
CATALOGO	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, CATALOGO 9, CATALOGO 10, CATALOGO 11, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2.
HOJA 20 DE 20	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

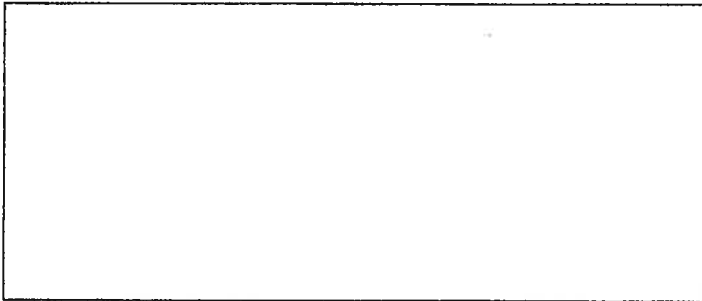

8. NORMAS CERTIFICADOS: - SE ANEXAN PROPUESTA TECNICA.

8.1 Para producto de origen nacional: certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS e ISO 13485. **NO APLICA.**

8.2 Para producto extranjero: cumple con ISO 13485, FDA, Registro Sanitario. **SE ANEXAN PROPUESTA TECNICA.**

México, D.F. a 10 de Agosto de 2015.
Protesto lo necesario


Marycarmen Silva Herrera
Representante Legal



BIOABAST S.A. DE C.V.

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

R040-T23-2015

ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)


PROPOSICIÓN ECONÓMICA

LICITACIÓN	LA-019GYR040-T23-2015	FECHA	10 DE AGOSTO DE 2015
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	BIOABAST, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	Camino Real a Xochitepec No.108, Col. La Noria, C.P. 16030, Xochimilco, D.F.		
R.F.C.	BIO-090619-UG7		
TELÉFONO Y FAX	56750914, 44444755		
CORREO ELECTRÓNICO	marycarmen.silva@bioabast.com; efren.perez@bioabast.com;		

No.	PREI	SAL	PROCEDENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO MÁXIMO DE REFERENCIA	PORCENTAJE DE DESCUENTO %	PRECIO UNITARIO FINAL	IMPORTE TOTAL
Partida No. 27	16313	531.053.0356.05.01	Estados Unidos de América / Finlandia	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD	9	\$ 894,051.27	17.335	\$ 739,067.48	\$ 6,651,607.32
SUBTOTAL									\$ 6,651,607.32
IVA									\$ 1,064,257.17
TOTAL									\$ 7,715,864.49

TOTAL EN LETRA: SIETE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 49/100
LOS PRECIOS Y PORCENTAJES DE DESCUENTO OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

Protesto lo necesario



 Marycarmen Silva Herrera
 Representante Legal

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.P. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com

SIN TEXTO

2



BIOABAST S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

México, D.F. a 10 de agosto de 2015.

PARTIDA 27: UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD.

P R E S E N T E

El suscrito Marycarmen Silva Herrera, en mi carácter de representante legal de la empresa BIOABAST, S.A. de C.V., manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

14.1.3. Mantenimiento Correctivo y/o Preventivo.

El proveedor proporcionará durante la vigencia de la garantía de los bienes, los servicios de mantenimiento preventivo, así como el correctivo con refacciones nuevas y originales, conforme al programa de mantenimiento preventivo indicado en el manual del fabricante, debiendo incluir la sustitución de las piezas y/o partes a verificar y su cambio, conforme a lo establecido en el manual de servicio de los bienes que le sean adjudicados, sin costo adicional para el(a) Instituto/Secretaría, de manera tal, que permitan su uso permanente y continuo, para lo cual deberá entregar un Programa Calendarizado o el Calendario de servicios, que incluya la descripción de las acciones a efectuarse durante el servicio, el cual deberá proporcionarse por lo menos dos veces al año.

El programa calendarizado de mantenimiento preventivo de los equipos ofertados bajo esta partida será realizado cada 6 meses durante el periodo de garantía de los equipos (48 meses) y corresponderá al siguiente listado (dependiendo de la fecha de instalación) y de acuerdo a lo siguiente:

Año 2015	Año 2016		Año 2017		Año 2018		Año 2019
Diciembre	Junio	Diciembre	Junio	Diciembre	Junio	Diciembre	Junio
X	X	X	X	X	X	X	X

Asimismo, anexamos el detalle de los servicios que requiere el equipo ofertado bajo esta partida, y que corresponde a la siguiente rutina:

Procedimiento de mantenimiento preventivo programado

Equipo: Maquina de anestesia

Fabricante: GE

Modelo: Aisys

El presente procedimiento está basado en:

Aisys Anesthesia Machine Technical Reference Manual sección 3 Checkout procedure

OBJETIVO:

REVISIÓN DE CALIBRACIÓN

SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES INCLUIDOS EN PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

VERIFICACIÓN OPERACIONAL DEL SISTEMA

REQUISITAR DOCUMENTACIÓN DE CONTROL.

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.P. 16030
TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015
LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.



BIOABAST S.A. DE C.V.

*Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico*

Equipo necesario:

- RT 200 O EQUIPO SEMEJANTE
- OXÍMETRO
- PULMÓN DE PRUEBA CON RESISTENCIA Y DISTENSIBILIDAD AJUSTABLE
- HERRAMIENTA GENERAL

Documentos relacionados:

Manual de operación
Manual de servicio
Ordenes de servicio
Bitácora de servicio
Formato de PMS
Etiquetas

PROCEDIMIENTO

VERIFICACION DEL ESTADO EXTERIOR DEL EQUIPO

1. Revisar que el equipo no muestre golpes así como indicios de líquido derramado.
2. Retirar las cubiertas posteriores y verificar el estado de la tubería interior del sistema neumático.
3. Verificar que las mangueras de suministro de gases se encuentren en buen estado.
4. Revisar las conexiones del sistema de evacuación
5. Revisar el estado físico del teclado de membrana.
6. Revisar el estado físico del cable de línea y clavija.
7. Revisar el buen estado del circuito de paciente
8. Revisar el buen estado y funcionamiento de las perillas de suministro de gases.
9. Revisar el buen estado y funcionamiento de la perilla Comwell del Ventilador.
10. Verificar el funcionamiento del sistema Hipoxico.
11. Verificar el buen estado de los vaporizadores.
12. Verificar el buen estado de los cajones.
13. Verificar el buen estado de las ruedas.
14. Verificar el funcionamiento del freno del equipo.
15. Revisar el buen estado del fuelle y acrílico.
16. Revisar el buen estado del circuito absorbedor.

SISTEMA "TODAS LAS PRUEBAS"

En el menú de Checkout seleccione "todas las pruebas " y siga las instrucciones para la prueba de fuga de baja presión , vent check y quick check.

PRUEBA DE FUGA DE BAJA PRESION.

1. Verifique que todos los recipientes de anestésico estén cerrados
2. Coloque el ACGO a ABS
3. Ponga el dispositivo de prueba de fugas a la salida del ACGO
4. Colapse el bulbo
5. El budo no se debe inflar por más de 30 segundos
6. Realice la prueba con cada vaporizador

PRUEBA RAPIDA

1. Ocluya la salida de paciente
2. Coloque el selector de bolsa/ventilador a bolsa
3. Coloque el selector ABCGO a ABS

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.P. 16030
TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail:bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

*Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico*

4. Ajuste la válvula APL a 50
5. Seleccione start

VERIFICACION DEL VENTILADOR

1. Seleccione ventilador con el selector bolsa/vent
2. Abra la y de paciente
3. Coloque el selector AGCO a ABS
4. Presione start
5. Siga las instrucciones descritas en la pantalla
6. Verifique que el fuelle se colapse
7. Ocluya la y del paciente
8. Seleccione continúe

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

VERIFICACION DEL O2 DEL CIRCUITO

1. Desconecte la y del paciente
2. Seleccione vent
3. Selección ABS
4. La pantalla desplegara el O2
5. Termine cuando la lectura sea estable

CONTROL DE FLUJO, ALARMA DE SUMINISTRO DE OXIGENO Y FLUSH

1. Conecte el suministro de gases
2. Cierre completamente las válvulas de flujo de todos los gases
3. Ponga el selector acgo a abs
4. Encienda el sistema
5. Verifique que el monitor de oxígeno indica 21 % y 100 % en presencia de oxígeno puro
6. En caso necesario calibre el sensor de oxígeno
7. Verifique el flujo mínimo de oxígeno de 175 1 225 ml/min
8. Verifique que los flotadores corren libremente a través de toda la escala
9. Cierre todas las válvulas
10. Abra paulatinamente la válvula de óxido nitroso y verifique que la concentración de oxígeno está en el rango según la tabla siguiente:


ALARMA DE SUMINISTRO DE OXIGENO

1. Coloque todas las válvulas de flujo a 3 litros
2. Desconecte el suministro de oxígeno
3. Asegúrese de que la alarma suena, el suministro de óxido nitroso se interrumpe,
4. Cierre las válvulas y reconecte el oxígeno.

PRUEBA DE FLUSH

1. Ponga el selector bolsa / vent en la posición de bolsa
2. Ponga el sistema en stby
3. Coloque el circuito de paciente y cierre el puerto del paciente
4. Coloque el ACGO a ABS

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.P. 16030
TEL.F.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail:bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

*Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico*

5. Asegúrese de que el fuelle está completamente colapsado.
6. Mida el tiempo que le toma al fuelle llenarse cuando se presión a el botón de flush
7. Repita la medición dos veces el tiempo debe ser de 1.8 a 2.3 segundos.

VAPORIZADORES BACK PRESSURE

1. Coloque el sistema de evacuación
2. Ponga el selector ACGO a ABS
3. Ponga el selector Bolsa/ vent. a bolsa
4. Ajuste la válvula APL al mínimo
5. Encienda el interruptor
6. Ponga el flujo de oxígeno a 6 lpm
7. Ajuste la concentración del vaporizador a 1 % el flujo no debe decrementar en más de 1 lpm
8. Pruebe todos los vaporizadores
9. Ponga el sistema a STBY

VERIFICACION ELECTRICA

1. Conecte el suministro de energía
2. Encienda el equipo
3. Desconecte el suministro
4. Asegúrese de que el equipo funciona y un mensaje aparece en la pantalla indicando su operación a Batería
5. Conecte un dispositivo para pruebas de seguridad eléctrica y verifique que la corriente de fuga sea menor a 300 Micro amperes
6. Verifique que la resistencia del cable de tierra es de 0.2 ohm.

LLENE LA DOCUMENTACION DE CONTROL Y REGRESE EL EQUIPO A FUNCIONAMIENTO

Procedimiento de Mantenimiento Preventivo Programado

EQUIPO: MONITOR
FABRICANTE: GE
MODELO: B650

EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ESTA BASADO EN:

CARESCAPE B650 /B20 USERS REFERENCE MANUAL PART I MAINTENANCE AND CLEANING Y EN CARESCAPE B650/B20 TECHNICAL REFERENCE CAPÍTULO 3 PLANNED MAINTENANCE

OBJETIVO:

- REVISIÓN DE CALIBRACIÓN
- SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES INCLUIDOS EN PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO
- VERIFICACIÓN OPERACIONAL DEL SISTEMA
- REQUISITAR DOCUMENTACIÓN DE CONTROL.

EQUIPO NECESARIO:

SIMULADOR DE PACIENTE

HERRAMIENTA GENERAL

EQUIPO DE MEDICIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO,D.F. C.P. 16030
TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail:bioabast.clients@gmail.com

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015
LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.



BIOABAST S.A. DE C.V.

*Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico*

MEDIDOR DE PRESIÓN CON TRANSDUCTOR DE 2 BARES
KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAT. 8001760
ACCESORIOS DE ECG, SENSOR DE SpO2, BRAZALETE ADULTO, BRAZALETE INFANTIL MANGUERA INFANTIL, MANGUERA ADULTO, LINEA DE MUESTREO DE 3M, D-LITE
MEDIDOR DE FLUJO.
SILICÓN COMPATIBLE CON O2.
GAS DE CALIBRACIÓN 755583
JERINGA DE ESPIROMETRIA
REGULADOR PARA GAS DE CALIBRACIÓN

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS:

MANUAL DE OPERACIÓN
MANUAL DE SERVICIO
ORDENES DE SERVICIO
BITÁCORA DE SERVICIO
FORMATO DE PMS
ETIQUETAS

PROCEDIMIENTO

- 1 PRUEBAS GENERALES
 - 1.1 REVISE QUE EL MONITOR NO TENGA DEFECTOS VISUALES, COMO GRIETAS O PARTES SUeltas
 - 1.2. REVISE QUE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ CONECTADO A UNA TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y AL MONITOR.
 - 1.3 REVISE QUE LA TRAMPA DE AGUA (D-FEND) ESTÁ VACÍA Y COLOCADA CORRECTAMENTE EN SU LUGAR
 - 1.4 REVISE QUE LA LÍNEA DE MUESTREO ESTÁ CONECTADA AL MONITOR
 - 1.5 REVISE QUE LOS CABLES DE CONEXIÓN DE PACIENTE ESTÁN COLOCADOS A LOS CONECTORES DE ENTRADA DEL MONITOR DE TAL FORMA QUE LOS CÓDIGOS DE COLORES COINCIDAN
 - 1.6 REVISE QUE LAS TENDENCIAS DEL PACIENTE ANTERIOR SE BORRAN.
 - 1.7 REVISE QUE LOS LÍMITES DE ALARMA SON ADECUADOS PARA EL PACIENTE

INSPECCIÓN FUNCIONAL

1. CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN Y VERIFIQUE QUE EL INDICADOR DE BATERÍA ESTA PARPADANDO
2. ENCIENDA EL MONITOR Y VERIFIQUE QUE INICIALIZA:
 - LOS INDICADORES DE ALARMAS SE ENCIENDEN Y APAGAN
 - SE ESCUCHA EL SONIDO DE INICIO DE LA BOCINA
 - SE DESPLIEGA LA PANTALLA NORMA Y NO APARECE NINGÚN MENSAJE DE ERROR
 - SE DESPLIEGA LA FECHA Y HORA
 - EL SÍMBOLO DE "BATERÍA CARGANDO" APARECE EN LA ESQUINA SUPERIOR DERECHA DE LA PANTALLA
 - EL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO SE ACTIVA DESPUÉS DE 20 SEG.
 - ENTRAR AL MENÚ DE SERVICIO
3. VERIFICAR QUE LOS VALORES DE VOLTAJE ESTÁN DENTRO DE LOS LÍMITES
4. VERIFICAR EL TIEMPO DE RESPALDO DE LA BATERÍA. DESCONECTAR EL CABLE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. ASEGURARSE QUE EL MONITOR SIGUE TRABAJANDO CON LA BATERÍA AL MENOS 15 MIN. EL INDICADOR DE BATERÍA DEBERÁ APARECER EN LA PANTALLA.

VERIFICACIÓN DE ECG

1. REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO Y SELECCIONAR MODULES - ESTP: ECG Y VERIFICAR QUE:
 - LOS VALORES DE: TIMEOUTS, BAD CHECKSUMS Y BAD C-S BY MOD, NO SE INCREMENTAN A MÁS DE 50/SEG.

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.P. 16030
TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

*Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico*

- LA TARJETA DE MEMORIA ECG/RESP, PASA LAS PRUEBAS INTERNAS DE MEMORIA (QUE RAM, ROM Y EEPROM TIENE EL ESTADO OK)
 - CONECTAR UN CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES. VERIFICAR QUE EL CABLE TYPE MUESTRE 5 LEADS.
 - VERIFICAR QUE CADA ELECTRODO MUESTRE OFF Y QUE SE DESPLIEGUE EL MENSAJE "CABLES DESCONECTADOS"
- CONECTA EL SIMULADOR DE PACIENTE. VERIFICAR QUE SE DESPLIEGUEN LOS PARÁMETROS SEGÚN ESTE CONFIGURADO EL EQUIPO, QUE CORRESPONDAN LAS FORMAS DE ONDA. APAGAR EL SIMULADOR Y VERIFICAR QUE SE MUESTRAN LOS MENSAJES "ASISTOLE" Y "APNEA".

VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA

- REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO Y SELECCIONAR ESTP: STP.
VERIFICAR QUE LA TARJETA DE MEMORIA ESTP: STP, PASA LAS PRUEBAS INTERNAS DE MEMORIA (QUE RAM, ROM Y EEPROM TIENE EL ESTADO OK)
- VERIFICAR LAS CALIBRACIONES DE TEMPERATURA CON LOS CONECTORES DE TEMPERATURA. CALIBRAR SI ES NECESARIO
- VERIFICAR QUE LA PROTECCIÓN PARA LA CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA ESTÁ ENCENDIDA

VERIFICACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA (NIBP)

- REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO Y SELECCIONAR NIBP
VERIFICAR QUE LA TARJETA DE MEMORIA NIBP, PASA LAS PRUEBAS INTERNAS DE MEMORIA (QUE RAM, ROM Y EEPROM TIENE EL ESTADO OK)
- EN EL MENÚ DE SERVICIO DE NIBP, SELECCIONAR CALIBRACIÓN Y ACTIVAR LA PRUEBA DE FUGAS PARA CHECAR FUGAS EN EL SISTEMA DE TUBOS, LA PRESIÓN NO DEBERÁ CAER MÁS DE 5 MMHG POR MIN.
- VERIFICAR LA CALIBRACIÓN CON 200 MMHG DE PRESIÓN Y CALIBRAR SI ES NECESARIO
- REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO DE NIBP Y SELECCIONAR PNEUMATICS. VERIFICAR QUE SE ACTIVA EL WATCHDOG DE PRESIÓN: LA SEÑAL AUDIBLE DE DEBERÁ ESCUCHAR DE 3 A 8 MMHG. SI ES NECESARIO CALIBRAR
- REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO DE NIBP Y SELECCIONAR WATCHDOG. VERIFICAR EL TEMPORIZADOR DEL WATCHDOG DE NIBP. EL TIEMPO PARA LA PRUEBA INFANTIL SERÁ DE 60 - 70 SEG.
- REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO DE NIBP Y SELECCIONAR SAFETY VALVE. VERIFICA QUE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD FUNCIONA CORRECTAMENTE. EL VALOR DE LA PRESIÓN MÁXIMA 2SEG DESPUÉS DE PARARSE PARA AMBOS TRANSDUCTORES SERÁ DE 290 - 330 MMHG PARA ADULTO Y 154 - 165 MMHG PARA INFANTIL.
- CONECTAR UN BRAZALETE INFANTIL AL MONITOR. INICIAR LA MEDICIÓN Y VERIFICAR QUE SE HA IDENTIFICADO CORRECTAMENTE EL BRAZALETE. CANCELAR LA MEDICIÓN.
- COLOCAR UN BRAZALETE ADULTO AL BRAZO Y REALIZAR UNA MEDICIÓN. VERIFICAR QUE SE HA IDENTIFICADO CORRECTAMENTE EL BRAZALETE. VERIFICAR QUE EL MODULO DA UN RESULTADO DE MEDICIÓN RAZONABLE

VERIFICACIÓN DE SPO2

- VERIFICAR QUE SE MUESTRA EN LA PANTALLA "SIN SENSOR", CUANDO EL SENSOR DE SPO2 NO ESTA CONECTADO AL MONITOR. CONECTAR UN SENSOR DE SATURACIÓN AL MONITOR. VERIFICAR QUE SE MUESTRE "SENSOR DESCONECTADO", "CHECAR SENSOR" O "BUSQUEDA DE PULSO".
- COLOCAR EL SENSOR DE SPO2 AL DEDO Y VERIFICAR QUE SE DESPLIEGA LA FORMA DE ONDA DE PLETISMOGRAFÍA Y UN VALOR DEL RANGO. VERIFICAR QUE EL VALOR DE LA FC ES CALCULADO DE LA SPO2 CUANDO LOS CABLES DE ECG E INVBP (P1/P2) NO ESTÁN CONECTADO.
- QUITAR EL SENSOR DE SPO2 DEL DEDO Y VERIFICAR QUE SE DESPLIEGA "SENSOR DESCONECTADO" O "CHECAR SENSOR".
- DESCONECTAR EL SENSOR DEL MONITOR Y VERIFICAR QUE SE DESPLIEGA, "SIN SENSOR"

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO,D.F. C.P. 16030
TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail:bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

VERIFICACIÓN DE PRESIÓN INVASIVA

1. VERIFICAR LOS CANALES DE PRESIÓN INVASIVA CON UN SIMULADOR DE PACIENTE. LOS VALORES Y FORMAS DE ONDA DEBERÁN CORRESPONDER A LOS AJUSTES DEL SIMULADOR.
2. CALIBRAR SI ES NECESARIO.

VERIFICACIÓN DE GASES

1. VERIFICAR QUE EL VENTILADOR DE LA UNIDAD DE GASES ESTA FUNCIONANDO.
2. REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO Y SELECCIONAR GAS UNIT-GENERAL. VERIFICAR QUE SE DESPLIEGA LA CONFIGURACIÓN DEL MODULO DE GAS CORRESPONDIENTE A LA CONFIGURACIÓN DEL MONITOR.
3. REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO DE GAS UNIT Y SELECCIONAR GASES VERIFICAR QUE SE DESPLIEGA EL VALOR AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LA PRESIÓN AMBIENTAL ACTUAL (+20MMHG)
4. REALIZAR PRUEBA DE FUGAS EN LA LÍNEA DE MUESTREO
5. VERIFICAR QUE EL RANGO DE FLUJO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS SIGUIENTES VALORES:
FLUJO DE MUESTREO (ML/MIN) 180 - 220
FLUJO DE REFERENCIA (ML/MIN) 31 - 45
AJUSTAR EL RANGO DE FLUJO SI ES NECESARIO.
6. REALIZAR LA CALIBRACIÓN DE GASES.

VERIFICACIÓN DE IDENTIFICADOR DE AA

MIENTRAS SE DESPLIEGAN EL MENÚ DE SERVICIO DE GASES, "ALIMENTAR" GAS DE CALIBRACIÓN CONTINUAMENTE AL MENOS 30 SEG Y VERIFICAR QUE SE MUESTRE EN PANTALLA:

- EL ID ES DES
- EL VALOR IDUNREAL ES MÁS BAJO DE 50

SI EL VALOR ES MÁS ALTO, RECALIBRAR LA IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE Y VERIFICAR EL VALOR OTRA VEZ

VERIFICACIÓN DE ESPIROMETRIA

1. REALIZAR LA PRUEBA DE FUGA Y CALIBRACIÓN DE ESPIROMETRÍA (SEGÚN LA SECCIÓN 7.4.9)
2. CON LA LINEA DE MUESTREO COLOCADA EN EL SENSOR D-LITE, RESPIRAR A TRAVÉS DEL LADO ANCHO DEL SENSOR. VERIFICAR QUE LA FORMA DE ONDA DE FLUJO ES HACIA ABAJO CUANDO INHALAS Y HACIA ARRIBA CUANDO EXHALAS.

VERIFICACIÓN DE LÍNEA DE MUESTREO Y D-LITE.

1. BLOQUEA EL EXTREMO DE LA LÍNEA DE MUESTREO CON EL DEDO Y VERIFICA QUE SE DESPLIEGA "LINEA DE MUESTREO BLOQUEADA" DESPUES DE 30 SEG.
2. LIBERA EL D-FEND Y VERIFICA QUE SE DESPLIEGA "CHECAR D-FEND", DESPUES DE 30 SEG.
3. REPIRA UNA VEZ POR LA LÍNEA DE MUESTREO Y VERIFICA QUE EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LA CURVA DE CO2 ES NORMAL.

PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. REALIZA UNA PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA Y UNA PRUEBA DE CORRIENTE DE FUGA.
2. VERIFICA QUE EL MONITOR FUNCIONA NORMALMENTE DESPUES DE REALIZAR LA PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA.
3. PONER EL MONITOR EN STBY, Y DESCONECTAR DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
4. REALIZAR LIMPIEZA SEGÚN MANUAL
5. REQUISITAR DOCUMENTOS DE CONTROL
6. ACTUALIZAR BITÁCORA
7. IMPRESIÓN DE REPORTES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
8. COLOCACIÓN DE ETIQUETAS.

LLENE LA DOCUMENTACION DE CONTROL Y REGRESE EL EQUIPO A FUNCIONAMIENTO.

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.P. 16030
TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015
LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.



BIOABAST S.A. DE C.V.

*Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico*

Capacidad de servicio local y regional, número de técnicos y nivel de resolución (capacidad):

- BIOABAST, S.A. de C.V., cuenta, para el adecuado respaldo en servicio de los bienes ofrecidos en esta partida, con oficinas en la Ciudad de México, D.F. se cuentan con 8 ingenieros capacitados en fábrica para el manejo del bien, dar mantenimiento correctivo y preventivo.

Base de localización.

- Oficina de la Cd. de México, sita en Camino Real a Xochitepec No. 108, Col. La Noria México, C.P. 16030, Delegación Xochimilco México D.F.; teléfonos 44444756, 44444755, horario de 9:00 hrs a 18:00 hrs de lunes a viernes.

Tiempo de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular)

- Máximo 48 horas hábiles después de recibir su solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo por escrito, para que un ingeniero de servicio esté atendiendo en sitio su requerimiento, reportando fallas con el Ing. Alfonso Romero al correo electrónico control.servicio@bioabast.com, respondiendo con acuse de recibido indicando número de reporte o folio.

El proveedor durante la vigencia de la garantía de los bienes, deberá de realizar las actualizaciones respectivas del software, que permita mantener actualizado el equipo, sin costo adicional para el(a) Instituto/Secretaría.

El mantenimiento correctivo será realizado por el proveedor conforme a las necesidades del equipo, a solicitud del(a) Instituto/Secretaría.

En caso de mantenimiento correctivo de los bienes y que se superen los "Tiempos máximos de reparación o atención de fallas" señalados en el numeral 14.1.2., el servicio no deberá ser interrumpido, se realizará de manera subrogada y los gastos por estos conceptos correrán por cuenta del proveedor.

Todos los gastos que se generen con motivo de la reparación o canje, así como los gastos por concepto de traslado de los derechohabientes, correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del(a) IMSS/SEDENA.

El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al(a) Instituto/Secretaría y/o a terceros.

Para la SEDENA

Adicionalmente, en caso de que el modelo del equipo adquirido se discontinúe, deberá notificar por escrito a la Secretaría, mediante oficio dirigido al Grupo de Mantenimiento de Equipo Médico, ubicado en Blvd. Manuel Ávila Camacho s/n, Col. Lomas de Sotelo, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11200, México, D.F., en un término no mayor a 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al hecho manifestado por parte del fabricante, lo cual deberá estar debidamente acreditado.

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dicha disposición para los fines y efectos a que haya lugar.

ATENTAMENTE



Marycarrién Silva Herrera
Representante Legal

**CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.P. 16030
TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com**



BIOABAST S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA
LA-019GYR040-T23-2015
ELECTRÓNICA
PARTIDA 27, UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD

México, D.F. a 10 de AGOSTO de 2015.

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA
LA-019GYR040-T23-2015
ELECTRONICA
PARTIDA 27, UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Punto 7, 7.1.

PARTIDA 27: UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD.

La suscrita Marycarmen Silva Herrera, en mi carácter de representante legal de la empresa BIOABAST, S.A. de C.V., manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

El programa de mantenimiento preventivo de los equipos ofertados bajo esta partida será realizado **cada 6 meses durante el periodo de garantía de los equipos (48 meses)** y corresponderá al siguiente listado (dependiendo de la fecha de instalación) y de acuerdo a lo siguiente:

AÑO 2015	AÑO 2016		AÑO 2017		AÑO 2018
DICIEMBRE	JUNIO	DICIEMBRE	JUNIO	DICIEMBRE	JUNIO
X	X	X	X	X	X
AÑO 2018	AÑO 2019				
DICIEMBRE	JUNIO				
X	X				

Asimismo, anexamos el detalle de los servicios que requiere el equipo ofertado bajo esta partida, y que corresponde a la siguiente rutina:

Procedimiento de mantenimiento preventivo programado

Equipo: Maquina de anestesia


Fabricante: GE

Modelo: Aisys

El presente procedimiento esta basado en:

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.P.
16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.



BIOABAST S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA
LA-019GYR040-T23-2015
ELECTRONICA
PARTIDA 27, UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD

Aisys Anesthesia Machine Technical Reference Manual sección 3 Checkout procedure

OBJETIVO:

- REVISIÓN DE CALIBRACIÓN
- SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES INCLUIDOS EN PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO
- VERIFICACIÓN OPERACIONAL DEL SISTEMA
- REQUISITAR DOCUMENTACIÓN DE CONTROL.

Equipo necesario:

- RT 200 O EQUIPO SEMEJANTE
- OXÍMETRO
- PULMÓN DE PRUEBA CON RESISTENCIA Y DISTENSIBILIDAD AJUSTABLE
- HERRAMIENTA GENERAL

Documentos relacionados:

Manual de operación
Manual de servicio
Ordenes de servicio
Bitácora de servicio
Formato de PMS
Etiquetas

PROCEDIMIENTO

VERIFICACION DEL ESTADO EXTERIOR DEL EQUIPO

1. Revisar que el equipo no muestre golpes así como indicios de líquido derramado.

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.P.
16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.



BIOABAST S.A. DE C.V.

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA
LA-019GYR040-T23-2015
ELECTRONICA
PARTIDA 27, UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD**

2. Retirar las cubiertas posteriores y verificar el estado de la tubería interior del sistema neumático.
3. Verificar que las mangueras de suministro de gases se encuentren en buen estado.
4. Revisar las conexiones del sistema de evacuación
5. Revisar el estado físico del teclado de membrana.
6. Revisar el estado físico del cable de línea y clavija.
7. Revisar el buen estado del circuito de paciente
8. Revisar el buen estado y funcionamiento de las perillas de suministro de gases.
9. Revisar el buen estado y funcionamiento de la perilla Comwell del Ventilador.
10. Verificar el funcionamiento del sistema Hipoxico.
11. Verificar el buen estado de los vaporizadores.
12. Verificar el buen estado de los cajones.
13. Verificar el buen estado de las ruedas.
14. Verificar el funcionamiento del freno del equipo.
15. Revisar el buen estado del fuelle yacrílico.
16. Revisar el buen estado del circuito absorbedor.

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

SISTEMA "TODAS LAS PRUEBAS"

En el menú de Checkout seleccione "todas las pruebas " y siga las instrucciones para la prueba de fuga de baja presión , vent check y quick check.

PRUEBA DE FUGA DE BAJA PRESION.


1. Verifique que todos los recipientes de anestésico estén cerrados
2. Coloque el ACGO a ABS
3. Ponga el dispositivo de prueba de fugas a la salida del ACGO
4. Colapse el bulbo
5. El budo no se debe inflar por más de 30 segundos
6. Realice la prueba con cada vaporizador

PRUEBA RAPIDA

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO,D.F. C.P.
16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail:bioabast.clients@gmail.com

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.



BIOABAST S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA
LA-019GYR040-T23-2015
ELECTRONICA

PARTIDA 27, UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD

1. Ocluya la salida de paciente
2. Coloque el selector de bolsa/ventilador a bolsa
3. Coloque el selector ABCGO a ABS
4. Ajuste la válvula APL a 50
5. Seleccione start

VERIFICACION DEL VENTILADOR

1. Seleccione ventilador con el selector bolsa/vent
2. Abra la y de paciente
3. Coloque el selector AGCO a ABS
4. Presione start
5. Siga las instrucciones descritas en la pantalla
6. Verifique que el fuelle se colapse
7. Ocluya la y del paciente
8. Seleccione continúe

VERIFICACION DEL O2 DEL CIRCUITO

1. Desconecte la y del paciente
2. Seleccione vent
3. Selección ABS
4. La pantalla desplegara el O2
5. Termine cuando la lectura sea estable

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO,D.F. C.P.
16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail:bioabast.clients@gmail.com



CONTROL DE FLUJO, ALARMA DE SUMINISTRO DE OXIGENO Y FLUSH

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

1. Conecte el suministro de gases
2. Cierre completamente las válvulas de flujo de todos los gases
3. Ponga el selector acgo a abs
4. Encienda el sistema
5. Verifique que el monitor de oxígeno indica 21 % y 100 % en presencia de oxígeno puro
6. En caso necesario calibre el sensor de oxígeno
7. Verifique el flujo mínimo de oxígeno de 175 1 225 ml/min
8. Verifique que los flotadores corren libremente a través de toda la escala
9. Cierre todas las válvulas
10. Abra paulatinamente la válvula de óxido nítrico y verifique que la concentración de oxígeno esta en el rango según la tabla siguiente:

Set (litros / minuto)	Rango de O ₂
3.0	21% to 30%
2.0	21% to 30%
1.0	21% to 30%
0.2	21% to 31%

ALARMA DE SUMINISTRO DE OXIGENO

1. Coloque todas las válvulas de flujo a 3 litros
2. Desconecte el suministro de oxígeno
3. Asegúrese de que la alarma suena , el suministro de óxido nítrico se interrumpe,
4. Cierre las válvulas y reconecte el oxígeno.

PRUEBA DE FLUSH

1. Ponga el selector bolsa / vent en la posición de bolsa

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.



BIOABAST S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA
LA-019GYR040-T23-2015
ELECTRONICA
PARTIDA 27, UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD

2. Ponga el sistema en stby
3. Coloque el circuito de paciente y cierre el puerto del paciente
4. Coloque el ACGO a ABS
5. Asegúrese de que el fuelle está completamente colapsado.
6. Mida el tiempo que le toma al fuelle llenarse cuando se presión a el botón de flush
7. Repita la medición dos veces el tiempo debe ser de 1.8 a 2.3 segundos.

VAPORIZADORES BACK PRESSURE

1. Coloque el sistema de evacuación
2. Ponga el selector ACGO a ABS
3. Ponga el selector Bolsa/ vent. a bolsa
4. Ajuste la válvula APL al mínimo
5. Encienda el interruptor
6. Ponga el flujo de oxígeno a 6 lpm
7. Ajuste la concentración del vaporizador a 1 % el flujo no debe decrementar en más de 1 lpm
8. Pruebe todos los vaporizadores
9. Ponga el sistema a STBY

VERIFICACION ELECTRICA

1. Conecte el suministro de energía
2. Encienda el equipo
3. Desconecte el suministro
4. Asegúrese de que el equipo funciona y un mensaje aparece en la pantalla indicando su operación a Bateria

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.P.
16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA
LA-019GYR040-T23-2015
ELECTRONICA

PARTIDA 27, UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD

5. Conecte un dispositivo para pruebas de seguridad eléctrica y verifique que la corriente de fuga sea menor a 300 Micro amperes
6. Verifique que la resistencia del cable de tierra es de 0.2 ohm.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

LLENE LA DOCUMENTACION DE CONTROL Y REGRESE EL EQUIPO A FUNCIONAMIENTO

Procedimiento de Mantenimiento Preventivo Programado

EQUIPO: **MONITOR**
FABRICANTE: **GE**
MODELO: **B650**

EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ESTA BASADO EN:

CARESCAPE B650 /B20 USER'S REFERENCE MANUAL PART I MAINTENANCE AND CLEANING Y EN CARESCAPE B650/B20 TECHNICAL REFERENCE CAPÍTULO 3 PLANNED MAINTENANCE

OBJETIVO:

- REVISIÓN DE CALIBRACIÓN
- SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES INCLUIDOS EN PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO
- VERIFICACIÓN OPERACIONAL DEL SISTEMA
- REQUISITAR DOCUMENTACIÓN DE CONTROL.

EQUIPO NECESARIO:

SIMULADOR DE PACIENTE
 HERRAMIENTA GENERAL
 EQUIPO DE MEDICIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 MEDIDOR DE PRESIÓN CON TRANSDUCTOR DE 2 BARES
 KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAT. 8001760
 ACCESORIOS DE ECG, SENSOR DE SpO2, BRAZALETE ADULTO, BRAZALETE INFANTIL MANGUERA INFANTIL, MANGUERA ADULTO, LINEA DE MUESTREO DE 3M, D-LITE
 MEDIDOR DE FLUJO.
 SILICÓN COMPATIBLE CON O2.
 GAS DE CALIBRACIÓN 755583
 JERINGA DE ESPIROMETRIA
 REGULADOR PARA GAS DE CALIBRACIÓN

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO,D.F. C.P. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail:bioabast.clients@gmail.com

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.



BIOABAST S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA
LA-019GYR040-T23-2015
ELECTRONICA
PARTIDA 27, UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD

DOCUMENTOS RELACIONADOS:

MANUAL DE OPERACIÓN
MANUAL DE SERVICIO
ORDENES DE SERVICIO
BITÁCORA DE SERVICIO
FORMATO DE PMS
ETIQUETAS

PROCEDIMIENTO

1 PRUEBAS GENERALES

- 1.1 REVISE QUE EL MONITOR NO TENGA DEFECTOS VISUALES, COMO GRIETAS O PARTES SUeltas
- 1.2 REVISE QUE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ CONECTADO A UNA TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y AL MONITOR.
- 1.3 REVISE QUE LA TRAMPA DE AGUA (D-FEND) ESTÁ VACÍA Y COLOCADA CORRECTAMENTE EN SU LUGAR
- 1.4 REVISE QUE LA LÍNEA DE MUESTREO ESTÁ CONECTADA AL MONITOR
- 1.5 REVISE QUE LOS CABLES DE CONEXIÓN DE PACIENTE ESTÁN COLOCADOS A LOS CONECTORES DE ENTRADA DEL MONITOR DE TAL FORMA QUE LOS CÓDIGOS DE COLORES COINCIDAN
- 1.6 REVISE QUE LAS TENDENCIAS DEL PACIENTE ANTERIOR SE BORRAN.
- 1.7 REVISE QUE LOS LÍMITES DE ALARMA SON ADECUADOS PARA EL PACIENTE

INSPECCIÓN FUNCIONAL

1. CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN Y VERIFIQUE QUE EL INDICADOR DE BATERÍA ESTA PARPADEANDO
2. ENCIENDA EL MONITOR Y VERIFIQUE QUE INICIALIZA:
 - LOS INDICADORES DE ALARMAS SE ENCIENDEN Y APAGAN
 - SE ESCUCHA EL SONIDO DE INICIO DE LA BOCINA
 - SE DESPLIEGA LA PANTALLA NORMA Y NO APARECE NINGÚN MENSAJE DE ERROR
 - SE DESPLIEGA LA FECHA Y HORA
 - EL SÍMBOLO DE "BATERÍA CARGANDO" APARECE EN LA ESQUINA SUPERIOR DERECHA DE LA PANTALLA
 - EL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO SE ACTIVA DESPUÉS DE 20 SEG.
 - ENTRAR AL MENÚ DE SERVICIO
3. VERIFICAR QUE LOS VALORES DE VOLTAJE ESTÁN DENTRO DE LOS LÍMITES
4. VERIFICAR EL TIEMPO DE RESPALDO DE LA BATERÍA. DESCONECTAR EL CABLE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. ASEGURARSE QUE EL MONITOR SIGUE TRABAJANDO CON LA BATERÍA AL MENOS 15 MIN. EL INDICADOR DE BATERÍA DEBERÁ APARECER EN LA PANTALLA.

VERIFICACIÓN DE ECG

1. REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO Y SELECCIONAR **MODULES - ESTP:ECG** Y VERIFICAR QUE:
 - LOS VALORES DE: **TIMEOUTS, BAD CHECKSUMS Y BAD C-S BY MOD**, NO SE INCREMENTAN A MÁS DE 50/SEG.

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.P.
16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com




- LA TARJETA DE MEMORIA ECG/RESP, PASA LAS PRUEBAS INTERNAS DE MEMORIA (QUE RAM, ROM Y EEPROM TIENE EL ESTADO OK)
2. CONECTAR UN CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES. VERIFICAR QUE EL **CABLE TYPE** MUESTRE **5 LEADS**.
3. VERIFICAR QUE CADA ELECTRODO MUESTRE OFF Y QUE SE DESPLIEGUE EL MENSAJE "CABLES DESCONECTADOS"
CONECTA EL SIMULADOR DE PACIENTE. VERIFICAR QUE SE DESPLIEGUEN LOS PARÁMETROS SEGÚN ESTE CONFIGURADO EL EQUIPO, QUE CORRESPONDAN LAS FORMAS DE ONDA. APAGAR EL SIMULADOR Y VERIFICAR QUE SE MUESTRAN LOS MENSAJES "ASISTOLE" Y "APNEA".

VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA

1. REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO Y SELECCIONAR **ESTP:STP**.
 - VERIFICAR QUE LA TARJETA DE MEMORIA ESTP:STP, PASA LAS PRUEBAS INTERNAS DE MEMORIA (QUE RAM, ROM Y EEPROM TIENE EL ESTADO OK)
2. VERIFICAR LAS CALIBRACIONES DE TEMPERATURA CON LOS CONECTORES DE TEMPERATURA. CALIBRAR SI ES NECESARIO
3. VERIFICAR QUE LA PROTECCIÓN PARA LA CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA ESTÁ ENCENDIDA

VERIFICACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA (NIBP)

1. REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO Y SELECCIONAR **NIBP**
 - VERIFICAR QUE LA TARJETA DE MEMORIA NIBP, PASA LAS PRUEBAS INTERNAS DE MEMORIA (QUE RAM, ROM Y EEPROM TIENE EL ESTADO OK)
2. EN EL MENÚ DE SERVICIO DE NIBP, SELECCIONAR **CALIBRACIÓN** Y ACTIVAR LA PRUEBA DE FUGAS PARA CHECAR FUGAS EN EL SISTEMA DE TUBOS, LA PRESIÓN NO DEBERÁ CAER MÁS DE 5 MMHG POR MIN.
3. VERIFICAR LA CALIBRACIÓN CON 200 MMHG DE PRESIÓN Y CALIBRAR SI ES NECESARIO
4. REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO DE NIBP Y SELECCIONAR **PNEUMATICS**. VERIFICAR QUE SE ACTIVA EL **WATCHDOG DE PRESIÓN**: LA SEÑAL AUDIBLE DE DEBERÁ ESCUCHAR DE 3 A 8 MMHG. SI ES NECESARIO CALIBRAR
5. REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO DE NIBP Y SELECCIONAR **WATCHDOG**. VERIFICAR EL TEMPORIZADOR DEL **WATCHDOG** DE NIBP. EL TIEMPO PARA LA PRUEBA INFANTIL SERÁ DE 60 - 70 SEG.
6. REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO DE NIBP Y SELECCIONAR **SAFETY VALVE**. VERIFICA QUE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD FUNCIONA CORRECTAMENTE. EL VALOR DE LA PRESIÓN MÁXIMA 2SEG DESPUÉS DE PARARSE PARA AMBOS TRANSDUCTORES SERÁ DE 290 - 330 MMHG PARA ADULTO Y 154 - 165 MMHG PARA INFANTIL.
7. CONECTAR UN BRAZALETE INFANTIL AL MONITOR. INICIAR LA MEDICIÓN Y VERIFICAR QUE SE HA IDENTIFICADO CORRECTAMENTE EL BRAZALETE. CANCELAR LA MEDICIÓN.
8. COLOCAR UN BRAZALETE ADULTO AL BRAZO Y REALIZAR UNA MEDICIÓN. VERIFICAR QUE SE HA IDENTIFICADO CORRECTAMENTE EL BRAZALETE. VERIFICAR QUE EL MODULO DA UN RESULTADO DE MEDICIÓN RAZONABLE



BIOABAST S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA
LA-019GYR040-T23-2015
ELECTRONICA
PARTIDA 27, UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD

VERIFICACIÓN DE SPO2

1. VERIFICAR QUE SE MUESTRA EN LA PANTALLA "SIN SENSOR", CUANDO EL SENSOR DE SPO2 NO ESTA CONECTADO AL MONITOR. CONECTAR UN SENSOR DE SATURACIÓN AL MONITOR. VERIFICAR QUE SE MUESTRE "SENSOR DESCONECTADO", "CHECAR SENSOR" O "BUSQUEDA DE PULSO".
2. COLOCAR EL SENSOR DE SPO2 AL DEDO Y VERIFICAR QUE SE DESPLIEGA LA FORMA DE ONDA DE PLETISMOGRAFÍA Y UN VALOR DEL RANGO. VERIFICAR QUE EL VALOR DE LA FC ES CALCULADO DE LA SPO2 CUANDO LOS CABLES DE ECG E INVBP (P1/P2) NO ESTÁN CONECTADO.
3. QUITAR EL SENSOR DE SPO2 DEL DEDO Y VERIFICAR QUE SE DESPLIEGA "SENSOR DESCONECTADO" O "CHECAR SENSOR".
4. DESCONECTAR EL SENSOR DEL MONITOR Y VERIFICAR QUE SE DESPLIEGA, "SIN SENSOR"

VERIFICACIÓN DE PRESIÓN INVASIVA

1. VERIFICAR LOS CANALES DE PRESIÓN INVASIVA CON UN SIMULADOR DE PACIENTE. LOS VALORES Y FORMAS DE ONDA DEBERÁN CORRESPONDER A LOS AJUSTES DEL SIMULADOR.
2. CALIBRAR SI ES NECESARIO.

VERIFICACIÓN DE GASES

1. VERIFICAR QUE EL VENTILADOR DE LA UNIDAD DE GASES ESTA FUNCIONANDO.
2. REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO Y SELECCIONAR **GAS UNIT-GENERAL**. VERIFICAR QUE SE DESPLIEGA LA CONFIGURACIÓN DEL MODULO DE GAS CORRESPONDIENTE A LA CONFIGURACIÓN DEL MONITOR.
3. REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO DE GAS UNIT Y SELECCIONAR **GASES** VERIFICAR QUE SE DESPLIEGA EL VALOR **AMBIENTAL** CORRESPONDIENTE A LA PRESIÓN AMBIENTAL ACTUAL (± 20 MMHG)
4. REALIZAR PRUEBA DE FUGAS EN LA LÍNEA DE MUESTREO
5. VERIFICAR QUE EL RANGO DE FLUJO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS SIGUIENTES VALORES:
FLUJO DE MUESTREO (ML/MIN) 180 - 220
FLUJO DE REFERENCIA (ML/MIN) 31 - 45
AJUSTAR EL RANGO DE FLUJO SI ES NECESARIO.
6. REALIZAR LA CALIBRACIÓN DE GASES.

VERIFICACIÓN DE IDENTIFICADOR DE AA

MIENTRAS SE DESPLIEGAN EL MENÚ DE SERVICIO DE GASES, "ALIMENTAR" GAS DE CALIBRACIÓN CONTINUAMENTE AL MENOS 30 SEG Y VERIFICAR QUE SE MUESTRE EN PANTALLA:

- EL ID ES DES
- EL VALOR IDUNREAL ES MÁS BAJO DE 50

SI EL VALOR ES MÁS ALTO, RECALIBRAR LA IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE Y VERIFICAR EL VALOR OTRA VEZ

VERIFICACIÓN DE ESPIROMETRIA

1. REALIZAR LA PRUEBA DE FUGA Y CALIBRACIÓN DE ESPIROMETRÍA (SEGÚN LA SECCIÓN 7.4.9)
2. CON LA LINEA DE MUESTREO COLOCADA EN EL SENSOR D-LITE, RESPIRAR A TRAVÉS DEL LADO ANCHO DEL SENSOR. VERIFICAR QUE LA FORMA DE ONDA DE FLUJO ES HACIA ABAJO CUANDO INHALAS Y HACIA ARRIBA CUANDO EXHALAS.

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.P.
16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com



VERIFICACIÓN DE LÍNEA DE MUESTREO Y D-LITE.

1. BLOQUEA EL EXTREMO DE LA LÍNEA DE MUESTREO CON EL DEDO Y VERIFICA QUE SE DESPLIEGA "LÍNEA DE MUESTREO BLOQUEADA" DESPUES DE 30 SEG.
2. LIBERA EL D-FEND Y VERIFICA QUE SE DESPLIEGA "CHECAR D-FEND", DESPUES DE 30 SEG.
3. REPIRA UNA VEZ POR LA LÍNEA DE MUESTREO Y VERIFICA QUE EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LA CURVA DE CO2 ES NORMAL.

PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. REALIZA UNA PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA Y UNA PRUEBA DE CORRIENTE DE FUGA.
2. VERIFICA QUE EL MONITOR FUNCIONA NORMALMENTE DESPUES DE REALIZAR LA PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA.
3. PONER EL MONITOR EN STBY Y DESCONECTAR DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
4. REALIZAR LIMPIEZA SEGÚN MANUAL
5. REQUISITAR DOCUMENTOS DE CONTROL
6. ACTUALIZAR BITÁCORA
7. IMPRESIÓN DE REPORTES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
8. COLOCACIÓN DE ETIQUETAS.

LLENE LA DOCUMENTACION DE CONTROL Y REGRESE EL EQUIPO A FUNCIONAMIENTO.

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dicha disposición para los fines y efectos a que haya lugar.

Atentamente

Marycarmen Silva Herrera
Representante Legal

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

SIN TEXTO

A handwritten mark or signature, possibly a stylized letter 'P' or a similar symbol, located in the bottom right corner of the page.



BIOABAST

S.A. DE C.V.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,

**ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	102
PARTIDA	41 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA		
CLAVE SAI	531.053.0372.00.01		
CLAVE PREI	000000000017409		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE			

EESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AESPIRE 7900
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2, MANUAL DE USUARIO 3, MANUAL DE USUARIO 4, MANUAL DE SERVICIO 1.

HOJA 1 DE 20

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

CARACTERSTICA

1. DEFINICION

1.1 Unidad de anestesia general, para administración de anestésicos oxígeno, óxido nitroso otros gases medicinales y agentes anestésicos.

2. DESCRIPCIÓN

2.1.- Gabinete:

2.1.1.- Montaje para dos vaporizadores con sistema de exclusión.

2.1.2.- Ventilador interconstruido.

2.1.3.-Con al menos cuatro contacto eléctricos interconstruidos.

2.1.4.- Yugos para cilindros de O2 y N2O.

2.1.5.- Con al menos un cajon.

2.1.6.- Mesa de trabajo.

2.1.7.- Montaje en máquina para monitor de signos vitales.

2.1.8.- Cuatro ruedas, al menos dos de ellas con freno o sistema de freno central.

2.1.9.- Manómetros interconstruidos de presión al frente del equipo código americano de colores (O2-verde, N2O-azul, aire-amarillo):

2.1.9.1.- Tres para toma mural (O2, N2O, aire).

2.1.9.2. Dos para cilindros (O2, N2O).

2.1.10.- Batería de respaldo interna con capacidad mínima de 60 min.

CARACTERISTICA

1. DEFINICION. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 1-2.

1.1 Unidad de anestesia general, para administración de anestésicos oxígeno, óxido nitroso otros gases medicinales y agentes anestésicos. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 1-2.

2. DESCRIPCIÓN. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 1-2.

2.1.- Gabinete: CATALOGO 1 PAGINA 1.

2.1.1.- Montaje para dos vaporizadores con sistema de exclusión. CATALOGO 1 PAGINA 1, 4.

2.1.2.- Ventilador interconstruido.

CATALOGO 1 PAGINA 1.

2.1.3.-Con cuatro contacto eléctricos interconstruidos. CATALOGO 1 PAGINA 5.

MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-4.

2.1.4.- Yugos para cilindros de O2 y N2O.

MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-4.

CATALOGO 1 PAGINA 5.

2.1.5.- Con dos cajones. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-2.


2.1.6.- Mesa de trabajo. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-2.

MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-2.

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO,D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail:bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

**ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	102
PARTIDA	41 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA		
CLAVE SAI	531.053.0372.00.01		
CLAVE PREI	000000000017409		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AESPIRE 7900 CARESCAPE Monitor B650
CATALOGO	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2, MANUAL DE USUARIO 3, MANUAL DE USUARIO 4, MANUAL DE SERVICIO 1.

HOJA 2 DE 20

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

2.1.11.- Con iluminación para el área de trabajo.
2.2. Vaporizadores de la misma marca que la unidad de anestesia.
2.2.1.- Suministrar dos vaporizadores (sevoflurane y isoflurane).
2.2.- Con compensación en flujo, presión y temperatura
2.2.3.- Indicador visual del nivel de llenado de agente anestésico.
2.2.4.- Adaptador para el llenado del vaporizador en caso de requerirse.
2.3.- Suministro de gas fresco:
2.3.1.- Flujómetros dobles neumáticos con despliegue para O2, N2O y aire codificados de acuerdo al código americano de colores: (O2- verde, N2O-azul, aire-amarillo).
2.3.2.- Mezclador neumático.
2.3.3.- Guarda hipóxica mínima de 23%.
2.3.4.- Flush o suministro de oxígeno directo.
2.4.- Circuito de paciente:
2.4.1.- Un cánister.
2.4.1.1.- Con capacidad mínima de 700 ml u 800 gr.
2.4.1.2.- Reusable y esterilizable.
2.4.1.3.- Con filtro de polvo en caso de requerirse.
2.4.1.4.- Con sistema que permita el cambio de cal sodada durante la ventilación mecánica sin ocasionar fugas.
2.4.2.- Con trampa de agua (condensador)
2.4.3.- Salida de gas fresco para circuito auxiliar.

2.1.7.- Montaje en máquina para monitor de signos vitales. CATALOGO 1 PAGINA 1.
2.1.8.- Cuatro ruedas, dos de ellas con freno. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-2, 2-3.
2.1.9.- Manómetros interconstruidos de presión al frente del equipo código americano de colores (O2-verde, N2O-azul, aire-amarillo): MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 6-6. CATALOGO 1 PAGINA 1.
2.1.9.1.- Tres para toma mural (O2, N2O, aire). CATALOGO 1 PAGINA 1. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 6-6.
2.1.9.2. Dos para cilindros (O2, N2O). CATALOGO 1 PAGINA 1. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 6-6.
2.1.10.- Batería de respaldo interna con de 90 min. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 6-8.
2.1.11.- Con iluminación para el área de trabajo. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 1-4. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 6-15.
2.2.- Vaporizadores de la misma marca que la unidad de anestesia). CATALOGO 1 PAGINA 4. MANUAL DE USUARIO 3 PAGINA 1.

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail:bioabast.clients@gmail.com



ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	102
PARTIDA	41 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA		
CLAVE SAI	531.053.0372.00.01		
CLAVE PREI	000000000017409		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE			

EESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AESPIRE 7900
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2, MANUAL DE USUARIO 3, MANUAL DE USUARIO 4, MANUAL DE SERVICIO 1.

HOJA 3 DE 20

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

2.4.4.- Con sistema de conmutación entre circuito circular y circuito auxiliar (tipo Bain).
 2.4.5.- Sistema de evacuación de gases activo o pasivo.
 2.4.6.- Todos los elementos en contacto con el gas espirado por el paciente deberán ser esterilizables y libres de látex.
 2.4.7.- Válvula ajustable de presión (APL).
 2.4.8.- Válvula de sobrepresión.
 2.4.9.- Válvula de conmutación bolsa-ventilador.
 2.4.10.- Manómetro de presión en vías aéreas.
 2.4.11.- Brazo ajustable para bolsa de ventilación manual.
 2.5.- Ventilador microprocesado e interconstruido de la misma marca que la máquina de anestesia:
 2.5.1.- Teclado sensible al tacto o de membrana, o perilla selectora.
 2.5.2.- Despliegue de mensajes y parámetros en español.
 2.5.3. Pantalla:
 2.5.3.1.- Tipo LCD, LCD TFT o tecnología superior.
 2.5.3.2.- Tamaño mínimo de 6.5".
 2.5.3.3.- Policromática.
 2.5.3.4.-Configurable por el usuario.
 2.5.3.5.- Despliegue de parámetros en forma numérica.
 2.5.3.6.- Despliegue mínimo de una curva de presión.
 2.5.4.- Modos de ventilación:
 2.5.4.1.- Controlado por volumen.
 2.5.4.2.- Controlado por presión.

2.2.1.- Dos vaporizadores (sevoflurano e isoflurano). MANUAL DE USUARIO 3 PAGINA 1-2.
 2.2.- Con compensación en flujo, presión y temperatura. MANUAL DE USUARIO 3 PAGINA 2-1.
 2.2.3.- Indicador visual del nivel de llenado de agente anestésico. MANUAL DE USUARIO 3 PAGINA A, 4-5.
 2.2.4.- Adaptador para el llenado del vaporizador. MANUAL DE USUARIO 3 PAGINA 4-7.
 2.3.- Suministro de gas fresco: MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 6-6.
 2.3.1.- Flujómetros dobles neumáticos con despliegue para O2, N2O y aire codificados de acuerdo al código americano de colores: (O2- verde, N2O-azul, aire-amarillo). MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-2. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 6-6, 6-7.
 2.3.2.- Mezclador neumático. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 6-5.
 2.3.3.- Guarda hipóxica de 21%. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 6-5. **SEGÚN ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**
 2.3.4.- Suministro de oxígeno directo. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-2, 2-3.



BIOABAST S.A. DE C.V.

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	102
PARTIDA	41 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA		
CLAVE SAI	531.053.0372.00.01		
CLAVE PREI	000000000017409		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AESPIRE 7900
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2, MANUAL DE USUARIO 3, MANUAL DE USUARIO 4, MANUAL DE SERVICIO 1.
HOJA 4 DE 20	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE


2.5.4.3.- SIMV (Ventilación Mandataria Intermitente Sincronizada).
 2.5.4.4.- Presión Soporte.
 2.5.5.- Controles y ajuste de:
 2.5.5.1.- Volumen corriente que cubra como mínimo el rango de 20 a 1400 ml.
 2.5.5.2.- Presión límite que cubra como mínimo el rango de 15 a 70 cmH2O.
 2.5.5.3.- Presión inspiratoria que cubra como mínimo el rango de 10 a 50 cmH2O.
 2.5.5.4.- Frecuencia respiratoria que cubra como mínimo el rango de 4 a 60 respiraciones por minuto.
 2.5.5.5.- PEEP electrónico que cubra como mínimo el rango de 4 a 20 cmH2O.
 2.5.5.6.- Relación I:E y relación I:E inversa.
 2.5.5.7.- Pausa inspiratoria.
 2.5.5.8.- Sensibilidad por flujo o presión.
 2.5.5.9.- Presión soporte.
 2.5.6.- Despliegue numérico en pantalla del ventilador o del monitor de signos vitales.
 2.5.6.1.- Oxígeno inspirado y espirado.
 2.5.6.2. Volumen corriente.
 2.5.6.3. Volumen minuto.
 2.5.6.4. Presión media.
 2.5.6.5. Presión pico en su caso, presión soporte.
 2.5.6.6. PEEP.
 2.5.6.7. Frecuencia respiratoria.
 2.5.7. Despliegue de curva en pantalla del ventilador.

2.4.- Circuito de paciente: MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-5.
 2.4.1.- Un cánister. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-5.
 2.4.1.1.- Con capacidad de 800 gr. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 1-5.
 2.4.1.2.- Reusable y esterilizable. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 1-5.
 2.4.1.3.- Con filtro de polvo. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 1-8.
 2.4.1.4.- Con sistema que permite el cambio de cal sodada durante la ventilación mecánica sin ocasionar fugas. MANUAL DE SERVICIO 1 PAGINA 2-18. TRADUCCION ANEXA.
 2.4.2.- Con trampa de agua. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 1-6.
 2.4.3.- Salida de gas fresco para circuito auxiliar. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-6.
 2.4.4.- Con sistema de conmutación entre circuito circular y circuito auxiliar (tipo Bain). MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-6.
 2.4.5.- Sistema de evacuación de gases pasivo. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 6-18.

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.



BIOABAST S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	102
PARTIDA	41 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA		
CLAVE SAI	531.053.0372.00.01		
CLAVE PREI	000000000017409		
	NOMBRE GENÉRICO		
	ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE		

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AESPIRE 7900
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2, MANUAL DE USUARIO 3, MANUAL DE USUARIO 4, MANUAL DE SERVICIO 1.
	HOJA 5 DE 20

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

- 2.5.7.1. Presión/Volumen.
- 2.5.7.2. Flujo/Volumen.
- 2.5.8.- Sistema de alarmas audibles y visuales priorizadas en tres niveles (despliegue y ajuste en pantalla del ventilador):
 - 2.5.8.1.- FIO2 (alta y baja).
 - 2.5.8.2.- Volumen minuto y/o corriente (alta y baja).
 - 2.5.8.3.- Presión de vías aéreas (alta y baja).
 - 2.5.8.4.- Apnea.
 - 2.5.8.5.- Presión baja de suministro de gas.
 - 2.5.8.6.- Falla en el suministro eléctrico.
 - 2.5.8.7.- Falla o cambio de celda de O2 o falla en la medición para tecnología paramagnética.
 - 2.5.8.8.- Fuga en circuito de paciente.
 - 2.5.8.9.- Falla en sensor de presión.
- 2.5.9.- Conmutación a ventilación manual.
- 2.5.10.- Compensación de volumen o desacoplo de gas fresco.
- 2.5.11.- Indicador de fuente de alimentación, AC o DC.
- 2.5.12.- Indicador batería baja.
- 2.6.- Sistema de comprobación que verifique el funcionamiento neumático y electrónico de la unidad de anestesia.
- 2.7.1.- Monitor preconfigurado o modular.
- 2.7.2.- Pantalla sensible al tacto, teclado de membrana o perilla selectora.
- 2.7.3.- Pantalla policromática de tecnología LCD, LCD TFT o tecnología superior, de 12" como mínimo.

- 2.4.6.- Todos los elementos en contacto con el gas espirado por el paciente son esterilizables y libres de látex. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 2-3.
- 2.4.7.- Válvula ajustable de presión (APL). MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-7.
- 2.4.8.- Válvula de sobrepresión. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 6-3.
- 2.4.9.- Válvula de conmutación bolsa-ventilador. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-8.
- 2.4.10.- Manómetro de presión en vías aéreas. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-5
- 2.4.11.- Brazo ajustable para bolsa de ventilación manual. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-8.
- 2.5.- Ventilador microprocesado e interconstruido de la misma marca que la máquina de anestesia: CATALOGO 1 PAGINA 1. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 1-2.
- 2.5.1.- Teclado de membrana y perilla selectora. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-12.
- 2.5.2.- Despliegue de mensajes y parámetros en español. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-13.

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	102
PARTIDA	41 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA		
CLAVE SAI	531.053.0372.00.01		
CLAVE PREI	00000000017409		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AESPIRE 7900
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2, MANUAL DE USUARIO 3, MANUAL DE USUARIO 4, MANUAL DE SERVICIO 1.
	HOJA 6. DE 20


DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

2.7.4.- Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación.
2.7.5.- Despliegue de curvas fisiológicas, de al menos 8 curvas simultáneas.
2.7.6.- Despliegue de mensajes y parámetros en español.
2.7.7.- Tendencias gráficas y numéricas para todos los parámetros, de 24 horas como mínimo.
2.7.8.- Batería de respaldo interna con capacidad mínima de 120 min.
2.7.9.- Monitoreo de los siguientes parámetros desplegados en el monitor de signos vitales o en el ventilador.
2.7.10.- ECG
2.7.10.1.- Despliegue numérico de frecuencia cardiaca.
2.7.10.2.- Al menos 7 derivaciones seleccionables por el usuario
2.7.10.3.- Despliegue simultáneo de al menos dos curvas a elegir de, 7 derivaciones de ECG como mínimo.
2.7.10.4.- Análisis del segmento ST.
2.7.10.5.- Análisis de arritmias.
2.7.10.6.- Control de activación de filtros en la señal.
2.7.10.7.- Detección de marcapasos.
2.7.10.8.- Protección contra descarga de desfibrilador.
2.7.11.- CO2
2.7.11.1.- Por medio de Mainstream o Sidestream o microstream.

2.5.3.- Pantalla: CATALOGO 1 PAGINA 2.
2.5.3.1.- Tipo VGA. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 6-16.
2.5.3.2.- Tamaño mínimo de 6.7". (ALTURA 3", ANCHO 6"). CATALOGO 1 PAGINA 2.
2.5.3.3.- Policromática. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA A. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 6-16.
2.5.3.4.- Configurable por el usuario. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-12.
2.5.3.5.- Despliegue de parámetros en forma numérica. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 3-23.
2.5.3.6.- Despliegue de una curva de presión. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-12.
2.5.4.- Modos de ventilación: CATALOGO 1 PAGINA 1.
2.5.4.1.- Controlado por volumen. CATALOGO 1 PAGINA 1.
2.5.4.2.- Controlado por presión. CATALOGO 1 PAGINA 1.
2.5.4.3.- SIMV (Ventilación Mandataria Intermitente Sincronizada). CATALOGO 1 PAGINA 1.
2.5.4.4.- Presión Soporte. CATALOGO 1 PAGINA 1.

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com





BIOABAST S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	102
PARTIDA	41 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA		
CLAVE SAI	531.053.0372.00.01		
CLAVE PREI	000000000017409		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AESPIRE 7900
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2, MANUAL DE USUARIO 3, MANUAL DE USUARIO 4, MANUAL DE SERVICIO 1.
HOJA 7 DE 20	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

- 2.7.11.2.- Despliegue de curva y valores numéricos inspirado y espirado.
- 2.7.12. SpO2.
- 2.7.12.1.- Curva de pletismografía.
- 2.7.12.2.- Despliegue numérico de saturación de oxígeno.
- 2.7.13.- Temperatura en mínimo 2 canales.
- 2.7.13.1.- Despliegue numérico de ambas temperaturas de manera simultanea.
- 2.7.14.- Presión arterial no invasiva.
- 2.7.14.1.- Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media).
- 2.7.14.2.- Ajuste automático de la presión de acuerdo al tipo de paciente seleccionado.
- 2.7.14.3.- Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.
- 2.7.15.- Respiración.
- 2.7.15.1.- Curva de respiración.
- 2.7.15.2.- Despliegue numérico de frecuencia respiratoria.
- 2.7.16.- Presión arterial invasiva.
- 2.7.16.1.- Dos canales de presión invasiva como mínimo.
- 2.7.16.2.- Etiquetado del sitio de medición de los transductores.
- 2.7.16.3.- Ajuste automático de escalas.
- 2.7.17.- Espirometría.
- 2.7.17.1.- Curva de flujo.

- 2.5.5.- Controles y ajuste de: CATALOGO 1 PAGINA 3.
- 2.5.5.1.- Volumen corriente en rango de 20 a 1500 ml modo volumen y SIMV, de 5 a 1500 en modo control por presión. CATALOGO 1 PAGINA 3.
- 2.5.5.2.- Presión límite en rango de 12 a 100 cmH2O. CATALOGO 1 PAGINA 3.
- 2.5.5.3.- Presión inspiratoria en rango de 5 a 60 cmH2O. CATALOGO 1 PAGINA 3.
- 2.5.5.4.- Frecuencia respiratoria en rango de 4 a 100 respiraciones por minuto. CATALOGO 1 PAGINA 3.
- 2.5.5.5.- PEEP electrónico en rango de 4 a 30 cmH2O. CATALOGO 1 PAGINA 3.
- 2.5.5.6.- Relación I:E y relación I:E inversa. CATALOGO 1 PAGINA 3.
- 2.5.5.7.- Pausa inspiratoria. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-18.
- 2.5.5.8.- Sensibilidad por flujo. CATALOGO 1 PAGINA 3.
- 2.5.5.9.- Presión soporte. CATALOGO 1 PAGINA 3
- 2.5.6.- Despliegue numérico en pantalla del ventilador y del monitor de signos vitales. CATALOGO 1 PAGINA 3, CATALOGO 2 PAGINA 1.

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	102
PARTIDA	41 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA		
CLAVE SAI	531.053.0372.00.01		
CLAVE PREI	00000000017409		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC. (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AESPIRE 7900
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2, MANUAL DE USUARIO 3, MANUAL DE USUARIO 4, MANUAL DE SERVICIO 1.
	HOJA 8 DE 20


DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

2.7.17.2.- Volumen minuto inspirado y/o espirado.
 2.7.17.3.- Volumen corriente, inspirado y espirado.
 2.7.17.4.- Despliegue de lazos: presión/volumen y flujo/volumen con almacenamiento de referencia de al menos un lazo.
 2.7.17.5.-Despliegue numérico de la compliance pulmonar del paciente y/o resistencia de la vía aérea.
 2.7.18.- Gases.
 2.7.18.1.- Despliegue numérico de O2 inspirado y espirado.
 2.7.18.2.- Despliegue numérico de N2O inspirado y espirado.
 2.7.18.3.- Identificación automática de agentes anestésicos.
 2.7.18.4.- Despliegue numérico de la concentración de gas anestésico inspirado y espirado.
 2.7.18.5.-Despliegue numérico de la concentración alveolar mínima (MAC).
 2.7.18.6.- Detección automática de agentes anestésicos simultáneos y despliegue numérico de la concentración más alta.
 2.7.19.- Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles, con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los siguientes parámetros:
 2.7.19.1.- Frecuencia cardíaca.
 2.7.19.2.- CO2.
 2.7.19.3.- Saturación de oxígeno.

2.5.6.1.- Oxígeno inspirado y espirado. CATALOGO 3 PAGINA 2.
 2.5.6.2. Volumen corriente. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 3-29.
 2.5.6.3. Volumen minuto. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 3-29.
 2.5.6.4. Presión media. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 3-29.
 2.5.6.5. Presión pico. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 3-29.
 2.5.6.6. PEEP. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 3-29.
 2.5.6.7. Frecuencia respiratoria. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 3-29.
 2.5.7. Despliegue de curva en pantalla del ventilador. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 3-29.
 2.5.7.1. Presión/Volumen. CATALOGO 3 PAGINA 1.
 2.5.7.2. Flujo/Volumen. CATALOGO 3 PAGINA 1.
 2.5.8.- Sistema de alarmas audibles y visuales priorizadas en tres niveles (despliegue y ajuste en pantalla del ventilador): . MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 3-9. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 4-2.

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail:bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

ANEXO
DIVISION DE CONTRATOS

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	102
PARTIDA	41 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA		
CLAVE SAI	531.053.0372.00.01		
CLAVE PREI	000000000017409		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AESPIRE 7900
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2, MANUAL DE USUARIO 3, MANUAL DE USUARIO 4, MANUAL DE SERVICIO 1.
HOJA 9 DE 20	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.7.19.4.- Temperatura.
 2.7.19.5.- Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica y media).
 2.7.19.6.- Frecuencia respiratoria.
 2.7.19.7.- Presión arterial invasiva.
 2.7.19.8.- Agentes anestésicos.
 2.7.20.- Alarma de apnea.
 2.7.21.- Alarma de arritmia.
 2.7.22.- Con silenciador de alarmas.
 2.8.- Monitorización de I relajación muscular:
 2.8.1.- Modos de estimulación: tren de cuatro, tetánico y estímulo único o simple.
 2.9.- Una manguera de suministro por cada gas de acuerdo al código americano de colores: (02-verde, N20- azul, aire amarillo) con conector para toma mural de acuerdo a la instalación de cada unidad médica. Con regulador de presión externo para O2 y aire, como mínimo. Y trampa de agua para aire.

3. ACCESORIOS: PARA ADULTO/PEDIÁTRICO.
 3.1.- Dos circuitos de paciente reusable y esterilizable con tubos corrugados de al menos 1.2 m de longitud, pieza en "Y" y codo.
 3.2.- Un circuito de paciente neonatal reusable.
 3.3.- Un circuito de reinhalación parcial, tipo Bain, semicerrado o equivalente.

2.5.8.1.- FiO2 (alta y baja). MANUAL DE USUARIO 12 PAGINA 4-9.
 2.5.8.2.- Volumen minuto y/o corriente (alta y baja). MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 4-13, 4-14.
 2.5.8.3.- Presión de vías aéreas (alta y baja). MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 4-10, 4-11.
 2.5.8.4.- Apnea. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 4-4.
 2.5.8.5.- Presión baja de suministro de gas. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 4-11.
 2.5.8.6.- Falla en el suministro eléctrico. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 4-4.
 2.5.8.7.- Cambio de celda de O2. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 3-8, 4-9.
 2.5.8.8.- Fuga en circuito de paciente. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 4-3.
 2.5.8.9.- Falla en sensor de presión. MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 4-6, 4-10.
 2.5.9.- Conmutación a ventilación manual. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-8.
 2.5.10.- Compensación automática de flujo de gas fresco (volumen tidal). CATALOGO 1 PAGINA 1.

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.



BIOABAST S.A. DE C.V.

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	102
PARTIDA	41 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA		
CLAVE SAI	531.053.0372.00.01		
CLAVE PREI	000000000017409		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE			
ESPECIFICACIONES			

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AESPIRE 7900
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2, MANUAL DE USUARIO 3, MANUAL DE USUARIO 4, MANUAL DE SERVICIO 1.
HOJA 10 DE 20	
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE	


- 3.4.- Mascarilla transparente, reusable, libre de látex y esterilizable: Tamaño adulto, pediátrico y neonatal, una de cada una.
- 3.5.- Bolsa para ventilación reusable, esterilizable y libre de látex: una de 1 l, una de 2 l y una de 3 l; +/- 10%. Una de 500 ml para pacientes neonatales.
- 3.6.- Un cable troncal, un sensor tipo dedal y un sensor multisitio, ambos reusables, para oximetría de pulso.
- 3.7.- Un sensor reusable de temperatura (de piel o de superficie) y un sensor de temperatura esofágico o rectal.
- 3.8.- Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva, adulto, adulto obeso, pediátrico una de cada una y dos tamaño neonatal en dos medidas diferentes, manquera con conector para los brazaletes.
- 3.9.- Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos de cinco puntas. Para paciente neonatal un cable troncal y un cable de paciente para ECG de tres puntas.
- 3.10.- Para CO2 por técnica mainstream: sensor reusable y cable, adaptador de vías aéreas reusable o 20 adaptadores de vías aéreas desechables.
- 3.11.- Para CO2 por técnica sidestream: 10 trampas de agua (en caso de requerirse), 20 líneas de muestra y adaptadores endotraqueales.
- 3.12.- Para CO2 por técnica microstream: 20 líneas de muestra y adaptadores endotraqueales.

- 2.5.11.- Indicador de fuente de alimentación, AC o DC. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 2-12, 3-3.
- 2.5.12.- Indicador batería baja. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 3-3, MANUAL DE USUARIO 2 PAGINA 4-4.
- 2.6.- Sistema de comprobación que verifique el funcionamiento neumático y electrónico de la unidad de anestesia. MANUAL DE USUARIO 1 PAGINA 3-3, 3-4, 4-11.
- 2.7.1.- Monitor modular. CATALOGO 2 PAGINA 1.
- 2.7.2.- Pantalla sensible al tacto y perilla selectora. CATALOGO 2 PAGINA 2.
- 2.7.3.- Pantalla policromática de tecnología LCD TFT, de 15". CATALOGO 2 PAGINA 2.
- 2.7.4.- Salida analógica de ECG. MANUAL DE USUARIO 4 PAGINA 165.
- 2.7.5.- Despliegue de curvas fisiológicas, de 8 curvas simultáneas y hasta 14 con superposición. CATALOGO 2 PAGINA 2.
- 2.7.6.- Despliegue de mensajes y parámetros en español. MANUAL DE USUARIO 4 PAGINA 105
- 2.7.7.- Tendencias gráficas y numéricas para todos los parámetros, de 24 horas. MANUAL DE USUARIO 4 PAGINA 89, 91.

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	102
PARTIDA	41 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA		
CLAVE SAI	531.053.0372.00.01		
CLAVE PREI	000000000017409		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AESPIRE 7900
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2, MANUAL DE USUARIO 3, MANUAL DE USUARIO 4, MANUAL DE SERVICIO 1.
	HOJA 11 DE 20

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

<p>3.13 Para medición de la presión invasiva incluir al menos: 2 cables troncales para transductor.</p> <p>3.14 Para la monitorización de la relajación muscular: Sensor adulto pediátrico.</p> <p>4. CONSUMIBLES.</p> <p>4.1.- (100 pzas.) Electrodo para ECG adulto / Pediátrico 50 neonatales.</p> <p>4.2.- Filtro para sistema de evacuación de gases (uno)</p> <p>4.3.- Electrodo para estimulación neuromuscular (10 piezas).</p> <p>4.4.- Kits para transductor (10 kits).</p> <p>5. REFACCIONES:</p> <p>5.1. No requiere</p> <p>6. INSTALACION.</p> <p>6.1 Eléctrica: 120 V +/- 10% , 60 Hz.</p> <p>6.2 Neumática: Aire, oxígeno, N2O.</p> <p>7. MANTENIMIENTO:</p> <p>7.1. Programa calendarizado o calendario de servicios, que incluya la descripción de las acciones a efectuar.</p> <p>7.1. NORMAS-CERTIFICADOS: Presentar de forma independiente para monitor de signos vitales, máquina de anestesia.</p>
--

<p>2.7.8.- Batería de respaldo interna con capacidad de 120 min. CATALOGO 2 PAGINA 4.</p> <p>2.7.9.- Monitoreo de los siguientes parámetros desplegados en el monitor de signos vitales y en el ventilador: CATALOGO 1 PAG.3 Y CATALOGO 2 PAG. 1.</p> <p>2.7.10.- ECG. CATALOGO 5 PAGINA 2.</p> <p>2.7.10.1.- Despliegue numérico de frecuencia cardiaca. CATALOGO 5 PAGINA 2.</p> <p>2.7.10.2.- Hasta 12 derivaciones seleccionables por el usuario. CATALOGO 5 PAGINA 2.</p> <p>2.7.10.3.- Despliegue simultáneo de tres curvas a elegir de, 12 derivaciones de ECG. CATALOGO 5 PAGINA 2. MANUAL DE USUARIO 4 PAGINA 168.</p> <p>2.7.10.4.- Análisis del segmento ST, Segmento ST medido y mostrado simultáneamente para hasta 12 derivaciones de ECG. CATALOGO 5 PAGINA 2.</p> <p>2.7.10.5.- Análisis de arritmias. CATALOGO 5 PAGINA 1.</p> <p>2.7.10.6.- Control de activación de filtros en la señal. CATALOGO 5 PAGINA 2..</p>

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

Licitación Pública Internacional
 Consolidada Bajo la Cobertura de
 Los Tratados de Libre Comercio
 No. LA-019GYR040-T23-2015,
 para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

**ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	102
PARTIDA	41 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA		
CLAVE SAI	531.053.0372.00.01		
CLAVE PREI	00000000017409		
	NOMBRE GENÉRICO		
	ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE		

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AESPIRE 7900
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2, MANUAL DE USUARIO 3, MANUAL DE USUARIO 4, MANUAL DE SERVICIO 1.

ESPECIFICACIONES

HOJA 12 DE 20
 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

7.1.1. Para producto de origen nacional: certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS e ISO 13485
 7.1.2. Para producto extranjero: que cumpla con ISO 13485 y algunos e los siguientes: FDA, CE o JIS.

2.7.10.7.- Detección de marcapasaos. CATALOGO 5 PAGINA 2.
 2.7.10.8.- Protección contra descarga de desfibrilador. CATALOGO 5 PAGINA 2.
 2.7.11.- CO2. CATALOGO 3 PAGINA 2.
 2.7.11.1.- Por medio de Sidestream. MANUAL DE USUARIO 4 PAGINA 250.
 2.7.11.2.- Despliegue de curva y valores numéricos inspirado y espirado. CATALOGO 3 PAGINA 2.
 2.7.12. SpO2. CATALOGO 5 PAGINA 3.
 2.7.12.1.- Curva de pletismografía. CATALOGO 5 PAGINA 3.
 2.7.12.2.- Despliegue numérico de saturación de oxígeno. CATALOGO 5 PAGINA 3.
 2.7.13.- Temperatura en 2 canales. CATALOGO 5 PAGINA 3.
 2.7.13.1.- Despliegue numérico de ambas temperaturas de manera simultanea y diferencia entre ellas (T2-T1). CATALOGO 5 PAGINA 3.
 2.7.14.- Presión arterial no invasiva. CATALOGO 5 PAGINA 3.
 2.7.14.1.- Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). CATALOGO 5 PAGINA 3.



BIOABAST S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	102
PARTIDA	41 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA		
CLAVE SAI	531.053.0372.00.01		
CLAVE PREI	00000000017409		
	NOMBRE GENÉRICO		
	ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE		


ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AESPIRE 7900
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2, MANUAL DE USUARIO 3, MANUAL DE USUARIO 4, MANUAL DE SERVICIO 1.

HOJA 13 DE 20

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

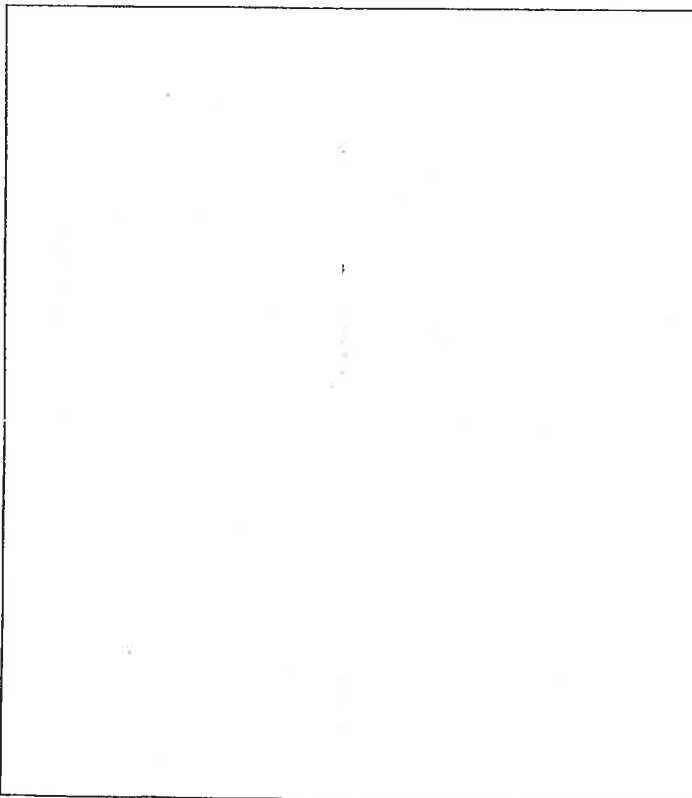

2.7.14.2.- Ajuste automático de la presión de acuerdo al tipo de paciente seleccionado. CATALOGO 5 PAGINA 3. MANUAL DE USUARIO 4 PAGINA 211.

2.7.14.3.- Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. CATALOGO 5 PAGINA 3.

2.7.15.- Respiración. CATALOGO 5 PAGINA 2.

2.7.15.1.- Curva de respiración. MANUAL DE USUARIO 4 PAGINA 196.

2.7.15.2.- Despliegue numérico de frecuencia respiratoria. CATALOGO 5 PAGINA 2.

2.7.16.- Presión arterial invasiva. CATALOGO 5 PAGINA 2.

2.7.16.1.- Dos canales de presión invasiva. MANUAL DE USUARIO 4 PAGINA 218.


2.7.16.2.- Etiquetado del sitio de medición de los transductores. MANUAL DE USUARIO 4 PAGINA 222.

2.7.16.3.- Ajuste automático de escalas. MANUAL DE USUARIO 4 PAGINA 222.

2.7.17.- Espirometría. CATALOGO 3 PAGINA 3.

2.7.17.1.- Curva de flujo y presión. CATALOGO 3 PAGINA 3.

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

Licitación Pública Internacional
 Consolidada Bajo la Cobertura de
 Los Tratados de Libre Comercio
 No. LA-019GYR040-T23-2015,
 para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

**ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	102
PARTIDA	41 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA		
CLAVE SAI	531.053.0372.00.01		
CLAVE PREI	000000000017409		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AESPIRE 7900
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2, MANUAL DE USUARIO 3, MANUAL DE USUARIO 4, MANUAL DE SERVICIO 1.
	HOJA 14 DE 20

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

--

<p>2.7.17.2.- Volumen minuto inspirado y espirado. CATALOGO 3 PAGINA 3. MANUAL DE USUARIO 4 PAGINA 264.</p> <p>2.7.17.3.- Volumen corriente inspirado y espirado. CATALOGO 3 PAGINA 3. MANUAL DE USUARIO 4 PAGINA 264.</p> <p>2.7.17.4.- Despliegue de lazos: presión/volumen y flujo/volumen con almacenamiento de referencia de hasta 6 lazos. CATALOGO 2 PAGINA 1, 3.</p> <p>2.7.17.5.-Despliegue numérico de la compliance pulmonar del paciente y resistencia de la via aérea. CATALOGO 3 PAGINA 1, 3.</p> <p>2.7.18.- Gases. CATALOGO 3 PAGINA 1.</p> <p>2.7.18.1.-Despliegue numérico de O2 inspirado y espirado. CATALOGO 3 PAGINA 1, 2.</p> <p>2.7.18.2.-Despliegue numérico de N2O inspirado y espirado. CATALOGO 3 PAGINA 1, 2.</p> <p>2.7.18.3.- Identificación automática de agentes anestésicos. CATALOGO 3 PAGINA 1.</p> <p>2.7.18.4.-Despliegue numérico de la concentración de gas anestésico inspirado y espirado. CATALOGO 3 PAGINA 1.</p>

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail:bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

ANEXO
DIVISION DE CONTRATOS

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	102
PARTIDA	41 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA		
CLAVE SAI	531.053.0372.00.01		
CLAVE PREI	000000000017409		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AESPIRE 7900
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2, MANUAL DE USUARIO 3, MANUAL DE USUARIO 4, MANUAL DE SERVICIO 1.
	HOJA 15 DE 20

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

--

<p>2.7.18.5.-Despliegue numérico de la concentración alveolar mínima (MAC). CATALOGO 3 PAGINA 1.</p> <p>2.7.18.6.- Detección automática de agentes anestésicos simultáneos y despliegue numérico de la concentración más alta. CATALOGO 3 PAGINA 1. MANUAL DE USUARIO 4 PAGINA 257.</p> <p>2.7.19.- Alarmas audibles y visibles, priorizadas en tres niveles, con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los siguientes parámetros: CATALOGO 2 PAGINA 3. MANUAL DE USUARIO 4 PAGINA 45.</p> <p>2.7.19.1.- Frecuencia cardíaca. MANUAL DE USUARIO 4 PAGINA 173.</p> <p>2.7.19.2.- CO2. CATALOGO 3 PAGINA 2.</p> <p>2.7.19.3.- Saturación de oxígeno. MANUAL DE USUARIO 4 PAGINA 208.</p> <p>2.7.19.4.- Temperatura. MANUAL DE USUARIO 4 PAGINA 233.</p> <p>2.7.19.5.- Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica y media). MANUAL DE USUARIO 4 PAGINA 216.</p> <p>2.7.19.6.- Frecuencia respiratoria. MANUAL DE USUARIO 4 PAGINA 200.</p> <p>2.7.19.7.- Presión arterial invasiva. MANUAL DE USUARIO 4 PAGINA 224.</p>
--

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO,D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail:bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

**ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	102
PARTIDA	41 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA		
CLAVE SAI	531.053.0372.00.01		
CLAVE PREI	000000000017409		
	NOMBRE GENÉRICO		
	ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE		

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AESPIRE 7900
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2, MANUAL DE USUARIO 3, MANUAL DE USUARIO 4, MANUAL DE SERVICIO 1.
	HOJA 16 DE 20


DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

--

<p>2.7.19.8.- Agentes anestésicos. CATALOGO 3 PAGINA 2.</p> <p>2.7.20.- Alarma de apnea. CATALOGO 3 PAGINA 2.</p> <p>2.7.21.- Alarma de arritmia. MANUAL DE USUARIO 4 PAGINA 182.</p> <p>2.7.22.- Con silenciador de alarmas. CATALOGO 2 PAGINA 3.</p> <p>2.8.- Monitorización de la relajación muscular: CATALOGO 4 PAGINA 1.</p> <p>2.8.1.- Modos de estimulación: tren de cuatro estímulos (TOF), contracción aislada (ST), estimulación en doble ráfaga (DBS) y estimulación tetánica. CATALOGO 4 PAGINA 1.</p> <p>2.9.- Una manguera de suministro por cada gas de acuerdo al código americano de colores: (O2-verde, N20-azul, aire amarillo) con conector para toma mural de acuerdo a la instalación de cada unidad médica. Con regulador de presión externo para O2 y aire. Y trampa de agua para aire. CATALOGO 7 PAGINA 2, 4. CATALOGO 8 PAGINA 3.</p> <p>3. ACCESORIOS: PARA ADULTO/PEDIÁTRICO.</p>

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail:bioabast.clients@gmail.com



ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	102
PARTIDA	41 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA		
CLAVE SAI	531.053.0372.00.01		
CLAVE PREI	000000000017409		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AESPIRE 7900
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2, MANUAL DE USUARIO 3, MANUAL DE USUARIO 4, MANUAL DE SERVICIO 1.
	HOJA 17 DE 20

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

--

<p>3.1.- Dos circuitos de paciente reusable y esterilizable con tubos corrugados de 1.2 m de longitud, pieza en "Y" y codo. CATALOGO 7 PAGINA 3. CATALOGO 8 PAGINA 2.</p> <p>3.2.- Un circuito de paciente neonatal reusable. CATALOGO 8 PAGINA 2.</p> <p>3.3.- Un circuito de reinhalación parcial, tipo Bain. CATALOGO 7 PAGINA 2.</p> <p>3.4.- Mascarilla transparente, reusable, libre de látex y esterilizable: Tamaño adulto, pediátrico y neonatal, una de cada una. CATALOGO 7 PAGINA 3.</p> <p>3.5.- Bolsa para ventilación reusable, esterilizable y libre de látex: una del 1l, una del 2l y una de 3l. Una de 500 ml para pacientes neonatales. CATALOGO 7 PAGINA 3.</p> <p>3.6.- Un cable troncal, un sensor tipo dedal y un sensor multisitio, ambos reusables, para oximetría de pulso. CATALOGO 6 PAGINA 6.</p> <p>3.7.- Un sensor reusable de temperatura (de piel) y un sensor de temperatura esofágico. CATALOGO 6 PAGINA 8.</p> <p>3.8.- Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva, adulto, adulto obeso, pediátrico una de cada una y dos tamaño</p>



BIOABAST S.A. DE C.V.

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

**ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	102
PARTIDA	41 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA		
CLAVE SAI	531.053.0372.00.01		
CLAVE PREI	00000000017409		
	NOMBRE GENÉRICO		
	ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE		

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AESPIRE 7900
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2, MANUAL DE USUARIO 3, MANUAL DE USUARIO 4, MANUAL DE SERVICIO 1.

HOJA 18 DE 20

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

--

neonatal en dos medidas diferentes, manguera con conector para los brazaletes. CATALOGO 6 PAGINA 2, 7.

3.9.- Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de cinco puntas. Para paciente neonatal un cable troncal y un cable de paciente para ECG de tres puntas. CATALOGO 6 PAGINA 4.

3.10.- Para CO2 por técnica mainstream: sensor reusable y cable, adaptador de vías aéreas reusable o 20 adaptadores de vías aéreas desechables. NO SE OFERTA ESTA TECNOLOGIA.

3.11.- Para CO2 por técnica sidestream: 10 trampas de agua, 20 líneas de muestra y adaptadores endotraqueales. MANUAL DE USUARIO 4 PAGINA 250.

3.12.- Para CO2 por técnica microstream: 20 líneas de muestra y adaptadores endotraqueales. NO SE OFERTA ESTA TECNOLOGIA.

3.13 Para medición de la presión invasiva: 2 cables troncales para transductor. CATALOGO 6 PAGINA 5.

3.14 Para la monitorización de la relajación muscular: Sensor adulto pediátrico. CATALOGO 4 PAGINA 1.

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO,D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail:bioabast.clients@gmail.com



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
BIOABAST S.A. DE C.V.

*Licitación Pública Internacional
 Consolidada Bajo la Cobertura de
 Los Tratados de Libre Comercio
 No. LA-019GYR040-T23-2015,
 para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico*

ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015


PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	102
PARTIDA	41 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA		
CLAVE SAI	531.053.0372.00.01		
CLAVE PREI	00000000017409		
	NOMBRE GENÉRICO		
ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE			

ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AESPIRE 7900
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2, MANUAL DE USUARIO 3, MANUAL DE USUARIO 4, MANUAL DE SERVICIO 1.
HOJA 19 DE 20	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

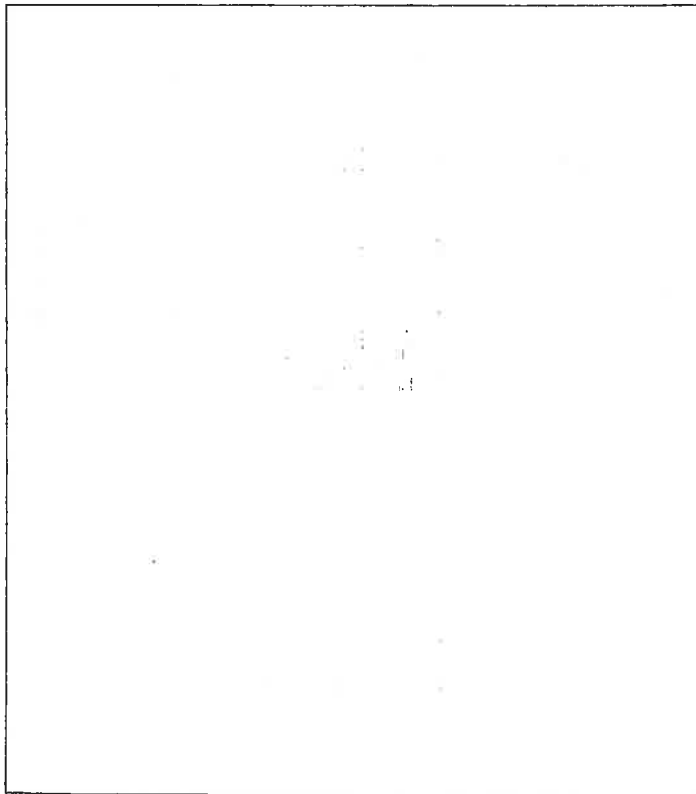


3.15. Sensor de flujo reusable (dos piezas). CATALOGO 7 PAGINA 2. AGREGADO SEGÚN PRECISION TECNICO MEDICAS.
 3.16. Celda para oxigeno (una pieza). CATALOGO 7 PAGINA 2. AGREGADO SEGÚN PRECISION TECNICO MEDICAS.

4. CONSUMIBLES.
 4.1.- (100 pzas.) Electrodo para ECG adulto / Pediátrico 50 neonatales. CATALOGO 6 PAGINA 9.
 4.2.- Filtro para sistema de evacuación de gases (uno). NO APLICA, SE OFERTA SISTEMA DE EVACUACION PASIVO, SEGÚN ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.
 4.3.- Electrodo para estimulación neuromuscular (10 piezas). CATALOGO 6 PAGINA 9.
 4.4.- Kits para transductor (10 kits). MANUAL DE USUARIO 4 PAGINA 218. CATALOGO 6 PAGINA 5.

5. REFACCIONES:
 5.1. No requiere

6. INSTALACION.



BIOABAST S.A. DE C.V.

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

**ANEXO NÚMERO 1-C (UNO-C)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

PROCEDIMIENTO	LA-019GYR040-T23-2015	CANTIDAD	102
PARTIDA	41 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA		
CLAVE SAI	531.053.0372.00.01		
CLAVE PREI	00000000017409		
	NOMBRE GENÉRICO		
	ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE		


ESPECIFICACIONES

LICITANTE	BIOABAST S.A. DE C.V.
FABRICANTE	DATEX-OHMEDA INC./ GE HEALTHCARE FINLAND OY.
MARCA	GENERAL ELECTRIC (propietario de Datex-Ohmeda, Inc.)/GE Healthcare Finland Oy
MODELO	AESPIRE 7900
CATALOGO	CARESCAPE Monitor B650
	CATALOGO 1, CATALOGO 2, CATALOGO 3, CATALOGO 4, CATALOGO 5, CATALOGO 6, CATALOGO 7, CATALOGO 8, MANUAL DE USUARIO 1, MANUAL DE USUARIO 2, MANUAL DE USUARIO 3, MANUAL DE USUARIO 4, MANUAL DE SERVICIO 1.

HOJA 20 DE 20

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

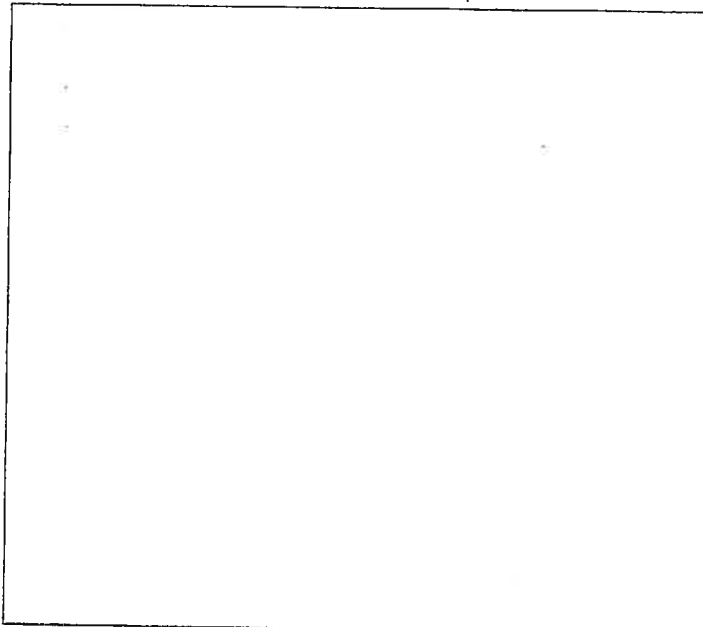

6.1 Eléctrica: 100-120 V , 50/60 Hz.
CATALOGO 1 PAGINA 4.

6.2 Neumática: Aire, oxígeno, N2O.
CATALOGO 1 PAGINA 5.

7. MANTENIMIENTO:

7.1. Programa calendarizado, que incluya la descripción de las acciones a efectuar. SE ANEXA EN PROPUESTA TECNICA.

7.1. NORMAS-CERTIFICADOS: Presentar de forma independiente para monitor de signos vitales, máquina de anestesia. SE ANEXAN EN PROPUESTA TECNICA.

7.1.1. Para producto de origen nacional: certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS e ISO 13485. NO APLICA.

7.1.2. Para producto extranjero: que cumple con ISO 13485 FDA, REGISTRO SANITARIO. SE ANEXAN EN PROPUESTA TECNICA.

México, D.F. a 10 de Agosto de 2015.

Protesto lo necesario

Marycarmen Silva Herrera
Representante Legal

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.PÁG. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

LA-019GYR040-T23-2015

ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)


PROPOSICIÓN ECONÓMICA

licitación	LA-019GYR040-T23-2015	FECHA	10 DE AGOSTO DE 2015
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	BIOABAST, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO	Camino Real a Xochitepec No.108, Col. La Noria, C.P. 16030, Xochimilco, D.F.		
R.F.C.	BIO-090619-UG7		
TELÉFONO Y FAX	56750914, 44444755		
CORREO ELECTRÓNICO	marycarmen.silva@bioabast.com; efren.perez@bioabast.com;		

No.	PRE	SAI	PROCEDENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO MÁXIMO DE REFERENCIA	PORCENTAJE DE DESCUENTO %	PRECIO UNITARIO FINAL	IMPORTE TOTAL
Partida No. 41	17409	531.053.0372.00.01	Estados Unidos de América / Finlandia	UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	102 (Según el Acta de la Junta Aclaratoria)	\$ 693,307.43	28.144	\$ 498,182.98	\$ 50,814,663.96
SUBTOTAL									\$ 50,814,663.96
IVA									\$ 8,130,346.23
TOTAL									\$ 58,945,010.19

TOTAL EN LETRA: CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DIEZ PESOS 19/100
LOS PRECIOS Y PORCENTAJES DE DESCUENTO OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

Protesto lo necesario


Marycarmen Silva Herrera
Representante Legal


CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.P. 16030 TELF.: (55) 56750914, 44444755
44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com

ANEXO 8
DIVISION DE CONTRATOS

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

SIN TEXTO

0



BIOABAST S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA
LA-019GYR040-T23-2015
ELECTRONICA
PARTIDA 41, UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

México, D.F. a 10 de AGOSTO de 2015.

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA
LA-019GYR040-T23-2015
ELECTRONICA
PARTIDA 41, UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA

Punto 7, 7.1.

PARTIDA 41: UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA.

La suscrita Marycarmen Silva Herrera, en mi carácter de representante legal de la empresa BIOABAST, S.A. de C.V., manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

El programa de mantenimiento preventivo de los equipos ofertados bajo esta partida será realizado **cada 6 meses durante el periodo de garantía de los equipos (48 meses)** y corresponderá al siguiente listado (dependiendo de la fecha de instalación) y de acuerdo a lo siguiente:

AÑO 2015	AÑO 2016		AÑO 2017		AÑO 2018
DICIEMBRE	JUNIO	DICIEMBRE	JUNIO	DICIEMBRE	JUNIO
X	X	X	X	X	X
AÑO 2018	AÑO 2019				
DICIEMBRE	JUNIO				
X	X				

Asimismo, anexamos el detalle de los servicios que requiere el equipo ofertado bajo esta partida, y que corresponde a la siguiente rutina:

Procedimiento de mantenimiento preventivo programado

Equipo: Máquina de anestesia


Fabricante: GE

Modelo: Aespire S/5 7900

El presente procedimiento esta basado en:

CAMINO REAL A XOCHITEPÉC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.P.
16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.



BIOABAST S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA
LA-019GYR040-T23-2015
ELECTRONICA
PARTIDA 41, UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA

S/5 Aespire 7900 Anesthesia Machine Technical Reference Manual sección 3 Checkout procedure

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

OBJETIVO:

- REVISIÓN DE CALIBRACIÓN
- SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES INCLUIDOS EN PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO
- VERIFICACIÓN OPERACIONAL DEL SISTEMA
- REQUISITAR DOCUMENTACIÓN DE CONTROL.

Equipo necesario:

Documentos relacionados:

- Manual de operación
- Manual de servicio
- Ordenes de servicio
- Bitácora de servicio
- Formato de PMS
- Etiquetas

Procedimiento

EQUIPO NECESARIO:

- RT 200
- OXÍMETRO
- ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS (RINKEN 102 O SIMILAR)
- PULMÓN DE PRUEBA CON RESISTENCIA Y DISTENSIBILIDAD AJUSTABLE
- HERRAMIENTA GENERAL

DOCUMENTOS RELACIONADOS:

- MANUAL DE OPERACIÓN
- MANUAL DE SERVICIO
- ORDENES DE SERVICIO

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO,D.F. C.P.
16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail:bioabast.clients@gmail.com



- BITÁCORA DE SERVICIO
- FORMATO DE PMS (MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO)

PROCEDIMIENTO

VERIFICACION DEL ESTADO EXTERIOR DEL EQUIPO


1. Revisar que el equipo no muestre golpes así como indicios de líquido derramado.
2. Retirar las cubiertas posteriores y verificar el estado de la tubería interior del sistema neumático.
3. Verificar que las mangueras de suministro de gases se encuentren en buen estado.
4. Revisar las conexiones del sistema de evacuación
5. Revisar el estado físico del teclado de membrana.
6. Revisar el estado físico del cable de línea y clavija.
7. Revisar el buen estado del circuito de paciente
8. Revisar el buen estado y funcionamiento de las perillas de suministro de gases.
9. Revisar el buen estado y funcionamiento de la perilla Comwell del Ventilador.
10. Verificar el funcionamiento del sistema Hipoxico.
11. Verificar el buen estado de los vaporizadores.
12. Verificar el buen estado de los cajones.
13. Verificar el buen estado de las ruedas.
14. Verificar el funcionamiento del freno del equipo.
15. Revisar el buen estado del fuelle y acrílico.
16. Revisar el buen estado del circuito absorbedor.

CONTROL DE FLUJO, ALARMA DE SUMINISTRO DE OXIGENO Y FLUSH

1. Conecte el suministro de gases
2. Cierre completamente las válvulas de flujo de todos los gases

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.



BIOABAST S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA
LA-019GYR040-T23-2015
ELECTRONICA
PARTIDA 41, UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

3. Ponga el selector acgo a abs
4. Encienda el sistema
5. Verifique que el monitor de oxígeno indica 21 % y 100 % en presencia de oxígeno puro
6. En caso necesario calibre el sensor de oxígeno
7. Verifique el flujo mínimo de oxígeno de 175 1 225 ml/min
8. Verifique que los flotadores corren libremente a través de toda la escala
9. Cierre todas las válvulas
10. Abra paulatinamente la válvula de óxido nítrico y verifique que la concentración de oxígeno esta en el rango según la tabla siguiente:

Flujo O ₂ (L/min)	Concentración O ₂
3.0	21% to 30%
2.0	21% to 30%
1.0	21% to 30%
0.2	21% to 30%

ALARMA DE SUMINISTRO DE OXIGENO


1. Coloque todas las válvulas de flujo a 3 litros
2. Desconecte el suministro de oxígeno
3. Asegúrese de que la alarma suena , el suministro de óxido nítrico se interrumpe,
4. Cierre las válvulas y reconecte el oxígeno.

PRUEBA DE FLUSH

1. Ponga el selector bolsa / vent en la posición de bolsa
2. Ponga el sistema en stby
3. Coloque el circuito de paciente y cierre el puerto del paciente
4. Coloque el ACGO a ABS
5. Asegúrese de que el fuelle está completamente colapsado.

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO,D.F. C.P.
16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail:bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA
LA-019GYR040-T23-2015
ELECTRONICA
PARTIDA 41, UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA

6. Mida el tiempo que le toma al fuelle llenarse cuando se presión ael botón de flush
7. Repita la medición dos veces el tiempo debe ser de 1.8 a 2.3 segundos.

VAPORIZADORES BACK PRESSURE

1. Coloque el sistema de evacuación
2. Ponga el selector ACGO a ABS
3. Ponga el selector Bolsa/ vent a bolsa
4. Ajuste la valvula APL al minimo
5. Encienda el interruptor
6. Ponga el flujo de oxigeno a 6 lpm
7. Ajuste la concentración del vaporizador a 1 % el flujo no debe decrementar en más de 1 lpm
8. Pruebe todos los vaporizadores
9. Ponga el sistema a STBY


PRUEBA DEL CIRCUITO CIRCULAR

1. Verifique que el manómetro en el circuito Absorbedor indique cero
2. Asegúrese de que las válvulas funcionan correctamente
3. Verifique que el fuelle no tenga una fuga mayor a 100 ml/min
4. Vaya al menú de servicio y seleccione prueba de fugas la fuga no debe ser mayor a 200ml/min
5. Realice la prueba de válvula APL mediante el menú de servicio.

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.P.
16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA
LA-019GYR040-T23-2015
ELECTRONICA
PARTIDA 41, UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA

VENTILADOR

1. Conecte un pulmón de prueba a la conexión de paciente
2. Seleccione Ventilador mediante el selector bolsa/ventilador
3. Encienda el equipo
4. Ajuste los controles a vol 400 ml, frecuencia 12 bpm, Pmax 40 cmH2O peep off
5. Presione el flush para llenar el fuelle
6. Asegúrese de que la ventilación mecánica inicie.
7. Verifique que el ventilador despliegue los valores correctos
8. Que el Fuelle se desplace correctamente.
9. Ponga un flujo de 5 litros
10. Verifique que el PEEP es cero
11. Verifique que los valores desplegados sean correctos
12. Verifique las alarmas de volumen, alta presión, baja presión, apnea y presión sostenida.
13. Verifique las alarmas de oxígeno.


VERIFICACION ELECTRICA

1. Conecte el suministro de energía
2. Encienda el equipo
3. Desconecte el suministro

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.P.
16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.



4. Asegúrese de que el equipo funciona y un mensaje aparece en la pantalla indicando su operación a Bateria
5. Conecte un dispositivo para pruebas de seguridad eléctrica y verifique que la corriente de fuga sea menor a 300 Micro amperes
6. Verifique que la resistencia del cable de tierra es de 0.2 ohm.

Procedimiento de Mantenimiento Preventivo Programado

EQUIPO: **MONITOR**
FABRICANTE: **GE**
MODELO: **B650**

EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ESTA BASADO EN:

CARESCAPE B650 /B20 USERS REFERENCE MANUAL PART I MAINTENANCE AND CLEANING Y EN CARESCAPE B650/B20 TECHNICAL REFERENCE CAPÍTULO 3 PLANNED MAINTENANCE

OBJETIVO:

- REVISIÓN DE CALIBRACIÓN
- SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES INCLUIDOS EN PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO
- VERIFICACIÓN OPERACIONAL DEL SISTEMA
- REQUISITAR DOCUMENTACIÓN DE CONTROL


EQUIPO NECESARIO:

SIMULADOR DE PACIENTE
HERRAMIENTA GENERAL
EQUIPO DE MEDICIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
MEDIDOR DE PRESIÓN CON TRANSDUCTOR DE 2 BARES
KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAT. 8001760
ACCESORIOS DE ECG, SENSOR DE SpO2, BRAZALETE ADULTO, BRAZALETE INFANTIL MANGUERA INFANTIL, MANGUERA ADULTO, LINEA DE MUESTREO DE 3M, D-LITE
MEDIDOR DE FLUJO.
SILICÓN COMPATIBLE CON O2.
GAS DE CALIBRACIÓN 755583
JERINGA DE ESPIROMETRIA
REGULADOR PARA GAS DE CALIBRACIÓN

DOCUMENTOS RELACIONADOS:

MANUAL DE OPERACIÓN
MANUAL DE SERVICIO

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO,D.F. C.P.
16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail:bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA
LA-019GYR040-T23-2015
ELECTRONICA
PARTIDA 41, UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA

ORDENES DE SERVICIO
BITÁCORA DE SERVICIO
FORMATO DE PMS
ETIQUETAS

PROCEDIMIENTO

1 PRUEBAS GENERALES


- 1.1 REVISE QUE EL MONITOR NO TENGA DEFECTOS VISUALES, COMO GRIETAS O PARTES SUELTAS
- 1.2 REVISE QUE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ CONECTADO A UNA TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y AL MONITOR.
- 1.3 REVISE QUE LA TRAMPA DE AGUA (D-FEND) ESTÁ VACÍA Y COLOCADA CORRECTAMENTE EN SU LUGAR
- 1.4 REVISE QUE LA LÍNEA DE MUESTREO ESTÁ CONECTADA AL MONITOR
- 1.5 REVISE QUE LOS CABLES DE CONEXIÓN DE PACIENTE ESTÁN COLOCADOS A LOS CONECTORES DE ENTRADA DEL MONITOR DE TAL FORMA QUE LOS CÓDIGOS DE COLORES COINCIDAN
- 1.6 REVISE QUE LAS TENDENCIAS DEL PACIENTE ANTERIOR SE BORRAN.
- 1.7 REVISE QUE LOS LÍMITES DE ALARMA SON ADECUADOS PARA EL PACIENTE

INSPECCIÓN FUNCIONAL

1. CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN Y VERIFIQUE QUE EL INDICADOR DE BATERÍA ESTA PARPADEANDO
2. ENCIENDA EL MONITOR Y VERIFIQUE QUE INICIALIZA:
 - LOS INDICADORES DE ALARMAS SE ENCIENDEN Y APAGAN
 - SE ESCUCHA EL SONIDO DE INICIO DE LA BOCINA
 - SE DESPLIEGA LA PANTALLA NORMA Y NO APARECE NINGÚN MENSAJE DE ERROR
 - SE DESPLIEGA LA FECHA Y HORA
 - EL SÍMBOLO DE "BATERÍA CARGANDO" APARECE EN LA ESQUINA SUPERIOR DERECHA DE LA PANTALLA
 - EL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO SE ACTIVA DESPUÉS DE 20 SEG.
 - ENTRAR AL MENÚ DE SERVICIO
3. VERIFICAR QUE LOS VALORES DE VOLTAJE ESTÁN DENTRO DE LOS LÍMITES
4. VERIFICAR EL TIEMPO DE RESPALDO DE LA BATERÍA. DESCONECTAR EL CABLE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. ASEGURARSE QUE EL MONITOR SIGUE TRABAJANDO CON LA BATERÍA AL MENOS 15 MIN. EL INDICADOR DE BATERÍA DEBERÁ APARECER EN LA PANTALLA.

VERIFICACIÓN DE ECG

1. REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO Y SELECCIONAR MODULES - ESTP:ECG Y VERIFICAR QUE:
 - LOS VALORES DE: TIMEOUTS, BAD CHECKSUMS Y BAD C-S BY MOD, NO SE INCREMENTAN A MÁS DE 50/SEG.
 - LA TARJETA DE MEMORIA ECG/RESP, PASA LAS PRUEBAS INTERNAS DE MEMORIA (QUE RAM, ROM Y EEPROM TIENE EL ESTADO OK)
2. CONECTAR UN CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES. VERIFICAR QUE EL CABLE TYPE MUESTRE 5 LEADS.



BIDABAST S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA
LA-019GYR040-T23-2015
ELECTRONICA
PARTIDA 41, UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA

3. VERIFICAR QUE CADA ELECTRODO MUESTRE OFF Y QUE SE DESPLIEGUE EL MENSAJE "CABLES DESCONECTADOS"
CONECTA EL SIMULADOR DE PACIENTE. VERIFICAR QUE SE DESPLIEGUEN LOS PARÁMETROS SEGÚN ESTE CONFIGURADO EL EQUIPO, QUE CORRESPONDAN LAS FORMAS DE ONDA. APAGAR EL SIMULADOR Y VERIFICAR QUE SE MUESTRAN LOS MENSAJES "ASISTOLE" Y "APNEA".

VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA

1. REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO Y SELECCIONAR **ESTP:STP**.
 - VERIFICAR QUE LA TARJETA DE MEMORIA **ESTP:STP**, PASA LAS PRUEBAS INTERNAS DE MEMORIA (QUE **RAM, ROM Y EEPROM** TIENE EL ESTADO **OK**)
2. VERIFICAR LAS CALIBRACIONES DE TEMPERATURA CON LOS CONECTORES DE TEMPERATURA. CALIBRAR SI ES NECESARIO
3. VERIFICAR QUE LA PROTECCIÓN PARA LA CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA ESTÁ ENCENDIDA


VERIFICACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA (NIBP)

1. REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO Y SELECCIONAR **NIBP**
 - VERIFICAR QUE LA TARJETA DE MEMORIA **NIBP**, PASA LAS PRUEBAS INTERNAS DE MEMORIA (QUE **RAM, ROM Y EEPROM** TIENE EL ESTADO **OK**)
2. EN EL MENÚ DE SERVICIO DE **NIBP**, SELECCIONAR **CALIBRACIÓN** Y ACTIVAR LA PRUEBA DE FUGAS PARA CHECAR FUGAS EN EL SISTEMA DE TUBOS, LA PRESIÓN NO DEBERÁ CAER MÁS DE 5 MMHG POR MIN.
3. VERIFICAR LA CALIBRACIÓN CON 200 MMHG DE PRESIÓN Y CALIBRAR SI ES NECESARIO
4. REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO DE **NIBP** Y SELECCIONAR **PNEUMATICS**. VERIFICAR QUE SE ACTIVA EL **WATCHDOG** DE PRESIÓN: LA SEÑAL AUDIBLE DE DEBERÁ ESCUCHAR DE 3 A 8 MMHG. SI ES NECESARIO CALIBRAR
5. REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO DE **NIBP** Y SELECCIONAR **WATCHDOG**. VERIFICAR EL TEMPORIZADOR DEL **WATCHDOG** DE **NIBP**. EL TIEMPO PARA LA PRUEBA INFANTIL SERÁ DE 60 - 70 SEG.
6. REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO DE **NIBP** Y SELECCIONAR **SAFETY VALVE**. VERIFICA QUE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD FUNCIONA CORRECTAMENTE. EL VALOR DE LA PRESIÓN MÁXIMA 2SEG DESPUÉS DE PARARSE PARA AMBOS TRANSDUCTORES SERÁ DE 290 - 330 MMHG PARA ADULTO Y 154 - 165 MMHG PARA INFANTIL.
7. CONECTAR UN BRAZALETE INFANTIL AL MONITOR. INICIAR LA MEDICIÓN Y VERIFICAR QUE SE HA IDENTIFICADO CORRECTAMENTE EL BRAZALETE. CANCELAR LA MEDICIÓN.
8. COLOCAR UN BRAZALETE ADULTO AL BRAZO Y REALIZAR UNA MEDICIÓN. VERIFICAR QUE SE HA IDENTIFICADO CORRECTAMENTE EL BRAZALETE. VERIFICAR QUE EL MODULO DA UN RESULTADO DE MEDICIÓN RAZONABLE

VERIFICACIÓN DE SPO2

1. VERIFICAR QUE SE MUESTRA EN LA PANTALLA "SIN SENSOR", CUANDO EL SENSOR DE SPO2 NO ESTA CONECTADO AL MONITOR. CONECTAR UN SENSOR DE SATURACIÓN AL MONITOR. VERIFICAR QUE SE MUESTRE "SENSOR DESCONECTADO", "CHECAR SENSOR" O "BUSQUEDA DE PULSO".

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO,D.F. C.P.
16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail:bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA
LA-019GYR040-T23-2015
ELECTRONICA
PARTIDA 41, UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA

2. COLOCAR EL SENSOR DE SPO2 AL DEDO Y VERIFICAR QUE SE DESPLIEGA LA FORMA DE ONDA DE PLETISMOGRAFÍA Y UN VALOR DEL RANGO. VERIFICAR QUE EL VALOR DE LA FC ES CALCULADO DE LA SPO2 CUANDO LOS CABLES DE ECG E INVBP (P1/P2) NO ESTÁN CONECTADO.
3. QUITAR EL SENSOR DE SPO2 DEL DEDO Y VERIFICAR QUE SE DESPLIEGA "SENSOR DESCONECTADO" O "CHECAR SENSOR".
4. DESCONECTAR EL SENSOR DEL MONITOR Y VERIFICAR QUE SE DESPLIEGA, "SIN SENSOR"

VERIFICACIÓN DE PRESIÓN INVASIVA

1. VERIFICAR LOS CANALES DE PRESIÓN INVASIVA CON UN SIMULADOR DE PACIENTE. LOS VALORES Y FORMAS DE ONDA DEBERÁN CORRESPONDER A LOS AJUSTES DEL SIMULADOR.
2. CALIBRAR SI ES NECESARIO.

VERIFICACIÓN DE GASES

1. VERIFICAR QUE EL VENTILADOR DE LA UNIDAD DE GASES ESTA FUNCIONANDO.
2. REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO Y SELECCIONAR **GAS UNIT-GENERAL**. VERIFICAR QUE SE DESPLIEGA LA CONFIGURACIÓN DEL MODULO DE GAS CORRESPONDIENTE A LA CONFIGURACIÓN DEL MONITOR.
3. REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO DE GAS UNIT Y SELECCIONAR **GASES** VERIFICAR QUE SE DESPLIEGA EL VALOR AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LA PRESIÓN AMBIENTAL ACTUAL (± 20 MMHG)
4. REALIZAR PRUEBA DE FUGAS EN LA LÍNEA DE MUESTREO
5. VERIFICAR QUE EL RANGO DE FLUJO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS SIGUIENTES VALORES:
FLUJO DE MUESTREO (ML/MIN) 180 - 220
FLUJO DE REFERENCIA (ML/MIN) 31 - 45
AJUSTAR EL RANGO DE FLUJO SI ES NECESARIO.
6. REALIZAR LA CALIBRACIÓN DE GASES.

VERIFICACIÓN DE IDENTIFICADOR DE AA

MIENTRAS SE DESPLIEGAN EL MENÚ DE SERVICIO DE GASES, "ALIMENTAR" GAS DE CALIBRACIÓN CONTINUAMENTE AL MENOS 30 SEG Y VERIFICAR QUE SE MUESTRE EN PANTALLA:

- EL ID ES DES
- EL VALOR IDUNREAL ES MÁS BAJO DE 50

SI EL VALOR ES MÁS ALTO, RECALIBRAR LA IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE Y VERIFICAR EL VALOR OTRA VEZ


VERIFICACIÓN DE ESPIROMETRIA

1. REALIZAR LA PRUEBA DE FUGA Y CALIBRACIÓN DE ESPIROMETRÍA (SEGÚN LA SECCIÓN 7.4.9)
2. CON LA LINEA DE MUESTREO COLOCADA EN EL SENSOR D-LITE, RESPIRAR A TRAVÉS DEL LADO ANCHO DEL SENSOR. VERIFICAR QUE LA FORMA DE ONDA DE FLUJO ES HACIA ABAJO CUANDO INHALAS Y HACIA ARRIBA CUANDO EXHALAS.

VERIFICACIÓN DE LÍNEA DE MUESTREO Y D-LITE.

1. BLOQUEA EL EXTREMO DE LA LÍNEA DE MUESTREO CON EL DEDO Y VERIFICA QUE SE DESPLIEGA "LÍNEA DE MUESTREO BLOQUEADA" DESPUES DE 30 SEG.
2. LIBERA EL D-FEND Y VERIFICA QUE SE DESPLIEGA "CHECAR D-FEND", DESPUES DE 30 SEG.

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.P.
16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail:bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA
LA-019GYR040-T23-2015
ELECTRONICA
PARTIDA 41, UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA

3. REPIRA UNA VEZ POR LA LÍNEA DE MUESTREO Y VERIFICA QUE EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LA CURVA DE CO2 ES NORMAL.

PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. REALIZA UNA PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA Y UNA PRUEBA DE CORRIENTE DE FUGA.
2. VERIFICA QUE EL MONITOR FUNCIONA NORMALMENTE DESPUES DE REALIZAR LA PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA.
3. PONER EL MONITOR EN STBY Y DESCONECTAR DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
4. REALIZAR LIMPIEZA SEGÚN MANUAL
5. REQUISITAR DOCUMENTOS DE CONTROL
6. ACTUALIZAR BITÁCORA
7. IMPRESIÓN DE REPORTES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
8. COLOCACIÓN DE ETIQUETAS.

LLENE LA DOCUMENTACION DE CONTROL Y REGRESE EL EQUIPO A FUNCIONAMIENTO.

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dicha disposición para los fines y efectos a que haya lugar.

Atentamente

Marycarmen Silva Herrera
Representante Legal

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015


LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO,D.F. C.P.
16030 TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail:bioabast.clients@gmail.com

1950
1951

SIN TEXTO

1



BIOABAST S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

México, D.F. a 10 de agosto de 2015.

PARTIDA 41: UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA.

P R E S E N T E

El suscrito Marycarmen Silva Herrera, en mi carácter de representante legal de la empresa BIOABAST, S.A. de C.V., manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

14.1.3. Mantenimiento Correctivo y/o Preventivo.

El proveedor proporcionará durante la vigencia de la garantía de los bienes, los servicios de mantenimiento preventivo, así como el correctivo con refacciones nuevas y originales, conforme al programa de mantenimiento preventivo indicado en el manual del fabricante, debiendo incluir la sustitución de las piezas y/o partes a verificar y su cambio, conforme a lo establecido en el manual de servicio de los bienes que le sean adjudicados, sin costo adicional para el(a) Instituto/Secretaría, de manera tal, que permitan su uso permanente y continuo, para lo cual deberá entregar un Programa Calendarizado o el Calendario de servicios, que incluya la descripción de las acciones a efectuarse durante el servicio, el cual deberá proporcionarse por lo menos dos veces al año.

El programa calendarizado de mantenimiento preventivo de los equipos ofertados bajo esta partida será realizado cada 6 meses durante el periodo de garantía de los equipos (48 meses) y corresponderá al siguiente listado (dependiendo de la fecha de instalación) y de acuerdo a lo siguiente:

Año 2015	Año 2016		Año 2017		Año 2018		Año 2019
Diciembre	Junio	Diciembre	Junio	Diciembre	Junio	Diciembre	Junio
X	X	X	X	X	X	X	X

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.P. 16030
TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.



BIOABAST S.A. DE C.V.

*Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico*

Asimismo, anexamos el detalle de los servicios que requiere el equipo ofertado bajo esta partida, y que corresponde a la siguiente rutina:

Procedimiento de mantenimiento preventivo programado

Equipo: Maquina de anestesia

Fabricante: GE

Modelo: Aespire S/5 7900

El presente procedimiento está basado en:

S/5 Aespire 7900 Anesthesia Machine Technical Reference Manual sección 3 Checkout procedure

OBJETIVO:

- REVISIÓN DE CALIBRACIÓN
- SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES INCLUIDOS EN PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO
- VERIFICACIÓN OPERACIONAL DEL SISTEMA
- REQUISITAR DOCUMENTACIÓN DE CONTROL

Equipo necesario:

Documentos relacionados:

- Manual de operación
- Manual de servicio
- Ordenes de servicio
- Bitácora de servicio
- Formato de PMS
- Etiquetas

Procedimiento

EQUIPO NECESARIO:

- RT 200
- OXÍMETRO
- ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS (RINKEN 102 O SIMILAR)
- PULMÓN DE PRUEBA CON RESISTENCIA Y DISTENSIBILIDAD AJUSTABLE
- HERRAMIENTA GENERAL

DOCUMENTOS RELACIONADOS:

- MANUAL DE OPERACIÓN
- MANUAL DE SERVICIO
- ORDENES DE SERVICIO
- BITÁCORA DE SERVICIO
- FORMATO DE PMS (MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO)

PROCEDIMIENTO

VERIFICACION DEL ESTADO EXTERIOR DEL EQUIPO

1. Revisar que el equipo no muestre golpes así como indicios de líquido derramado.
2. Retirar las cubiertas posteriores y verificar el estado de la tubería interior del sistema neumático.

**CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.P. 16030
TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com**



BIOABAST S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

3. Verificar que las mangueras de suministro de gases se encuentren en buen estado.
4. Revisar las conexiones del sistema de evacuación
5. Revisar el estado físico del teclado de membrana.
6. Revisar el estado físico del cable de línea y clavija.
7. Revisar el buen estado del circuito de paciente
8. Revisar el buen estado y funcionamiento de las perillas de suministro de gases.
9. Revisar el buen estado y funcionamiento de la perilla Comwell del Ventilador.
10. Verificar el funcionamiento del sistema Hipoxico.
11. Verificar el buen estado de los vaporizadores.
12. Verificar el buen estado de los cajones.
13. Verificar el buen estado de las ruedas.
14. Verificar el funcionamiento del freno del equipo.
15. Revisar el buen estado del fuelle y acrílico.
16. Revisar el buen estado del circuito absorbedor.

CONTROL DE FLUJO, ALARMA DE SUMINISTRO DE OXIGENO Y FLUSH

1. Conecte el suministro de gases
2. Cierre completamente las válvulas de flujo de todos los gases
3. Ponga el selector acgo a abs
4. Encienda el sistema
5. Verifique que el monitor de oxígeno indica 21 % y 100 % en presencia de oxígeno puro
6. En caso necesario calibre el sensor de oxígeno
7. Verifique el flujo mínimo de oxígeno de 175 1 225 ml/min
8. Verifique que los flotadores corren libremente a través de toda la escala
9. Cierre todas las válvulas
10. Abra paulatinamente la válvula de óxido nitroso y verifique que la concentración de oxígeno está en el rango según la tabla siguiente:

Set the O ₂ flow (L/min)	Measured O ₂
3.0	21% to 30%
2.0	21% to 30%
1.0	21% to 30%
0.3	21% to 30%

ALARMA DE SUMINISTRO DE OXIGENO

1. Coloque todas las válvulas de flujo a 3 litros
2. Desconecte el suministro de oxígeno
3. Asegúrese de que la alarma suena , el suministro de óxido nitroso se interrumpe,
4. Cierre las válvulas y reconecte el oxígeno.

PRUEBA DE FLUSH

1. Ponga el selector bolsa / vent en la posición de bolsa
2. Ponga el sistema en stby
3. Coloque el circuito de paciente y cierre el puerto del paciente
4. Coloque el ACGO a ABS
5. Asegúrese de que el fuelle está completamente colapsado.
6. Mida el tiempo que le toma al fuelle llenarse cuando se presión el botón de flush
7. Repita la medición dos veces el tiempo debe ser de 1.8 a 2.3 segundos.

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO,D.F. C.P. 16030
TEL.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail:bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

*Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico*

VAPORIZADORES BACK PRESSURE

1. Coloque el sistema de evacuación
2. Ponga el selector ACGO a ABS
3. Ponga el selector Bolsa/ vent a bolsa
4. Ajuste la válvula APL al mínimo
5. Encienda el interruptor
6. Ponga el flujo de oxígeno a 6 lpm
7. Ajuste la concentración del vaporizador a 1 % el flujo no debe decrementar en más de 1 lpm
8. Pruebe todos los vaporizadores
9. Ponga el sistema a STBY

PRUEBA DEL CIRCUITO CIRCULAR

1. Verifique que el manómetro en el circuito Absorbedor indique cero
2. Asegúrese de que las válvulas funcionan correctamente
3. Verifique que el fuelle no tenga una fuga mayor a 100 ml/min
4. Vaya al menú de servicio y seleccione prueba de fugas la fuga no debe ser mayor a 200ml/min
5. Realice la prueba de válvula APL mediante el menú de servicio.

VENTILADOR

1. Conecte un pulmón de prueba a la conexión de paciente
2. Seleccione Ventilador mediante el selector bolsa/ventilador
3. Encienda el equipo
4. Ajuste los controles a vol 400 ml, frecuencia 12 bpm, Pmax 40 cmH2O peep off
5. Presione el flush para llenar el fuelle
6. Asegúrese de que la ventilación mecánica inicie.
7. Verifique que el ventilador despliegue los valores correctos
8. Que el Fuelle se desplace correctamente.
9. Ponga un flujo de 5 litros
10. Verifique que el PEEP es cero
11. Verifique que los valores desplegados sean correctos
12. Verifique las alarmas de volumen, alta presión, baja presión, apnea y presión sostenida.
13. Verifique las alarmas de oxígeno.

VERIFICACION ELECTRICA

1. Conecte el suministro de energía
2. Encienda el equipo
3. Desconecte el suministro
4. Asegúrese de que el equipo funciona y un mensaje aparece en la pantalla indicando su operación a Batería
5. Conecte un dispositivo para pruebas de seguridad eléctrica y verifique que la corriente de fuga sea menor a 300 Micro amperes
6. Verifique que la resistencia del cable de tierra es de 0.2 ohm.

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.P. 16030
TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

Procedimiento de Mantenimiento Preventivo Programado

EQUIPO: MONITOR
FABRICANTE: GE
MODELO: B650

EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ESTA BASADO EN:

CARESCAPE B650 /B20 USERS REFERENCE MANUAL PART I MAINTENANCE AND CLEANING Y EN CARESCAPE B650/B20 TECHNICAL REFERENCE CAPÍTULO 3 PLANNED MAINTENANCE

OBJETIVO:

- REVISIÓN DE CALIBRACIÓN
- SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES INCLUIDOS EN PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO
- VERIFICACIÓN OPERACIONAL DEL SISTEMA
- REQUISITAR DOCUMENTACIÓN DE CONTROL.

EQUIPO NECESARIO:

- SIMULADOR DE PACIENTE
- HERRAMIENTA GENERAL
- EQUIPO DE MEDICIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
- MEDIDOR DE PRESIÓN CON TRANSDUCTOR DE 2 BARES
- KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAT. 8001760
- ACCESORIOS DE ECG, SENSOR DE SpO2, BRAZALETE ADULTO, BRAZALETE INFANTIL MANGUERA INFANTIL, MANGUERA ADULTO, LINEA DE MUESTREO DE 3M, D-LITE
- MEDIDOR DE FLUJO.
- SILICÓN COMPATIBLE CON O2.
- GAS DE CALIBRACIÓN 755583
- JERINGA DE ESPIROMETRIA
- REGULADOR PARA GAS DE CALIBRACIÓN

DOCUMENTOS RELACIONADOS:

- MANUAL DE OPERACIÓN
- MANUAL DE SERVICIO
- ORDENES DE SERVICIO
- BITÁCORA DE SERVICIO
- FORMATO DE PMS
- ETIQUETAS

PROCEDIMIENTO

- 1 **PRUEBAS GENERALES**
 - 1.1 REVISE QUE EL MONITOR NO TENGA DEFECTOS VISUALES, COMO GRIETAS O PARTES SUeltas
 - 1.2 REVISE QUE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ CONECTADO A UNA TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y AL MONITOR.
 - 1.3 REVISE QUE LA TRAMPA DE AGUA (D-FEND) ESTÁ VACÍA Y COLOCADA CORRECTAMENTE EN SU LUGAR
 - 1.4 REVISE QUE LA LÍNEA DE MUESTREO ESTÁ CONECTADA AL MONITOR
 - 1.5 REVISE QUE LOS CABLES DE CONEXIÓN DE PACIENTE ESTÁN COLOCADOS A LOS CONECTORES DE ENTRADA DEL MONITOR DE TAL FORMA QUE LOS CÓDIGOS DE COLORES COINCIDAN
 - 1.6 REVISE QUE LAS TENDENCIAS DEL PACIENTE ANTERIOR SE BORRAN.
 - 1.7 REVISE QUE LOS LÍMITES DE ALARMA SON ADECUADOS PARA EL PACIENTE

INSPECCIÓN FUNCIONAL

1. CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN Y VERIFIQUE QUE EL INDICADOR DE BATERÍA ESTA PARPADEANDO
2. ENCIENDA EL MONITOR Y VERIFIQUE QUE INICIALIZA:

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.P. 16030
TEL.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.



BIOABAST S.A. DE C.V.

*Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico*

- LOS INDICADORES DE ALARMAS SE ENCIENDEN Y APAGAN
 - SE ESCUCHA EL SONIDO DE INICIO DE LA BOCINA
 - SE DESPLIEGA LA PANTALLA NORMA Y NO APARECE NINGÚN MENSAJE DE ERROR
 - SE DESPLIEGA LA FECHA Y HORA
 - EL SÍMBOLO DE "BATERÍA CARGANDO" APARECE EN LA ESQUINA SUPERIOR DERECHA DE LA PANTALLA
 - EL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO SE ACTIVA DESPUÉS DE 20 SEG.
 - ENTRAR AL MENÚ DE SERVICIO
3. VERIFICAR QUE LOS VALORES DE VOLTAJE ESTÁN DENTRO DE LOS LÍMITES
 4. VERIFICAR EL TIEMPO DE RESPALDO DE LA BATERÍA. DESCONECTAR EL CABLE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. ASEGURARSE QUE EL MONITOR SIGUE TRABAJANDO CON LA BATERÍA AL MENOS 15 MIN. EL INDICADOR DE BATERÍA DEBERÁ APARECER EN LA PANTALLA.

VERIFICACIÓN DE ECG

1. REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO Y SELECCIONAR **MODULES - ESTP:ECG** Y VERIFICAR QUE:
 - LOS VALORES DE: **TIMEOUTS, BAD CHECKSUMS Y BAD C-S BY MOD**, NO SE INCREMENTAN A MÁS DE 50/SEG.
 - LA TARJETA DE MEMORIA ECG/RESP, PASA LAS PRUEBAS INTERNAS DE MEMORIA (QUE RAM, ROM Y EEPROM TIENE EL ESTADO OK)
2. CONECTAR UN CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES. VERIFICAR QUE EL **CABLE TYPE** MUESTRE 5 LEADS.
3. VERIFICAR QUE CADA ELECTRODO MUESTRE OFF Y QUE SE DESPLIEGUE EL MENSAJE "CABLES DESCONECTADOS" CONECTA EL SIMULADOR DE PACIENTE. VERIFICAR QUE SE DESPLIEGUEN LOS PARÁMETROS SEGÚN ESTE CONFIGURADO EL EQUIPO, QUE CORRESPONDAN LAS FORMAS DE ONDA. APAGAR EL SIMULADOR Y VERIFICAR QUE SE MUESTRAN LOS MENSAJES "ASISTOLE" Y "APNEA".

VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA

1. REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO Y SELECCIONAR **ESTP:STP**.
 - VERIFICAR QUE LA TARJETA DE MEMORIA ESTP:STP, PASA LAS PRUEBAS INTERNAS DE MEMORIA (QUE RAM, ROM Y EEPROM TIENE EL ESTADO OK)
2. VERIFICAR LAS CALIBRACIONES DE TEMPERATURA CON LOS CONECTORES DE TEMPERATURA. CALIBRAR SI ES NECESARIO
3. VERIFICAR QUE LA PROTECCIÓN PARA LA CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA ESTÁ ENCENDIDA

VERIFICACIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA (NIBP)

1. REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO Y SELECCIONAR **NIBP**
 - VERIFICAR QUE LA TARJETA DE MEMORIA NIBP, PASA LAS PRUEBAS INTERNAS DE MEMORIA (QUE RAM, ROM Y EEPROM TIENE EL ESTADO OK)
2. EN EL MENÚ DE SERVICIO DE NIBP, SELECCIONAR **CALIBRACIÓN** Y ACTIVAR LA PRUEBA DE FUGAS PARA CHECAR FUGAS EN EL SISTEMA DE TUBOS, LA PRESIÓN NO DEBERÁ CAER MÁS DE 5 MMHG POR MIN.
3. VERIFICAR LA CALIBRACIÓN CON 200 MMHG DE PRESIÓN Y CALIBRAR SI ES NECESARIO
4. REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO DE NIBP Y SELECCIONAR **PNEUMATICS**. VERIFICAR QUE SE ACTIVA EL WATCHDOG DE PRESIÓN: LA SEÑAL AUDIBLE DE DEBERÁ ESCUCHAR DE 3 A 8 MMHG. SI ES NECESARIO CALIBRAR
5. REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO DE NIBP Y SELECCIONAR **WATCHDOG**. VERIFICAR EL TEMPORIZADOR DEL WATCHDOG DE NIBP. EL TIEMPO PARA LA PRUEBA INFANTIL SERÁ DE 60 - 70 SEG.
6. REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO DE NIBP Y SELECCIONAR **SAFETY VALVE**. VERIFICA QUE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD FUNCIONA CORRECTAMENTE. EL VALOR DE LA PRESIÓN MÁXIMA 2SEG DESPUÉS DE PARARSE PARA AMBOS TRANSDUCTORES SERÁ DE 290 - 330 MMHG PARA ADULTO Y 154 - 165 MMHG PARA INFANTIL.
7. CONECTAR UN BRAZALETE INFANTIL AL MONITOR. INICIAR LA MEDICIÓN Y VERIFICAR QUE SE HA IDENTIFICADO CORRECTAMENTE EL BRAZALETE. CANCELAR LA MEDICIÓN.
8. COLOCAR UN BRAZALETE ADULTO AL BRAZO Y REALIZAR UNA MEDICIÓN. VERIFICAR QUE SE HA IDENTIFICADO CORRECTAMENTE EL BRAZALETE. VERIFICAR QUE EL MÓDULO DA UN RESULTADO DE MEDICIÓN RAZONABLE

VERIFICACIÓN DE SPO2

1. VERIFICAR QUE SE MUESTRA EN LA PANTALLA "SIN SENSOR", CUANDO EL SENSOR DE SPO2 NO ESTA CONECTADO AL MONITOR. CONECTAR UN SENSOR DE SATURACIÓN AL MONITOR. VERIFICAR QUE SE MUESTRE "SENSOR DESCONECTADO", "CHECAR SENSOR" O "BUSQUEDA DE PULSO".

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.P. 16030
TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com



BIOABAST S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico

2. COLOCAR EL SENSOR DE SPO2 AL DEDO Y VERIFICAR QUE SE DESPLIEGA LA FORMA DE ONDA DE PLETISMOGRAFÍA Y UN VALOR DEL RANGO. VERIFICAR QUE EL VALOR DE LA FC ES CALCULADO DE LA SPO2 CUANDO LOS CABLES DE ECG E INVBP (P1/P2) NO ESTÁN CONECTADO.
3. QUITAR EL SENSOR DE SPO2 DEL DEDO Y VERIFICAR QUE SE DESPLIEGA "SENSOR DESCONECTADO" O "CHECAR SENSOR".
4. DESCONECTAR EL SENSOR DEL MONITOR Y VERIFICAR QUE SE DESPLIEGA, "SIN SENSOR"

VERIFICACIÓN DE PRESIÓN INVASIVA

1. VERIFICAR LOS CANALES DE PRESIÓN INVASIVA CON UN SIMULADOR DE PACIENTE. LOS VALORES Y FORMAS DE ONDA DEBERÁN CORRESPONDER A LOS AJUSTES DEL SIMULADOR.
2. CALIBRAR SI ES NECESARIO.

VERIFICACIÓN DE GASES

1. VERIFICAR QUE EL VENTILADOR DE LA UNIDAD DE GASES ESTA FUNCIONANDO.
2. REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO Y SELECCIONAR GAS UNIT-GENERAL. VERIFICAR QUE SE DESPLIEGA LA CONFIGURACIÓN DEL MODULO DE GAS CORRESPONDIENTE A LA CONFIGURACIÓN DEL MONITOR.
3. REGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO DE GAS UNIT Y SELECCIONAR GASES VERIFICAR QUE SE DESPLIEGA EL VALOR AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LA PRESIÓN AMBIENTAL ACTUAL (± 20 MMHG)
4. REALIZAR PRUEBA DE FUGAS EN LA LÍNEA DE MUESTREO
5. VERIFICAR QUE EL RANGO DE FLUJO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS SIGUIENTES VALORES:
FLUJO DE MUESTREO (ML/MIN) 180 - 220
FLUJO DE REFERENCIA (ML/MIN) 31 - 45
AJUSTAR EL RANGO DE FLUJO SI ES NECESARIO.
6. REALIZAR LA CALIBRACIÓN DE GASES.

VERIFICACIÓN DE IDENTIFICADOR DE AA

MIENTRAS SE DESPLIEGAN EL MENÚ DE SERVICIO DE GASES, "ALIMENTAR" GAS DE CALIBRACIÓN CONTINUAMENTE AL MENOS 30 SEG Y VERIFICAR QUE SE MUESTRE EN PANTALLA:

- EL ID ES DES
 - EL VALOR IDUNREAL ES MÁS BAJO DE 50
- SI EL VALOR ES MÁS ALTO, RECALIBRAR LA IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE Y VERIFICAR EL VALOR OTRA VEZ

VERIFICACIÓN DE ESPIROMETRIA

1. REALIZAR LA PRUEBA DE FUGA Y CALIBRACIÓN DE ESPIROMETRÍA (SEGÚN LA SECCIÓN 7.4.9)
2. CON LA LINEA DE MUESTREO COLOCADA EN EL SENSOR D-LITE, RESPIRAR A TRAVÉS DEL LADO ANCHO DEL SENSOR. VERIFICAR QUE LA FORMA DE ONDA DE FLUJO ES HACIA ABAJO CUANDO INHALAS Y HACIA ARRIBA CUANDO EXHALAS.

VERIFICACIÓN DE LÍNEA DE MUESTREO Y D-LITE.

1. BLOQUEA EL EXTREMO DE LA LÍNEA DE MUESTREO CON EL DEDO Y VERIFICA QUE SE DESPLIEGA "LINEA DE MUESTREO BLOQUEADA" DESPUES DE 30 SEG.
2. LIBERA EL D-FEND Y VERIFICA QUE SE DESPLIEGA "CHECAR D-FEND", DESPUES DE 30 SEG.
3. REPIRA UNA VEZ POR LA LÍNEA DE MUESTREO Y VERIFICA QUE EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LA CURVA DE CO2 ES NORMAL


PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. REALIZA UNA PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA Y UNA PRUEBA DE CORRIENTE DE FUGA.
2. VERIFICA QUE EL MONITOR FUNCIONA NORMALMENTE DESPUES DE REALIZAR LA PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA.
3. PONER EL MONITOR EN STBY Y DESCONECTAR DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
4. REALIZAR LIMPIEZA SEGÚN MANUAL
5. REQUISITAR DOCUMENTOS DE CONTROL
6. ACTUALIZAR BITÁCORA
7. IMPRESIÓN DE REPORTES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
8. COLOCACIÓN DE ETIQUETAS.

CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.P. 16030
TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.



BIOABAST S.A. DE C.V.

*Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico*

LLENE LA DOCUMENTACION DE CONTROL Y REGRESE EL EQUIPO A FUNCIONAMIENTO.

Capacidad de servicio local y regional, número de técnicos y nivel de resolución (capacidad):

- BIOABAST, S.A. de C.V., cuenta, para el adecuado respaldo en servicio de los bienes ofrecidos en esta partida, con oficinas en la Ciudad de México, D.F. se cuentan con 8 ingenieros capacitados en fábrica para el manejo del bien, dar mantenimiento correctivo y preventivo.

Base de localización.

- Oficina de la Cd. de México, sita en Camino Real a Xochitepec No. 108, Col. La Noria México, C.P. 16030, Delegación Xochimilco México D.F.; teléfonos 44444756, 44444755, horario de 9:00 hrs a 18:00 hrs de lunes a viernes.

Tiempo de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular)

- Máximo 48 horas hábiles después de recibir su solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo por escrito, para que un ingeniero de servicio esté atendiendo en sitio su requerimiento, reportando fallas con el Ing. Alfonso Romero al correo electrónico control.servicio@bioabast.com, respondiendo con acuse de recibido indicando número de reporte o folio.

El proveedor durante la vigencia de la garantía de los bienes, deberá de realizar las actualizaciones respectivas del software, que permita mantener actualizado el equipo, sin costo adicional para el(a) Instituto/Secretaría.

El mantenimiento correctivo será realizado por el proveedor conforme a las necesidades del equipo, a solicitud del(a) Instituto/Secretaría.

En caso de mantenimiento correctivo de los bienes y que se superen los "Tiempos máximos de reparación o atención de fallas" señalados en el numeral 14.1.2., el servicio no deberá ser interrumpido, se realizará de manera subrogada y los gastos por estos conceptos correrán por cuenta del proveedor.

Todos los gastos que se generen con motivo de la reparación o canje, así como los gastos por concepto de traslado de los derechohabientes, correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del(a) IMSS/SEDENA.

El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al(a) Instituto/Secretaría y/o a terceros.

Para la SEDENA

**CAMINO REAL A XOCHITEPEC No 108 COL. LA NORIA DELEG. XOCHIMILCO, MEXICO, D.F. C.P. 16030
TELF.: (55) 56750914, 44444756, 44444755, R.F.C. BIO-090619-UG7 e-mail: bioabast.clients@gmail.com**



BIOABAST S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

*Licitación Pública Internacional
Consolidada Bajo la Cobertura de
Los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR040-T23-2015,
para la adquisición de: Equipo y Mobiliario Médico*

Adicionalmente, en caso de que el modelo del equipo adquirido se discontinúe, deberá notificar por escrito a la Secretaría, mediante oficio dirigido al Grupo de Mantenimiento de Equipo Médico, ubicado en Blvd. Manuel Ávila Camacho s/n, Col. Lomas de Sotelo, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11200, México, D.F., en un término no mayor a 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al hecho manifestado por parte del fabricante, lo cual deberá estar debidamente acreditado.

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dicha disposición para los fines y efectos a que haya lugar.

ATENTAMENTE

Marycarmen Silva-Herrera
Representante Legal

LICITACIÓN NO. LA-019GYR040-T23-2015

LICITANTE: BIOABAST, S.A. DE C.V.

SIN TEXTO

1



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
15BI0496

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR040-T24-2015

ANEXO 3 (TRES)

"GUÍA DE DISTRIBUCIÓN CON REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y
CAPACITACIÓN Y DOMICILIOS"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 5 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

SIN TEXTO

1



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".

LA-019GYR040-T23-2015

HOSPITAL GENERAL REGIONAL 230 CAMAS EN REYNOSA, TAMAULIPAS.

H.G.R. 230 Camas; Reynosa, Tamaulipas: Carretera Reynosa-San Fernando Km. 102,
Polígono "C" No. 8200, Fraccionamiento las Pirámides, C.P. 88799.

HOSPITAL GENERAL DE ZONA 165 CAMAS EN VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA

H.G.Z. 165 Camas Villa de Álvarez, Colima: Av. Lapsilázuli No. 250, Fraccionamiento
Habitacional El Haya, C.P. 28983.

HOSPITAL GENERAL REGIONAL 250 CAMAS EN LEÓN, GUANAJUATO

H.G.R. 250 Camas, León, Guanajuato: Boulevard Jorge Vértiz Campero No. 1949,
Fraccionamiento San Miguel Rentería, C.P. 37238.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

1

DIVISION OF CONSULS

2014 BTM03 30 JUN 2014

SIN TEXTO

2



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".

LA-019GYR040-T23-2015

ANEXO No. 2

REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN

Partida	TRU	SAI	DESCRIPCIÓN	MOBIL-2015 (compra) Bienes Tangible	EA0 2015 (H.G.R.) 2do Canal Urea Guayaquil	EA0 2015 (H.G.R.) 1er Canal Urea de Alvarado Colonia	EA0 2015	Equipos	SECCHA	Cantidad Total	Ciudad	Identificada	A tener de GARCIA Maldonado y/o varios	A vender	Capacitación Técnica, teórico, o práctica	Cantidad (teórico o práctico)	Capacitación	Plazo de entrega (en días hábiles)	
1	11731	531.217.0243.01.01	VIDEOCOLONOSCOPIO PEDIATRICO		1	1	2			2	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzada	60 días
2	11776	531.324.0151.01.01	ECCARDIOGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO			1	1	1		2	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzada	60 días
3	11781	531.325.0010.01.01	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA UROLOGICA		1	1	2			2	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzada	60 días
4	11784	531.325.0192.01.01	UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA TRANSOPERATORIA		1	1	2			2	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzada	60 días
5	11814	531.341.0499.01.01	UNIDAD RADIOLOGICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE EQUIPO DIGITAL		2	2	4			4	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	SI Req.	SI Req.	Avanzada	60 días
6	11814	531.341.0499.01.01	UNIDAD RADIOLOGICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE EQUIPO DIGITAL CON CR					16		16	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	SI Req.	SI Req.	Avanzada	60 días
7	11872	531.385.1049.01.01	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVES DE ACIDO PERACETICO		1	1	2			2	SI Req.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	SI Req.	Fundamental	90 días
8	11902	531.430.0081.01.01	FOTOCOAGULADOR INTEGRAL PARA RETINA, ESTADO SOLIDO		2	2	4			4	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	60 días
9	11929	531.497.2093.02.01	INCUBADORA PARA RECIENTE NACIDO		2	2	4	43		47	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	60 días
10	11983	531.572.0309.02.01	LAVADORA DESCONTAMINADORA		4	6	9			9	SI Req.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	SI Req.	Fundamental	90 días
11	11986	531.572.0515.01.01	LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR DIRECTO		18	17	35			35	SI Req.	SI Req.	No Req.	SI Req.	SI Req.	SI Req.	SI Req.	Fundamental	90 días
12	11987	531.572.0549.01.01	LAVADORA DE EQUIPO DE INHALOTERAPIA		2	1	3			3	SI Req.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	SI Req.	Fundamental	90 días
13	11988	531.584.0172.01.01	LITOTRIPTOR ELECTROCONDUCTIVO	1	1	2	2			2	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	SI Req.	SI Req.	Avanzada	90 días
14	12034	531.610.5074.03.01	MESA QUIRURGICA PARA UROLOGIA		1	1	2	7		9	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	60 días
15	12037	531.610.5116.01.01	MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA			1	1	10		11	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	60 días
16	12052	531.625.0081.01.01	MICROSCOPIO PARA CIRUGIA RECONSTRUCTIVA		1	1	2			2	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	60 días
17	12056	531.625.0123.02.01	MICROSCOPIO PARA OFTALMO CIRUGIA DE ALTA ESPECIALIDAD	1	1	1	3	1		4	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	60 días
18	12059	531.691.0078.01.01	UNIDAD DE FACOEMULSION		1	1	2		2	4	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	60 días
19	12074	531.670.0080.01.01	UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGICA		1	1	2	2		4	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	60 días
20	12081	531.700.0108.02.01	PLETISMOGRAFO CORPORAL PEDIATRICO ADULTO		1	1	2			2	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	60 días
21	12134	531.829.0243.01.01	SISTEMA DE MEDICION URODINAMICA		1	1	2	1	1	4	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	60 días
22	12176	531.925.0022.01.01	ELECTROENCEFALOGRAFO DE 32 CANALES	1	1	1	3	2		5	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	60 días
23	12180	531.941.0089.01.01	VENTILADOR DE PRESION POSITIVA MECANICO		4	4	8			8	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	90 días
24	12190	531.941.0279.04.01	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO- ADULTO (CON PROTECCION ANTIMAGNETICA)		1	1	1			1	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzada	90 días
25	12192	531.941.0984.01.01	VENTILADOR DE VOLUMEN PARA TRASLADO INTRAHOSPITALARIO		4	5	9	10		19	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	90 días
26	12914	533.787.0181.02.01	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS		8	8	14	4		18	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No req.	60 días
27	16318	531.063.0358.05.01	UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD		2	1	3	6		9	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzada	90 días
28	16342	531.316.0094.03.01	VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE		2	2	4	4		8	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzada	60 días
29	16377	531.252.0033.02.01	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL (SIN FOTOTERAPIA)		9	9	18			18	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	60 días
30	16379	531.497.2083.02.01	INCUBADORA PARA RECIENTE NACIDO/CUNA DE CALOR RADIANTE		7	7	14			14	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	60 días
31	16380	531.761.0207.04.01	RESECTOSCOPIO DE FLUJO CONTINUO CON TORRE		1	1	2			2	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzada	60 días
32	16414	531.941.0989.03.01	VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL- PEDIATRICO-ADULTO, PEDIATRICO-ADULTO AVANZADO		12	8	20	25		45	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzada	90 días
33	16416	531.924.0031.03.01	ULTRASONOGRAFO BASICO		1	1	2	28		29	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzada	60 días
34	16417	531.924.0031.03.01	ULTRASONOGRAFO INTERMEDIO		1	1	2	7		9	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Avanzada	60 días



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

"2015, Año del Generalísimo José María Moscos y Pavón".

LA-019GYR040-T23-2015
 ANEXO No. 2
 REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN

Código	Código	Código	DESCRIPCIÓN	EAO 2015 (U.G.T.)			EAO 2015	Requisitos	SEDESA	Cantidad (Total)	Eléctrica	Mecánica	Atmósferica	Medicinal y/o química	A vapor	Fundamental (según manual o procedimiento)	Calificación (según manual o procedimiento)	Destacada	Tipo de Capacitación	Tiempo de Entrega (Días hábiles)
				150 Camas	150 Camas	150 Camas														
35	16416	531.624.0031.03.01	ULTRASONOGRAFO AVANZADO		2	2	4	10		14	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.		Avanzada	60 días	
36	16416	531.624.0031.03.01	ULTRASONOGRAFO GINECO-OBSTÉTRICO SEGUNDO NIVEL		2	2	4	6		10	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.		Avanzada	60 días	
37	16424	531.924.0031.03.01	ULTRASONOGRAFO GINECO-OBSTÉTRICO TERCER NIVEL		1	1	2			2	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.		Avanzada	60 días	
38	16434	531.791.0031.02.01	RESONANCIA MAGNETICA, INTERMEDIA,		1		1			1	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	SI Req.		Avanzada	90 días	
39	17408	531.053.0384.00.01	UNIDAD DE ANESTESIA BASICA		6	6	11	22		33	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	90 días	
40	17408	531.053.0384.00.01	UNIDAD DE ANESTESIA BASICA PARA RESONANCIA MAGNETICA		1		1			1	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	90 días	
41	17409	531.053.0372.00.01	UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA		8	6	14	90		104	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	90 días	
42	18655	531.941.1012.01.01	VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL NEONATAL		1	1	2	4		6	SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.		Avanzada	90 días	
43	19227	533.786.0018.02.01	REFRIGERADOR CONGELADOR DE 54 PIES CUBICOS		2	6	7			7	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.		No req.	60 días	
44	19234	631.385.0835.04.01	ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO GRANDE (CON DOS PUERTAS: ANTERIOR Y POSTERIOR)		3	2	5			5	SI Req.	SI Req.	No Req.	SI Req.	SI Req.	SI Req.		Fundamental	90 días	
				3	121	112	238	209	3	538										

INDICACIONES	TIPO DE CAPACITACIÓN
No Req	NO REQUERIDA: Por la simplicidad de uso del artículo no se requiere capacitación.
F = FUNDAMENTAL	Capacitación sobre el funcionamiento general, aplica a equipos de baja complejidad tecnológica en los que solo se requiere explicación breve sobre las funciones del equipo. Por su simplicidad en el manejo, el usuario no requiere gran adiestramiento.
I = INTERMEDIA	Cuando además de la anterior, se requiere de un adiestramiento técnico-práctico para la explotación de las funciones.
A = AVANZADA	Además de cubrir de un adiestramiento técnico-práctico para la explotación de las funciones por tratarse de equipos especializados, involucra la instrucción y adiestramiento en aplicaciones clínicas y sobre aquellos factores que garantizan desempeño óptimo, continuo y seguro.



"2015. Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Precisiones Técnico Médicas a la Licitación Pública Internacional No. LA-019GYR040-T23-2015 Electrónica, para la Adquisición de Equipo Médico correspondiente a los Programas de: I. Programa de Equipamiento Asociado a Obra 2015, para las unidades médicas: 1) Hospital General Regional 230 camas en Reynosa Tamaulipas., 2) Hospital General de Zona 165 camas en Villa de Álvarez, Colima., 3) Hospital General Regional 250 camas en León, Guanajuato. II. Programa de reposición (diversas unidades). III. Programa de equipamiento de los escalones del servicio de sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

14	.03.01	VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO, PEDIATRICO-ADULTO AVANZADO									Req.								
41	174 09	531.053.0372 .00.01	UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA	8	6	14	90	104		SI Req.	No Req.	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermedia	90 días
43	192 27	533.786.0018 .02.01	REFRIGERADOR CONGELADOR DE 54 PIES CUBICOS	2	5	7				SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No req.	60 días

DEBE DECIR:

LA-019GYR040-T23-2015
ANEXO No. 2

REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN

Partida	PRE	SAI	DESCRIPCIÓN	H.O.R. 230 Camas Reynosa Tamaulipas	EAO 2015 H. G.R. 250 Camas León Guanajuato	EAO 2015 H. G.Z. 165 Camas Villa de Álvarez, Colima	EAO 2015	Reposición	SEDENA	Camda Total	Electrónica	Hidrosanitaria	A toma de Gas Medicinales y/o vacío	A vapor	Empotrar o fijación a muro, a piso o a techo	Cableado, tubería hidráulica, y/o neumática o drenaje	Desinstalación	Nivel de Capacitación	Tiempo de Entrega (Días naturales)
6.	118 14	531.341.0499 .01.01	UNIDAD RADIOLOGICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE EQUIPO					16		16	SI Req.	No Req.	No Req.	No Req.	SI Req.	SI Req.	SI Req.	Avanzada	90 días



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Precisiones Técnico Médicas a la Licitación Pública Internacional No. LA-019GYR040-T23-2015 Electrónica, para la Adquisición de Equipo Médico correspondiente a los Programas de: I. Programa de Equipamiento Asociado a Obra 2015, para las unidades médicas: 1) Hospital General Regional 230 camas en Reynosa Tamaulipas., 2) Hospital General de Zona 165 camas en Villa de Álvarez, Colima., 3) Hospital General Regional 250 camas en León, Guanajuato. II. Programa de reposición (diversas unidades). III. Programa de equipamiento de los escalones del servicio de sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

10	119 83	531.572.0309 .02.01	DIGITAL. CON CR LAVADORA DESCONTAMIN ADORA		3	5	8	8	Si Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Si Req.		Fundame ntal	90 días
25	121 92	531.941.0964 .01.01	VENTILADOR DE VOLUMEN PARA TRASLADO INTRAHOSPITAL ARIO		4	5	9	5	14	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.		Intermed ia	90 días
32	164 14	531.941.0980 .03.01	VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL- PEDIATRICO- ADULTO, PEDIATRICO- ADULTO AVANZADO		12	8	20	21	41	Si Req.	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.		Avanzad a	90 días
41	174 09	531.053.0372 .00.01	UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA		8	6	14	88	102	Si Req.	No Req.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Intermed ia	90 días
43	192 27	533.785.0018 .02.01	REFRIGERADOR CONGELADOR DE 5.4 PIES CUBICOS		2	5	7	7	7	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.		No req.	60 días
					0	29	28	57	144	0	171						

COMPLEMENTO DE ANEXO NUMERO 2 (DOS)

LA-019GYR040-T23-2015
ANEXO No. 2
EQUIPO ASOCIADO A OBRA
REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Precisiones Técnico Médicas a la Licitación Pública Internacional No. LA-019GYR040-T23-2015 Electrónica, para la Adquisición de Equipo Médico correspondiente a los Programas de: I. Programa de Equipamiento Asociado a Obra 2015, para las unidades médicas: 1) Hospital General Regional 230 camas en Reynosa Tamaulipas., 2) Hospital General de Zona 165 camas en Villa de Álvarez, Colima., 3) Hospital General Regional 250 camas en León, Guanajuato. II. Programa de reposición (diversas unidades). III. Programa de equipamiento de los escalones del servicio de sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Partida	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Tipo de conexión
23	12189	531.941.0089.01.01	VENTILADOR DE PRESION POSITIVA MECANICO	DISS
24	12190	531.941.0279.04.04	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO ADULTO (CON PROTECCION ANTIMAGNETICA)	DISS
25	12192	531.941.0964.01.01	VENTILADOR DE VOLUMEN PARA TRASLADO INTRAHOSPITALARIO	DISS
32	16414	531.941.0980.03.01	VENTILADOR GEOMETRICO NEONATAL PEDIATRICO ADULTO PEDIATRICO ADULTO AVANZADO	DISS
42	18655	531.941.1012.01.01	VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL NEONATAL	DISS

6 COMPLEMENTO DE ANEXO NUMERO 2 (DOS)

LA-019GYR040-T23-2015
N.º 019
BIENES CORRESPONDIENTES PROGRAMA DE REPOSICIÓN
REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN

Partida	Unidad Médica	Domicilio	Tipo de Conexión
25	HGR66 CIUDAD JUAREZ, CHIH	Durango y Roma Reyes Fracc Torres del Sur	Aramed
25	HGSZMF3 CHILPANCINGO, GRO	Av. Miguel Alemán No. 70 Col. Centro C.P. 39610, Chilpancingo, Guerrero	Aramed
25	HGSZMF5 TAXCO, GRO	Av. De los plateros No. 330 Col. Centro C.P. 40200, Taxco, Guerrero	Aramed
25	HGZ1 ZACATECAS, ZAC	Interior Alameda No. 45 Col. Centro C.P. 98000, Zacatecas, Zacatecas, Zacatecas	Puritan
25	UMAE HESP CMMAC PUEBLA, PUE	Calle 2 Norte No. 2004 y 20 Oriente, Col. Centro C.P. 72000, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, Puebla	Aramed
32	HGZ2 AGUASCALIENTES AGS	Av. de los Conos No. 402 Col. Fraccionamiento Ojo saliente C.P. 20190, Aguascalientes, Aguascalientes	Puritan
32	HGZMF8 ENSENADA, BC	Av. Reforma No. 84 Fracc. Bahía C.P. 22880, Ensenada, Baja California Norte	Aramed
32	HGZMF8 ENSENADA, BC	Av. Reforma No. 84 Fracc. Bahía C.P. 22880, Ensenada, Baja California Norte	Aramed



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Precisiones Técnico Médicas a la Licitación Pública Internacional No. LA-019GYR040-T23-2015 Electrónica, para la Adquisición de Equipo Médico correspondiente a los Programas de: I. Programa de Equipamiento Asociado a Obra 2015, para las unidades médicas: 1) Hospital General Regional 230 camas en Reynosa Tamaulipas, 2) Hospital General de Zona 165 camas en Villa de Álvarez, Colima, 3) Hospital General Regional 250 camas en León, Guanajuato. II. Programa de reposición (diversas unidades). III. Programa de equipamiento de los escalones del servicio de sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

32	HGR1-UMAA TIJUANA, BC	Calle Canadá #16801 Col. Río Tijuana Tercera Etapa. C.P. 22226, Tijuana, Baja California Norte	Puritan
32	HGR1 CHIHUAHUA, CHIH	Av. Universidad y García Conde	Aramed
32	HGR1 ACAPULCO, GRO	Av. Ruiz Cofines s/n, Infonavit Alta Progreso Col. Francisco Villa C.P. 39610, Acapulco, Guerrero	Aramed
32	HGZMF42 PUERTO VALLARTA, JAL	Prof. Blvd. Fco. Medina Ascencio No. 2066 Col. Díaz Ordaz C.P. 48310, Puerto Vallarta, Jalisco	Aramed
32	HGR46 LAZARO CARDENAS, JAL	Av. Lázaro Cárdenas y B de Julio Col. Sector Juárez C.P. 44910, Guadalajara, Jalisco	Aramed
32	HGR220 TOLUCA, EDO MEX PTE	Paseo Toluca No. 620 Oriente Col. Vértice C.P. 50140, Toluca de Lerdo, Toluca, Edo. de México	Aramed
32	UMAE HESP CMMAC PUEBLA, PUE	Calle 2 Norte No. 2004 y 20 Oriente Col. Centro C.P. 72000, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, Puebla	Aramed
32	UMAE HE14 CMN VER	Av. Cuauhtémoc, Esq. Cervantes y Padilla S/N Col. Porfirio Díaz C.P. 91810, Veracruz, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave	Puritan
32	UMAE HPEDIATRIA OBLACMINOC, JAL	Balsarío Domínguez No. 723 Col. Independencia Oriente C.P. 41000, Guadalajara, Jalisco	IMSS
42	HGZ33-MONTERREY, NL	Av. Félix U. Gómez y Av. Benigno Juárez S/N, C.P. 64010, Monterrey, Monterrey, Nuevo León	Puritan
42	HGZMF6'SN NICOLAS DL GARZA, NL	Av. Juárez y Carretera a Laredo Col. Ciudad Turbide C.P. 66660, San Nicolás de los Garza, San Nicolás de los Garza, Nuevo León	Aramed
42	UMAE HGO OBLATON UMINO, JAL	Balsarío Domínguez No. 771 Col. Independencia Oriente C.P. 41000, Guadalajara, Jalisco	IMSS
42	UMAE HGP 48 LEON, GRO	Av. México Esquina Paseo de los Insurgentes Col. Los Pájaros C.P. 37320, León, Guanajuato	Aramed

7 ANEXO NUMERO 2 (DOS)

DICE:

ANEXO 2: GUÍA DE DISTRIBUCIÓN
BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE REPOSICIÓN

Partida	Delegación	Unidad Médica	Domicilio	Administrador	Cargo	PREI	SAI	Descripción	Cantidad
17	Sonora	HOSPITAL GENERAL DE ZONA 180 C	Av. Ruiz Cofines s/n, Infonavit Alta Progreso Col. Francisco Villa C.P. 39610, Acapulco, Guerrero	Ing. Vanía Gabriela Fontes Hernández	Ingeniero Biomédico Delegacional	12056	531.626.0123.02.01	Microscopio para oftalmocirugía de alta especialidad.	1