



Se manifiesta que el  
archivo publicado es  
la mejor versión  
disponible con la  
que cuenta el  
Instituto Mexicano  
del Seguro Social.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

**CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES**  
**NÚMERO 16BI0046**  
**HOJA 1 DE 1**

ACUERDO DEL CIAAS	N/A	SESIÓN DEL CIAAS	N/A
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS ELECTRONICA NÚMERO LA-019GYR040-E13-2016		
FUNDAMENTO	ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 25; 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN II, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS FRACCIÓN I Y 46 DE LA LAAASP Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA.		
FECHA DE FALLO	DÍA	MES	AÑO
	2	AGOSTO	2016

PROVEEDOR	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	R.F.C.	CPL-851230-512	REGISTRO PATRONAL IMSS	010-23756-10-7
DOMICILIO (Artículo 49 "RLAASP")	DIAGONAL DE PATRIOTISMO NÚMERO 1, PISO A-2, COLONIA HIPÓDROMO CONDESA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06170, CIUDAD DE MÉXICO				
TELÉFONO(S)	5134-0270, y 5534-3730	FAX	N/D	CORREO ELECTRÓNICO	ventas@casaplarre.com licitaciones@casaplarre.com
ESCRITURA PÚBLICA:	23,533 (CONSTITUTIVA) 105,842 (REFORMA)	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	8 DE ENERO DE 1955 (CONST) 17 DE FEBRERO DE 1986 (REF)	NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO ADOLFO MARTÍNEZ Y GÓMEZ DEL CAMPO (CONST) LICENCIADO JUAN MANUEL ASPRÓN PELAYO (REFORMA)
NOTARÍA PÚBLICA	56 DEL DISTRITO FEDERAL (REFORMA) 186 DEL DISTRITO FEDERAL (REFORMA)	FOLIO MERCANTIL	BAJO EL NÚMERO 309, A FOLIAS 279, VOLUMEN 335, LIBRO 3° (CONSTITUTIVA) 43075 (REFORMA)		
DE AGUERO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN:	COMPRAR, VENDER, REPRESENTAR, IMPORTAR, ENSAMBLAR, REPARAR, INSTALAR, RECONSTRUIR, ACTUALIZAR Y REHABILITAR TECNOLÓGICAMENTE, NEGOCIAR EN CUALQUIER FORMA EQUIPOS Y COMPONENTES DE IMAGENOLÓGIA COMO: RAYOS X, TOMOGRAFÍA, FLUORSCOPIA, ANGIOGRAFÍA, IMPRESORAS TÉRMICAS Y LÁSER, ASÍ COMO EQUIPOS MÉDICOS ELECTRÓNICOS Y DE EMERGENCIA TALES COMO: DESFIBRILADORES, ELECTROENCEFALÓGRAFOS, ELECTROCARDIOGRAFOS, POLÍGRAFOS, MONITORES DE USO MÉDICO, CENTRALES DE MONITOREO Y CARRROS DE EMERGENCIA CON EQUIPO DE REANIMACIÓN.				
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL	ALBERTO PAULINO BASURTO	ESCRITURA PÚBLICA	85,624	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	4 DE FEBRERO DE 2014
NOTARIO PÚBLICO	LICENCIADO JOSÉ EUGENIO CASTAÑEDA ESCOBEDO	NOTARÍA PÚBLICA	211 DEL DISTRITO FEDERAL	FOLIO MERCANTIL	43075*
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES	A LOS 90 (NOVENTA) DÍAS NATURALES POSTERIORES AL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO	LUGAR ENTREGA DE LOS BIENES	CONFORME A LO SEÑALADO EN LA "DIRECTORIO DE UNIDADES Y REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO" INCLUIDA EN EL ANEXO 3 (TRES) DEL PRESENTE CONTRATO		

OBJETO DEL CONTRATO		IMPORTE SIN IVA	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO 2016, CUYAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SE DESCRIBEN EN EL ANEXO 2 (DOS) DE ESTE CONTRATO.		\$325,000.00 (TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)	
<p>"EL INSTITUTO"</p> <p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</p> <p></p> <p>LICENCIADO JOSÉ ROBERTO FLORES BAÑUELOS Apoderado Legal</p>		<p>"EL PROVEEDOR"</p> <p>CASA PLARRE, S.A. DE C.V.</p> <p></p> <p>ALBERTO PAULINO BASURTO Apoderado Legal</p>	
		0% ( ) 16% ( X )	

Este instrumento jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos proporcionados por la División Contratante, correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.

17/08/2016  
CORP/AMHG/CFHL





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES  
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero

16BI0046

## ANEXO 1

"OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN (OLI)"

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **04** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SALE



Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze  
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica  
Presente

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2016

**Oficio de solicitud del área requirente: 095384612930/0384**  
La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$13,223,309.96, entre diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 46 ventiladores de traslado pediátrico, destinados a diversas Unidades Médicas del Instituto.

**Capítulo: Equipamiento**

**Oficio de Liberación de Inversión 2016**

No. 0990016B3010/6BA2/BMI/ 262 / 445

**Descripción de Cartera del Programa y Proyecto de Inversión (PPI) de la SHCP**  
Nombre de Cartera: Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016  
Clave de cartera: 1550GYR0023  
No. de solicitud: 47726  
Unidad Responsable: GYR  
Programa presupuestario: K029  
Fuente financiamiento: 4  
Importe del calendario fiscal: 4,125,729,783  
Localización geográfica: Varios

**Información del HCT del IMSS**  
Tipo OLI: Adquisición  
Proyecto PREI: 15090015  
Acuerdo: ACDO.AS3.HCT.270416/96.P.DF  
Asignación presupuestaria: 1,804,409,105  
Nombre del PPI: Equipo médico

**Autorización de asignación del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) 2016**

Se emite el presente OLI de conformidad a los artículos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fracción II y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.1.2.1.4 del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y al oficio circular 099001670000/837, firmado por el entonces Coordinador de Presupuesto e Información Programática en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisición de Equipamiento del Programa de Inversión Física 2016.

Unidad Responsable del Gasto (URG): 09 Nivel Central  
Número de bienes: 46  
Monto original con IVA: 13,223,309.96

(trece millones doscientos veintitres mil trescientos nueve pesos 96/100 m.n.)


Por tanto, el monto señalado se ha registrado en el Sistema Financiero PREI Millenium para que la URG inicie los procesos de adquisición conforme al Anexo 1 que se adjunta, y con base en los artículos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,  
El Titular



ANEXOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Lic. Edgar Peña Chávez



Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze  
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica  
Presente

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2016

Oficio de solicitud del área requirente: 095384612930/0384

La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$13,223,309.96, entre diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 46 ventiladores de traslado pediátrico, destinados a diversas Unidades Médicas del Instituto.

Capítulo: Equipamiento

Oficio de Liberación de Inversión 2016

No. 0990016B3010/6BA2/BMI/ 262 / 445

### Normatividad

En materia de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendrán de convocar, adjudicar o contratar obras públicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la autorización de inversión en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás legislación aplicable.

Es importante considerar las disposiciones contenidas en el "Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", además de los "Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", para la adquisición en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Cabe precisar que, de acuerdo con lo ordenado en los artículos 42 fracción II y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 42 de su Reglamento y, conforme a los "Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas, de la Administración Pública Federal" emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligatoriedad de reportar el **seguimiento de los programas y proyectos de inversión** a través de la División de Análisis del Programa de Inversión Física, asimismo la información presentada deberá ser congruente con lo reportado en los distintos sistemas electrónicos de dicha Secretaría y el CompraNet de la Secretaría de la Función Pública, por lo que en caso de que no se turne la información del seguimiento del ejercicio de inversión dentro de los plazos establecidos, no se podrá solicitar el registro de cartera de nuevos programas y proyectos de inversión, ni realizar modificaciones a los ya registrados, hasta en tanto no se actualice su seguimiento.

Con copia para:

Mtro. Jorge David Esquinca Anchondo.- Titular de la Unidad de Operación Financiera. (SICGC)  
Lic. José David Méndez Santa Cruz.- Coordinador de Presupuesto e Información Programática. (SICGC)  
Lic. Armando Rivera Téllez.- Coordinador Técnico de Gestión Presupuestaria. (SICGC)  
Lic. Georgina Sánchez Alegría.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Colima /1  
Mtro. Ricardo Carrasco Reyes.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Chiapas /1  
Lic. Victor Manuel Villa Hernández.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Chihuahua /1  
C.P. Victor Manuel Vargas Rivas.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Guanajuato /1  
C.P. Angel Fajardo Torres.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Guerrero /1  
Lic. Francisco Javier Rojas Paredes.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Jalisco /1  
Ing. Israel Torres Serrano.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación México Oriente /1  
C.P. Constanza Zepeda Neri.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación Michoacán /1  
Lic. Federico Javier Moctezuma Santamaría.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Oaxaca /1  
C.P. Manuel Sanromán Vázquez.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Puebla /1  
C.P. Heriberto Verdugo Navarro.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Sonora /1  
C.P. Fernando Ocejo Rodríguez.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación Veracruz Sur /1  
Mtra. Ana Judith Velázquez Guzmán.- Jefa de Servicios de Finanzas en la Delegación D.F. Norte /1



**Mtro. Daniel Saúl Broid Krauze**  
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica  
Presente

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2016

**Oficio de solicitud del área requirente: 095384612930/0384**  
La Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, solicita transferencias compensadas por un monto de \$13,223,309.96, entre diversas Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad; asimismo la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) por un monto idéntico, referente al presupuesto 2016 correspondiente al programa Equipo Médico para la adquisición de 46 ventiladores de traslado pediátrico, destinados a diversas Unidades Médicas del Instituto.

**Capítulo: Equipamiento**

**Oficio de Liberación de Inversión 2016**

No. 0990016B3010/6BA2/BMI/ 262 / 445

- Mtro. Daniel Esteban Ramirez Garcén.- Jefe de Servicios de Finanzas en la Delegación D.F. Sur /1
- Ing. Alfredo Reyes Aguilar.- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HE No. 71 Torreón Coahuila /1
- Lic. Juan Carlos García Rubio.- Encargado del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO Gral. Div. Manuel Avila Camacho Puebla /1
- Lic. Francisco Javier Castillo Molina.- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HE No. 2 Cd. Obregón Sonora /1
- C.P. Nidia Patricia Conde Góngora.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HE CMN Ignacio García Téllez Yucatán /1

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

/1 Se comunica a través de la dirección electrónica establecida para la Delegación o UMAE: <http://11.254.15.166/Seguimiento/Dapif/Menu.html>  
SICGC Se enviará por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.

EPC/APOR/ORL

Volante No. 201600C259

Página 3 de 5



DIRECCIÓN DE FINANZAS  
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA  
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA  
DIVISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL GASTO DE INVERSIÓN

OLI No.: 262/445



MÉXICO  
GOBIERNO FEDERAL

15090015  
13350109

No. de programa o proyecto PREI:  
Cuenta contable PREI:


1550GYR0023  
47726

Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016

Nombre del programa o proyecto :

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac.	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Millonum Presupuesto del Destino del Bien		SAI		PREI	PREI Millonum Control de Compromisos		Moneda autorizada:									
						Municipio / Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo		IGPO-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Perodo Ptal	No. de bienes
53101	Equipo médico	12063398	0000166063	1381	CONJ TORREÓN/UMAE HE N°71.CIE	TORREON	06090015	051901	200200	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09530007	095001	290000	2016M08	3	287,463	862,389.76
53101	Equipo médico	12063399	0000164852	1381	H.G.Z. SINIESTRADO	MANZANILLO	06030003	060101	200200	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09530007	095001	290000	2016M08	1	287,463	287,463.26
53101	Equipo médico	12063400	0000164671	1381	H.G.Z. J.M.F. N°2	UXTLA. GUTIÉRREZ	07010003	070101	200200	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09530007	095001	290000	2016M08	1	287,463	287,463.26
53101	Equipo médico	12063401	0000165721	1381	H.G.Z. J.M.F. N°1	TAPACHULA	07020001	070202	200200	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09530007	095001	290000	2016M08	1	287,463	287,463.26
53101	Equipo médico	12063402	0000164672	1381	H.G.Z. N° 6	CD. JUAREZ, CHIH	08100002	080101	200200	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09530007	095001	290000	2016M08	1	287,463	287,463.26
53101	Equipo médico	12063403	0000165513	1381	H.G.Z. N° 35	CD. JUAREZ, CHIH	08100016	080102	200200	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09530007	095001	290000	2016M08	1	287,463	287,463.26
53101	Equipo médico	12063404	0000165514	1381	H.G.Z. N° 15	CHIHUAHUA	08010028	081301	200200	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09530007	095001	290000	2016M08	1	287,463	287,463.26
53101	Equipo médico	12063405	0000164853	1381	M.U MED FAM -HOSP- NUM9	PENJAMO, GTO.	11160001	112206	200200	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09530007	095001	290000	2016M08	1	287,463	287,463.26
53101	Equipo médico	12063406	0000165098	1381	M.H GRAL ZONA -MF- NUM8	ZHUATLANEJO GR	12130001	120202	200200	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09530007	095001	290000	2016M08	1	287,463	287,463.26
53101	Equipo médico	12063407	0000165264	1381	M. GRAL ZONA -MF- NUM42	ERTO VALLARTA.	14500001	140205	200200	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09530007	095001	290000	2016M08	2	287,463	574,926.52
53101	Equipo médico	12063408	0000165494	1381	M. GRAL ZONA -MF- NUM42	ERTO VALLARTA.	14500001	140205	200200	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09530007	095001	290000	2016M08	1	287,463	287,463.26
53101	Equipo médico	12063409	0000165514	1381	M.H.G.Z. 46	GUADALAJARA JAL	14010062	140502	200200	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09530007	095001	290000	2016M08	3	287,463	862,389.76
53101	Equipo médico	12063410	0000164661	1381	M.H GRAL ZONA NUM 57	CUAUHTILAN	15320001	150101	200200	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09530007	095001	290000	2016M08	1	287,463	287,463.26
53101	Equipo médico	12063411	0000165495	1381	M.H GRAL ZONA NUM 53	MES LOS -LA PAZ-	15800001	150106	200200	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09530007	095001	290000	2016M08	1	287,463	287,463.26
53101	Equipo médico	12063412	0000164447	1381	M.H HOSPITAL REGIONAL 72 NUM4	TLANEPANTLA	15060012	150501	200200	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09530007	095001	290000	2016M08	2	287,463	574,926.52
53101	Equipo médico	12063413	0000164638	1381	M.H GRAL ZONA -MF- NUM4	ZAMORA, MICH.	17130003	170102	200200	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09530007	095001	290000	2016M08	1	287,463	287,463.26
53101	Equipo médico	12063414	0000165285	1381	M.H GRAL ZONA -MF- NUM4	ZAMORA, MICH.	17130003	170102	200200	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09530007	095001	290000	2016M08	1	287,463	287,463.26
53101	Equipo médico	12063415	0000165709	1381	M.H GRAL SUBZONA -MF- NUM7	LA PIEDAD, MICH	17140002	170701	200200	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09530007	095001	290000	2016M08	1	287,463	287,463.26
53101	Equipo médico	12063416	0000164839	1381	M.H GRAL SUBZONA -MF- NUM41	MARIA HUATULCO	21530004	210401	200200	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09530007	095001	290000	2016M08	1	287,463	287,463.26
53101	Equipo médico	12063417	0000165496	1381	M.H TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	PUEBLA, PUE.	22010039	221401	200200	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09530007	095001	290000	2016M08	1	287,463	287,463.26
53101	Equipo médico	12063418	0000164448	1381	M.U MED FAM -HOSP- NUM24	R DE MATAMOROS	22080001	222205	200200	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09530007	095001	290000	2016M08	1	287,463	287,463.26
53101	Equipo médico	12063419	0000155915	1381	M.H GRAL ZONA NUM 8	CABORCA, SON.	27130001	270105	200200	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09530007	095001	290000	2016M08	1	287,463	287,463.26
53101	Equipo médico	12063420	0000164840	1381	M.H GRAL SUBZONA -MF- NUM9	PUERTO PEÑASCO	27150001	270701	200200	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09530007	095001	250000	2016M08	1	287,463	287,463.26
53101	Equipo médico	12063421	0000165710	1381	M.H HOSP ESPECIALIDADES 2 CMN	CAJEME	27050006	271901	200200	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09530007	095001	290000	2016M08	5	287,463	1,437,316.30
53101	Equipo médico	12063422	0000165266	1381	M.H.G.R. 1	ORIZABA	32400001	320501	200200	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09530007	095001	290000	2016M08	1	287,463	287,463.26
53101	Equipo médico	12063423	0000165056	1381	M.HGR No. 1 UMAE ESPE CTRO MED	MERIDA	33010001	331901	200200	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATR	09530007	095001	290000	2016M08	2	287,463	574,926.52

**ANEXOS**  
DIVISION DE CONTRATOS



DIRECCIÓN DE FINANZAS  
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA  
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA  
DIVISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL GASTO DE INVERSIÓN



Clave de Cartera SHCP : 1550GYR0023  
No. solicitud de SHCP : 47726

No. de programa o proyecto PREI : 15090015  
Cuenta contable PREI: 13350109

Nombre del programa o proyecto : Sustitución de equipo médico en Unidades de los tres niveles de atención en el IMSS 2016

OLJ No.: 262/445

Clave COG	Nombre de clave COG	ID de Transac	ID de Solicitud	CUR	Nombre de la Unidad	PREI Millenium Presupuesto del Distrito del Bien				SAI				PREI				PREI Millenium Control de Compromisos				Monto autorizado	
						Municipio Estado	Ubicación	UI	Centro de Costo	CP-O-GEN	ESP	DIF	VAR	ID de Artículo	Descripción	URG	URG Ubicación	UI	Centro de Costo	Periodo Prial	No. de Parcial Bienes	Parcial con IVA	Importe Total con IVA
53101	Equipo médico	12063424	0000184451	1381	M.H. ORTOPEDA	USTAVO A. MADER	35430003	352101	200220	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO	09	09530007	099001	230000	2016M08	1	287,463	287,463.26
53101	Equipo médico	12063425	0000164452	1381	M.H.G.Z. ZITACALCO	ZITACALCO	38530002	390102	200220	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO	09	09530007	099001	230000	2016M08	1	287,463	287,463.26
53101	Equipo médico	12063426	0000164441	1381	M.H.G.Z. VENADOS 1-	BENITO JUAREZ	38530003	390103	200220	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO	09	09530007	099001	230000	2016M08	5	287,463	1,437,316.30
53101	Equipo médico	12063427	0000165057	1381	HERR 2, UMMA VILLA	COYOACAN	39450005	396501	200220	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO	09	09530007	099001	230000	2016M08	1	287,463	287,463.26
53101	Equipo médico	12063428	0000165713	1381	HERR 2, UMMA VILLA	COYOACAN	39450005	396501	200220	531-941	0279	04	01	12190	VENTILADOR DE TRASLADO	09	09530007	099001	230000	2016M08	1	287,463	287,463.26
TOTAL:																			46	8,911,381	13,223,285.56		

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

SALE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES  
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero

16BI0046

## ANEXO 2

“CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO Y PROPUESTA  
ECONÓMICA”.

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 09 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SECRET

**ANEXO 1.2**  
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01	FECHA IMP.: 28/07/2016
CLAVE PREI: 000000000016314	HORA IMP.: 13:37:24
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO	

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

LICITANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN: LA-019GYR040-E13-2016	MODELO: TEC-5631 / AVALO
PARTIDA: 2	CATÁLOGO: FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD: 145	FABRICANTE: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
HOJA 1 DE 13	

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

<b>1. Definición.</b>
1.1. Carro rodable con sistema de freno para realizar las maniobras de reanimación, cardioversión y desfibrilación cardiopulmonar.
<b>2. Descripción.</b>
2.1. Carro rojo de plástico con desfibrilador de onda bifásica con marcapasos y monitoreo multiparamétrico.
2.1.1. Carro de emergencia (incluir marca y modelo)
2.1.1.1. De material plástico o polímero de alto impacto.
2.1.1.2. Dimensiones: longitud entre 78 cm y 97 cm, ancho entre 55 cm y 65 cm. altura entre 90 cm y 100 cm.
2.1.1.3. Con manubrio para su conducción.
2.1.1.4 Cuatro ruedas antiestáticas, giratorias de calidad hospitalaria, de 12.5 cm de diámetro como mínimo.
2.1.1.5. Con sistema de frenado en al menos dos ruedas.

<b>1. Definición.</b>
1.1. Carro rodable con sistema de freno para realizar las maniobras de reanimación, cardioversión y desfibrilación cardiopulmonar. <b><u>FOLLETO 1; MANUAL 2 PÁG. 1-2</u></b>
<b>2. Descripción.</b>
2.1. Carro rojo de plástico con desfibrilador de onda bifásica con marcapasos y monitoreo multiparamétrico. <b><u>FOLLETO 1; MANUAL 2 PÁG. 1-2 Y 1-3</u></b>
2.1.1. Carro de emergencia (CAPSA SOLUTIONS/AVALO) <b><u>FOLLETO 1</u></b>
2.1.1.1. De material plástico de alto impacto. <b><u>FOLLETO 1</u></b>
2.1.1.2. Dimensiones: longitud entre 79 cm, ancho 60 cm. altura 90 cm. <b><u>FOLLETO 1</u></b>
2.1.1.3. Con manubrio para su conducción. <b><u>FOLLETO 1</u></b>
2.1.1.4 Cuatro ruedas antiestáticas, giratorias de calidad hospitalaria, de 12.7 cm de diámetro. <b><u>FOLLETO 1</u></b>
2.1.1.5. Con sistema de frenado en dos ruedas. <b><u>FOLLETO 1</u></b>

# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

### ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016  
 CLAVE PREI: 000000000016314 HORA IMP.: 13:37:24

**NOMBRE GENÉRICO**

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA  
 REANIMACIÓN  
 CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

- 2.1.1.6. Superficie para colocar el desfibrilador-monitor.
- 2.1.1.6.1. Con capacidad de giro.
- 2.1.1.6.2. Con mecanismo para fijar la posición.
- 2.1.1.6.3. Con dispositivo para sujeción del desfibrilador.
- 2.1.1.7. Superficie para la preparación de soluciones.
- 2.1.1.8. Con cuatro cajones como mínimo.
- 2.1.1.8.1. Un cajón con divisores de material resistente y desmontables para la clasificación y separación, cuatro divisiones como mínimo.
- 2.1.1.9. Sistema de seguridad.
- 2.1.1.9.1. Cerradura general para todos los compartimentos, con sistema de sellos de garantía.
- 2.1.1.10. Con poste portavenocllisis ajustable e integrado.

LICITANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C.V MARCA: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS  
 LICITACIÓN: LA-019GYR040-E13-2016 MODELO: TEC-5631 / AVALO  
 PARTIDA: 2 CATÁLOGO FOLLETO 1;  
 CANTIDAD: 145 FABRICANTE NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS  
 HOJA 2 DE 13

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

- 2.1.1.6. Superficie para colocar el desfibrilador-monitor. **FOLLETO 1**
- 2.1.1.6.1. Con capacidad de giro. **FOLLETO 1**
- 2.1.1.6.2. Con mecanismo para fijar la posición. **FOLLETO 1**
- 2.1.1.6.3. Con dispositivo para sujeción del desfibrilador. **FOLLETO 1**
- 2.1.1.7. Superficie para la preparación de soluciones. **FOLLETO 1**
- 2.1.1.8. Con cinco cajones. **FOLLETO 1**
- 2.1.1.8.1. Un cajón con divisores de material resistente y desmontables para la clasificación y separación, cuatro divisiones como mínimo. **FOLLETO 1**
- 2.1.1.9. Sistema de seguridad. **FOLLETO 1**
- 2.1.1.9.1. Cerradura general para todos los compartimentos, con sistema de sellos de garantía. **FOLLETO 1**
- 2.1.1.10. Con poste portavenocllisis ajustable e integrado. **FOLLETO 1**

Patriotismo D.F.  
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
 Col. Hipódromo Condesa  
 C.P. 06170 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 0270  
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.  
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
 Col. Doctores,  
 C.P. 06720 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 3730  
 ventas@casaplarre.com

Monterrey  
 Simón Bolívar No. 1554  
 Col. Mitras Centro  
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
 Tel. 01 81 8346 1473  
 ventas\_mty@casaplarre.com

Guadalajara  
 General Antonio León No. 434 Int. 13  
 Col. Ladrón de GuevarA  
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
 Tel. 01 33 3630 9781  
 ventas\_gdl@casaplarre.com  
 www.casaplarre.com

**ANEXO 1.2**  
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01	FECHA IMP.: 28/07/2016
CLAVE PREI: 000000000016314	HORA IMP.: 13:37:24
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO	

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

LICITANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	MARCA: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN: LA-019GYR040-E13-2016	MODELO: TEC-5631 / AVALO
PARTIDA: 2	CATÁLOGO: FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD: 145	FABRICANTE: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 3 DE 13

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

2.1.1.11. Tabla para masaje cardiaco, con longitud de 50x60cm como mínimo de material ligero, resistente al impacto, inastillable y lavable, montada al carro.
2.1.1.12. Esquinas del carro redondeadas o bordes lisos.
2.1.1.13. Con sistema de sujeción para tanque de oxígeno tipo E.
2.1.2 Reanimador pulmonar manual reusable (referir marca y modelo).
2.1.2.1. Desarmable y esterilizable en vapor.
2.1.2.2. Bolsa de silicona trasparente o semitransparente, libre de latex.
2.1.2.3. Autoinflable.
2.1.2.4. Tamaño adulto:
2.1.2.4.1. Volumen de la bolsa 1500 ml, como mínimo.
2.1.2.5. Tamaño pediátrico.
2.1.2.5.1 Volumen de la bolsa en el rango de 500 a 600ml.

2.1.1.11. Tabla para masaje cardiaco, con longitud de 50x60cm como mínimo de material ligero, resistente al impacto, inastillable y lavable, montada al carro. <b>FOLLETO 1</b>
2.1.1.12. Esquinas del carro redondeadas. <b>FOLLETO 1</b>
2.1.1.13. Con sistema de sujeción para tanque de oxígeno tipo E. <b>FOLLETO 1</b>
2.1.2 Reanimador pulmonar manual reusable (MERLIN MEDICAL / W44525, W4454, W4456). <b>CATALOGO 1 PÁG. 2, 6</b>
2.1.2.1. Desarmable y esterilizable en vapor. <b>MANUAL 1 PÁG. 2, 3 Y 4</b>
2.1.2.2. Bolsa de silicona trasparente libre de latex. <b>CATALOGO 1 PÁG. 3 Y 4</b>
2.1.2.3. Autoinflable: <b>MANUAL 1 PÁG. 2 Y 3</b>
2.1.2.4. Tamaño adulto: <b>MANUAL 1 PÁG. 3</b>
2.1.2.4.1. Volumen de la bolsa 1850 ml. <b>MANUAL 1 PÁG. 3</b>
2.1.2.5. Tamaño pediátrico (NIÑO). <b>MANUAL 1 PÁG. 3</b>
2.1.2.5.1 Volumen de la bolsa en el rango de 585 ml. <b>MANUAL 1 PÁG. 3</b>



# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

### ANEXO 1.2

### DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016  
 CLAVE PREI: 000000000016314 HORA IMP.: 13:37:24

**NOMBRE GENÉRICO**

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

2.1.2.6. Tamaño neonatal.
2.1.2.6.1. Volumen de la bolsa 320ml, como máximo.
2.1.2.7. Mascarillas reusables.
2.1.2.7.1. Tamaño Adulto, pediátrico y neonatal, esterilizables en vapor.
2.1.2.7.2. Rotación de 360° entre la mascarilla y la válvula hacia el paciente.
2.1.2.8. Válvula de no re inhalación de baja resistencia espiratoria.
2.1.2.9. Válvula de seguridad que limite la presión en vías respiratorias a 40 ± 5cm de H2O.
2.1.2.10. Conexión para oxígeno suplementario.
2.1.3. Equipo de intubación orotraquetal (referir marca y modelo).
2.1.3.1. Mango.

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E13-2016	MODELO:	TEC-5631 / AVALO
PARTIDA:	2	CATÁLOGO:	FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	145	FABRICANTE:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 4 DE 13

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

2.1.2.6. Tamaño neonatal (INFANTE). <u>MANUAL 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.6.1. Volumen de la bolsa 320 ml. <u>MANUAL 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.7. Mascarillas reusables. <u>CATALOGO 1 PÁG. 2 Y 4</u>
2.1.2.7.1. Tamaño Adulto, pediátrico y neonatal, esterilizables en vapor. . <u>CATALOGO 1 PÁG. 4</u>
2.1.2.7.2. Rotación de 360° entre la mascarilla y la válvula hacia el paciente. . <u>CATALOGO 1 PÁG. 3</u>
2.1.2.8. Válvula de no re inhalación de baja resistencia espiratoria. <u>MANUAL 1 PÁG. 2 Y 3</u>
2.1.2.9. Válvula de seguridad que limite la presión en vías respiratorias a 40 ± 5cm de H2O. <u>MANUAL 1 PÁG. 2</u>
2.1.2.10. Conexión para oxígeno suplementario. <u>MANUAL 1 PÁG. 2</u>
2.1.3. Equipo de intubación orotraquetal (Laringoscopia) (KAWE / F.O. LED ). <u>CATALOGO 2 PÁG. 1</u>
2.1.3.1. Mango. <u>CATALOGO 2 PÁG. 2</u>

**Patriotismo D.F.**  
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
 Col. Hipódromo Condesa  
 C.P. 06170 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 0270  
 ventas@casaplarre.com

**Cuauhtémoc D.F.**  
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
 Col. Doctores,  
 C.P. 06720 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 3730  
 ventas@casaplarre.com

**Monterrey.**  
 Simón Bolívar No. 1554  
 Col. Mitras Centro  
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
 Tel. 01 81 8346 1473  
 ventas\_mty@casaplarre.com

**Guadalajara**  
 General Antonio León No. 434 Int. 13  
 Col. Ladrón de Guevara  
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
 Tel. 01 33 3630 9781  
 ventas\_gdl@casaplarre.com  
 www.casaplarre.com



### ANEXO 1.2 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01    FECHA IMP.: 28/07/2016
CLAVE PREI: 000000000016314    HORA IMP.: 13:37:24
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>
CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO

#### ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE: <u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</u> MARCA: <u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>
LICITACIÓN: <u>LA-019GYR040-E13-2016</u> MODELO: <u>TEC-5631 / AVALO</u>
PARTIDA: <u>2</u> CATALOGO: <u>FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3</u>
CANTIDAD: <u>145</u> FABRICANTE: <u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>
HOJA 5 DE 13

#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

2.1.3.1.1. Hecho de metal y que no cause corrosión.
2.1.3.1.2. Acabado acanalado o rugoso.
2.1.3.1.3. Compatibles con todos los modelos de hojas.
2.1.3.2. Batería recargable a la corriente de forma directa o con cargador. Cargador de la misma marca del equipo.
2.1.3.3. Iluminación xenón o LED a través de fibra óptica de 2.5 volts como mínimo.
2.1.3.4. Hojas de laringoscopio.
2.1.3.4.1. De acero inoxidable.
2.1.3.4.2. Rectas (Miller) de la misma marca que el mango, juego de 6 piezas de los números 00, 0, 1, 2, 3 y 4.
2.1.3.4.3. Curvas, de la misma marca que el mango, juego de 4 piezas de los números 1, 2, 3 y 4.
2.1.3.5. Estuche para guarda de mangos y hojas.

2.1.3.1.1. Hecho de metal y que no cause corrosión. <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 2</u></b>
2.1.3.1.2. Acabado rugoso (Estriado). <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 2</u></b>
2.1.3.1.3. Compatibles con todos los modelos de hojas. <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 4</u></b>
2.1.3.2. Batería recargable a la corriente de forma directa o con cargador. Cargador de la misma marca del equipo. <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 4 y 7</u></b>
2.1.3.3. Iluminación LED a través de fibra óptica de 3.5 volts. <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 4</u></b>
2.1.3.4. Hojas de laringoscopio. <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 1</u></b>
2.1.3.4.1. De acero inoxidable. <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 1</u></b>
2.1.3.4.2. Rectas (Miller) de la misma marca que el mango, juego de 6 piezas de los números 00, 0, 1, 2, 3 y 4. <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 6</u></b>
2.1.3.4.3. Curvas, de la misma marca que el mango, juego de 4 piezas de los números 1, 2, 3 y 4. <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 5</u></b>
2.1.3.5. Estuche para guarda de mangos y hojas. <b><u>CATALOGO 2 PÁG. 7</u></b>

**ANEXO 1.2  
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016  
CLAVE PREI: 000000000016314 HORA IMP.: 13:37:24

**NOMBRE GENÉRICO**

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

- 2.1.4. Tanque de oxígeno tipo "E" con manómetro y válvula reguladora.
- 2.1.5. Desfibrilador.
  - 2.1.5.1. Para desfibrilación manual y modo semiautomático (modo DEA), cardioversión y monitoreo continuo integrado.
  - 2.1.5.2. Con selector de nivel de energía para Bifásica al menos de 200 Joules.
  - 2.1.5.3. Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un plazo máximo de 60 segundos.
  - 2.1.5.4. Con sistema para probar energía de descarga.
  - 2.1.5.5. Tiempo de carga de 10 segundos o menor para máxima energía.
  - 2.1.5.6. Con selector de modo: cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modo semiautomático (modo DEA).
  - 2.1.5.7. Con capacidad de desfibrilación interna (cirugía de corazón abierto) y externa.

LICITANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C.V MARCA: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS  
LICITACIÓN: LA-019GYR040-E13-2016 MODELO: TEC-5631 / AVALO  
PARTIDA: 2 CATÁLOGO FOLLETO 1;  
CANTIDAD: 145 FABRICANTE NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 6 DE 13

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

- 2.1.4. Tanque de oxígeno tipo "E" con manómetro y válvula reguladora. **FOLLETO 1**
- 2.1.5. Desfibrilador. **MANUAL 2 PORTADA**
  - 2.1.5.1. Para desfibrilación manual y modo semiautomático (modo DEA), cardioversión y monitoreo continuo integrado. **MANUAL 2 PÁG. 1-2**
  - 2.1.5.2. Con selector de nivel de energía para Bifásica al menos de 270 Joules. **MANUAL 2 PÁG. 1-3 , 1-4, 2-2 Y 15-11**
  - 2.1.5.3. Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un plazo de 40 segundos. **MANUAL 2 PÁG. 1-4 Y 6-2-8**
  - 2.1.5.4. Con sistema para probar energía de descarga (Descarga interna). **MANUAL 2 PÁG. 1-4 , 12-6 12-12 , 12-13 , 12-14 Y 15-9**
  - 2.1.5.5. Tiempo de carga de 5 segundos para máxima energía. **MANUAL 2 PÁG.1-4**
  - 2.1.5.6. Con selector de modo: cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modo semiautomático (modo DEA). **MANUAL 2 PÁG. 2-2**
  - 2.1.5.7. Con capacidad de desfibrilación interna (cirugía de corazón abierto) y externa. **MANUAL 2 PÁG.6-0-2**

Patriotismo D.F.  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

Cuahtémoc D.F.  
Av. Cuahtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

Monterrey  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

Guadalajara  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de Guevara  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com

# ANEVOS

## DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 1.2

### DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01    FECHA IMP.: 28/07/2016 CLAVE PREI: 000000000016314    HORA IMP.: 13:37:24
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>  CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

LICITANTE: <u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</u> MARCA: <u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>	LICITACIÓN: <u>LA-019GYR040-E13-2016</u> MODELO: <u>TEC-5631 / AVALO</u>
PARTIDA: <u>2</u>	CANTIDAD: <u>145</u>
FABRICANTE: <u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>	CATALOGO: <u>FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3</u>

HOJA 7 DE 13

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

2.1.6 Marcapasos transcutáneo :
2.1.6.1 Interconstruido usando electrodos autoadheribles.
2.1.6.2 Amplitud del pulso seleccionable en un rango de 10 mA o menor a 140 mA o mayor.
2.1.6.3 Duración del pulso de 40 milisegundos o menor.
2.1.6.4 Frecuencia de marcapasos ajustable en el rango de 40 pulsos por minuto o menor a 170 pulsos por minuto o mayor.
2.1.6.5 Activación por modos: fijo (o asincrónico) y a demanda (o sincrónico).
2.1.6.6 Despliegue de parámetros en pantalla.
2.1.7. Monitor.
2.1.7.1. Pantalla LCD a color o tecnología superior de 14 cm (5.6 pulgadas) como mínimo.
2.1.7.2. Con despliegue numérico y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardíaca,

2.1.6 Marcapasos transcutáneo : <u>MANUAL 2 PÁG.7-5 Y 15-16</u>
2.1.6.1 Interconstruido usando electrodos autoadheribles. <u>MANUAL 1 PÁG. 2-4, 7-8</u>
2.1.6.2 Amplitud del pulso seleccionable en un rango de 8 Ma a 200 mA. <u>MANUAL 2 PÁG. 15-16</u>
2.1.6.3 Duración del pulso de 40 milisegundos. <u>MANUAL 2 PÁG.15-16</u>
2.1.6.4 Frecuencia de marcapasos ajustable en el rango de 30 pulsos por minuto a 180 pulsos por minuto. <u>MANUAL 2 PÁG. 15-16</u>
2.1.6.5 Activación por modos: fijo (o asincrónico) y a demanda (o sincrónico). <u>MANUAL 2 PÁG. 15-3</u>
2.1.6.6 Despliegue de parámetros en pantalla. <u>MANUAL 2 PÁG. 7-5</u>
2.1.7. Monitor. <u>MANUAL 2 PÁG. 8-0-3</u>
2.1.7.1. Pantalla LCD a color de 6.5 pulgadas. <u>MANUAL 2 PÁG. 1-3</u>
2.1.7.2. Con despliegue numérico y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardíaca, despliegue de un trazo de ECG

**Patriotismo D.F.**  
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
 Col. Hipódromo Condesa  
 C.P. 06170 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 0270  
 ventas@casaplarre.com

**Cuauhtémoc D.F.**  
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
 Col. Doctores,  
 C.P. 06720 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 3730  
 ventas@casaplarre.com

**Monterrey**  
 Simón Bolívar No. 1554  
 Col. Mitras Centro  
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
 Tel. 01 81 8346 1473  
 ventas\_mty@casaplarre.com

**Guadalajara**  
 General Antonio León No. 434 Int. 13  
 Col. Ladrón de Guevara  
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
 Tel. 01 33 3630 9781  
 ventas\_gdl@casaplarre.com  
 www.casaplarre.com

**ANEXO 1.2**  
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01    FECHA IMP.: 28/07/2016 CLAVE PREI: 000000000016314    HORA IMP.: 13:37:24
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>  CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

despliegue de un trazo de ECG como mínimo a seleccionar entre 7 derivaciones: (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF y V).
2.1.7.3. Despliegue en pantalla y panel de control en idioma español.
2.1.7.4. Análisis e interpretación de alteraciones del trazo de ECG (arritmias).
2.1.8. Palas
2.1.8.1. Para excitación externa, convertibles adulto/pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica.
2.1.8.2. Con descarga desde las palas y desde el panel de control.
2.1.8.3. Botón de carga desde las palas y desde el panel de control.
2.1.8.4. Con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación.
2.1.9. Alarmas audibles y visibles.
2.1.9.1. Seleccionables por el usuario, para alteraciones en la frecuencia cardiaca y SpO2.

LICITANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN: LA-019GYR040-E13-2016	MODELO: TEC-5631 / AVALO
PARTIDA: 2	CATÁLOGO: FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD: 145	FABRICANTE: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
HOJA 8 DE 13	

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

a seleccionar entre 7 derivaciones: (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF y V). <b><u>MANUAL 2 PÁG. 8-1-4 Y 8-1-13</u></b>
2.1.7.3. Despliegue en pantalla y panel de control en idioma español. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 15-5 Y 8-3-9</u></b>
2.1.7.4. Análisis e interpretación de alteraciones del trazo de ECG (arritmias). <b><u>MANUAL 2 PÁG. 8-0-3 , 10-1-22 Y 11-9</u></b>
2.1.8. Palas <b><u>MANUAL 2 PÁG. 2-7</u></b>
2.1.8.1. Para excitación externa, convertibles adulto/pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 6-1-5 Y 8-1-18</u></b>
2.1.8.2. Con descarga desde las palas y desde el panel de control. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 2-5 Y 2-7</u></b>
2.1.8.3. Botón de carga desde las palas y desde el panel de control. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 2-5 Y 2-7</u></b>
2.1.8.4. Con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 1-6, 6-0-3 Y 6-2-11</u></b>
2.1.9. Alarmas audibles y visibles. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 9-2</u></b>
2.1.9.1. Seleccionables por el usuario, para alteraciones en la frecuencia cardiaca y SpO2. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 8-3-8, 9-6 Y 9-12</u></b>

Patriotismo D.F.  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.  
Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

Monterrey  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

Guadalajara  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de Guevara  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com



# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016  
 CLAVE PREI: 000000000016314 HORA IMP.: 13:37:24

**NOMBRE GENÉRICO**

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

LICITANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	MARCA: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN: LA-019GYR040-E13-2016	MODELO: TEC-5631 / AVALO
PARTIDA: 2	CATÁLOGO: FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD: 145	FABRICANTE: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 9 DE 13

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

2.1.9.2. De desconexión del paciente.
2.1.9.3. Del nivel de carga de la batería.
2.1.10. Sistema de registro.
2.1.10.1. Impresión integrada.
2.1.10.2. Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado.
2.1.10.3. Modo de operación manual y/o automático seleccionable por el usuario.
2.1.10.4. Un canal como mínimo.
2.1.11. SpO2.
2.1.11.1. Porcentaje numérico de SpO2 desplegado en pantalla y curva de pletismografía y/o barra de pulso y frecuencia de pulso.
2.1.11.2. Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SpO2.

2.1.9.2. De desconexión del paciente. <u>MANUAL 2 PÁG. 9-2 Y 15-3</u>
2.1.9.3. Del nivel de carga de la batería. <u>MANUAL 2 PÁG. 4-9</u>
2.1.10. Sistema de registro. <u>MANUAL 2 PÁG. 10-1-2</u>
2.1.10.1. Impresión integrada. <u>MANUAL 2 PÁG. 2-6</u>
2.1.10.2. Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado. <u>MANUAL 2 PÁG. 10-1-7</u>
2.1.10.3. Modo de operación manual y/o automático seleccionable por el usuario. <u>MANUAL 2 PÁG. 10-1-2</u>
2.1.10.4. Un canal. <u>MANUAL 2 PÁG. 10-1-7</u>
2.1.11. SpO2. <u>MANUAL 2 PÁG. 8-3-2</u>
2.1.11.1. Porcentaje numérico de SpO2 desplegado en pantalla y curva de pletismografía y/o barra de pulso y frecuencia de pulso. <u>MANUAL 2 PÁG. 8-3-7</u>
2.1.11.2. Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SpO2. <u>MANUAL 2 PÁG. 9-2 Y 8-3-8</u>



**Patriotismo D.F.**  
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
 Col. Hipódromo Condesa  
 C.P. 06170 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 0270  
 ventas@casaplarre.com

**Cauhtémoc D.F.**  
 Av. Cauhtémoc No. 220-201  
 Col. Doctores,  
 C.P. 06720 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 3730  
 ventas@casaplarre.com

**Monterrey**  
 Simón Bolívar No. 1554  
 Col. Mitras Centro  
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
 Tel. 01 81 8346 1473  
 ventas\_mty@casaplarre.com

**Guadalajara**  
 General Antonio León No. 434 Int. 13  
 Col. Ladrón de Guevara  
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
 Tel. 01 33 3630 9781  
 ventas\_gdl@casaplarre.com  
 www.casaplarre.com

**ANEXO 1.2**  
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01    FECHA IMP.: 28/07/2016 CLAVE PREI: 000000000016314    HORA IMP.: 13:37:24
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>  CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

2.1.12. Batería.
2.1.12.1. Recargable e integrada.
2.1.12.2. Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna.
2.1.12.3. Que permita dar al menos 50 desfibrilaciones a carga máxima o 1.5 horas de monitoreo continuo, como mínimo.
2.1.12.4. Tiempo de carga máximo 4.5 horas.
2.1.13 Presión no invasiva:
2.1.13.1. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.
2.1.13.2. Alarmas audibles y visibles de la presión sistólica y diastólica.
2.1.13.3. Despliegue digital de la presión sistólica, diastólica y media.
3. Accesorios
3.1. Para oximetría de pulso: Cable troncal y sensor reusable de dedo adulto/pediátrico y multisitio.

LICITANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C.V	MARCA: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN: LA-019GYR040-E13-2016	MODELO: TEC-5631 / AVALO
PARTIDA: 2	CATÁLOGO: FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD: 145	FABRICANTE: NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
HOJA 10 DE 13	

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

2.1.12. Batería. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 4-2</u></b>
2.1.12.1. Recargable e integrada. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 2-2 Y 4-2</u></b>
2.1.12.2. Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 4-2</u></b>
2.1.12.3. Que permita dar al 100 desfibrilaciones a carga máxima o 180 minutos de monitoreo continuo. <b><u>MANUAL 2 PÁG.15-20</u></b>
2.1.12.4. Tiempo de carga de 3 horas. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 4-8</u></b>
2.1.13 Presión no invasiva: <b><u>MANUAL 3 PÁG. 1-2</u></b>
2.1.13.1. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. <b><u>MANUAL 3 PÁG. 2-2</u></b>
2.1.13.2. Alarmas audibles y visibles de la presión sistólica y diastólica. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 9-2 ; MANUAL 3 PÁG. 2-23</u></b>
2.1.13.3. Despliegue digital de la presión sistólica, diastólica y media. <b><u>MANUAL 3 PÁG. 2-18</u></b>
3. Accesorios
3.1. Para oximetría de pulso: Cable troncal y sensor reusable de dedo adulto/pediátrico y multisitio. <b><u>MANUAL 2 PÁG. 8-3-4</u></b>

Patriotismo D.F.  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.  
Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

Monterrey  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

Guadalajara  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de Guevará  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com

# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016  
 CLAVE PREI: 000000000016314 HORA IMP.: 13:37:24

**NOMBRE GENÉRICO**

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

LICITANTE: <u>CASA PLARRE, S.A. DE C.V</u> MARCA: <u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>	
LICITACIÓN: <u>LA-019GYR040-E13-2016</u>	MODELO: <u>TEC-5631 / AVALO</u>
PARTIDA: <u>2</u>	CATÁLOGO: <u>FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3</u>
CANTIDAD: <u>145</u>	FABRICANTE: <u>NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS</u>

HOJA 11 DE 13

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

- 3.2. Cable para uso de electrodos de desfibrilación y/o marcapasos compatible con el equipo (incluir marca y modelo).
- 3.3. Cable de paciente de 5 puntas como mínimo.
- 3.4. Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, con una manguera con conector para los brazaletes.
- 4. Consumibles
- 4.1. Electrodos para monitoreo de ECG. (al menos 100 piezas).
- 4.2. Electrodos autoadheribles trascutáneos para desfibrilación y/o marcapasos tamaño adulto o pediátrico a elección de la unidad médica al menos 10 piezas (referir marca y modelo).
- 4.3. Pasta conductora al menos dos tubos.
- 4.4. Papel para impresión al menos dos rollos.
- 4.5. Al menos una bolsa con 100 sellos de garantía.
- 4.6 Al menos dos focos para laringoscopio.

- 3.2. Cable para uso de electrodos de desfibrilación y/o marcapasos compatible con el equipo (NIHON KOHDEN / JC865V). MANUAL 2 PÁG. 6-1-7
- 3.3. Cable de paciente de 6 puntas . MANUAL 2 PÁG. 8-1-8
- 3.4. Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, con una manguera con conector para los brazaletes. MANUAL 3 PÁG. 2-6
- 4. Consumibles
- 4.1. Electrodos para monitoreo de ECG. (100 piezas). CATALOGO 3 PÁG. 22
- 4.2. Electrodos autoadheribles trascutáneos para desfibrilación y/o marcapasos tamaño adulto o pediátrico a elección de la unidad médica al menos 10 piezas (Nihon Kohden / H327). CATALOGO 3 PÁG. 20
- 4.3. Pasta conductora dos tubos. CATALOGO 3 PÁG. 20
- 4.4. Papel para impresión dos rollos. MANUAL 2 PÁG. 1
- 4.5. Una bolsa con 100 sellos de garantía. FOLLETO 1
- 4.6 Dos focos para laringoscopio. CATALOGO 2 PÁG. 4

**ANEXO 1.2**  
**DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS**

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016  
CLAVE PREI: 000000000016314 HORA IMP.: 13:37:24

**NOMBRE GENÉRICO**

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

5. Instalación
5.1. 110v, 60Hz. ±10%.
6. Mantenimiento
6.1. Preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
7. Normas – Estandares vigentes
7.1. Para bienes nacionales e internacionales.
7.1.1. Registro sanitario.
7.1.2. Certificado de calidad ISO 9001:2008 o ISO-13485 o TÜV.
7.2. Para bienes nacionales incluir:
7.2.1 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
7.3. Para bienes internacionales incluir.
7.3.1 Certificado FDA o Health Canadá o CE o el equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.

LICITANTE: CASA PLARRE, S.A. DE C.V MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN: LA-019GYR040-E13-2016	MODELO: TEC-5631 / AVALO
PARTIDA: 2	CATÁLOGO FOLLETO 1; MANUAL 1, 2 Y 3; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD: 145	FABRICANTE NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 12 DE 13

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

5. Instalación
5.1. 110v, 60Hz. ±10%. <b>MANUAL 2 PÁG. 15-20</b>
6. Mantenimiento
6.1. Preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
7. Normas – Estandares vigentes
7.1. Para bienes nacionales e internacionales.
7.1.1. Registro sanitario.
7.1.2. Certificado de calidad ISO 9001:2008 o ISO-13485 o TÜV.
7.2. Para bienes nacionales incluir:
7.2.1 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
7.3. Para bienes internacionales incluir.
7.3.1 Certificado FDA o Health Canadá o CE o el equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.

Patriotismo D.F.  
Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
Col. Hipódromo Condesa  
C.P. 06170 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 0270  
ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.  
Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
Col. Doctores,  
C.P. 06720 México, D.F.  
Tel. 01 55 5134 3730  
ventas@casaplarre.com

Monterrey  
Simón Bolívar No. 1554  
Col. Mitras Centro  
C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
Tel. 01 81 8346 1473  
ventas\_mty@casaplarre.com

Guadalajara  
General Antonio León No. 434 Int. 13  
Col. Ladrón de Guevara  
C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
Tel. 01 33 3630 9781  
ventas\_gdl@casaplarre.com  
www.casaplarre.com



# ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

## ANEXO 1.2

### DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 FECHA IMP.: 28/07/2016  
 CLAVE PREI: 000000000016314 HORA IMP.: 13:37:24

**NOMBRE GENÉRICO**

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR – MONITOR - MARCAPASO

#### ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.	MARCA:	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS
LICITACIÓN:	LA-019GYR040-E13-2016	MODELO:	TEC-5631 / AVALO
PARTIDA:	2	CATÁLOGO	FOLLETO 1 ; MANUAL 1, 2 Y 3 ; CATALOGO 1, 2 Y 3
CANTIDAD:	145	FABRICANTE	NIHON KOHDEN / CAPSA SOLUTIONS

HOJA 13 DE 13

#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

ATENTAMENTE

ALBERTO PAULINO BASURTO  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CASA PLARRE, S.A. DE C.V.




**Patriotismo D.F.**  
 Diagonal de patriotismo No. 1 Piso A2  
 Col. Hipódromo Condesa  
 C.P. 06170 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 0270  
 ventas@casaplarre.com

**Cuauhtémoc D.F.**  
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
 Col. Doctores,  
 C.P. 06720 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 3730  
 ventas@casaplarre.com

**Monterrey**  
 Simón Bolívar No. 1554  
 Col. Mitras Centro  
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
 Tel. 01 81 8346 1473  
 ventas\_mty@casaplarre.com

**Guadalajara**  
 General Antonio León No. 434 Int. 13  
 Col. Ladrón de GuevarA  
 C.P. 44650 Guadalajara, Jal.  
 Tel. 01 33 3630 9781  
 ventas\_gdl@casaplarre.com  
 www.casaplarre.com

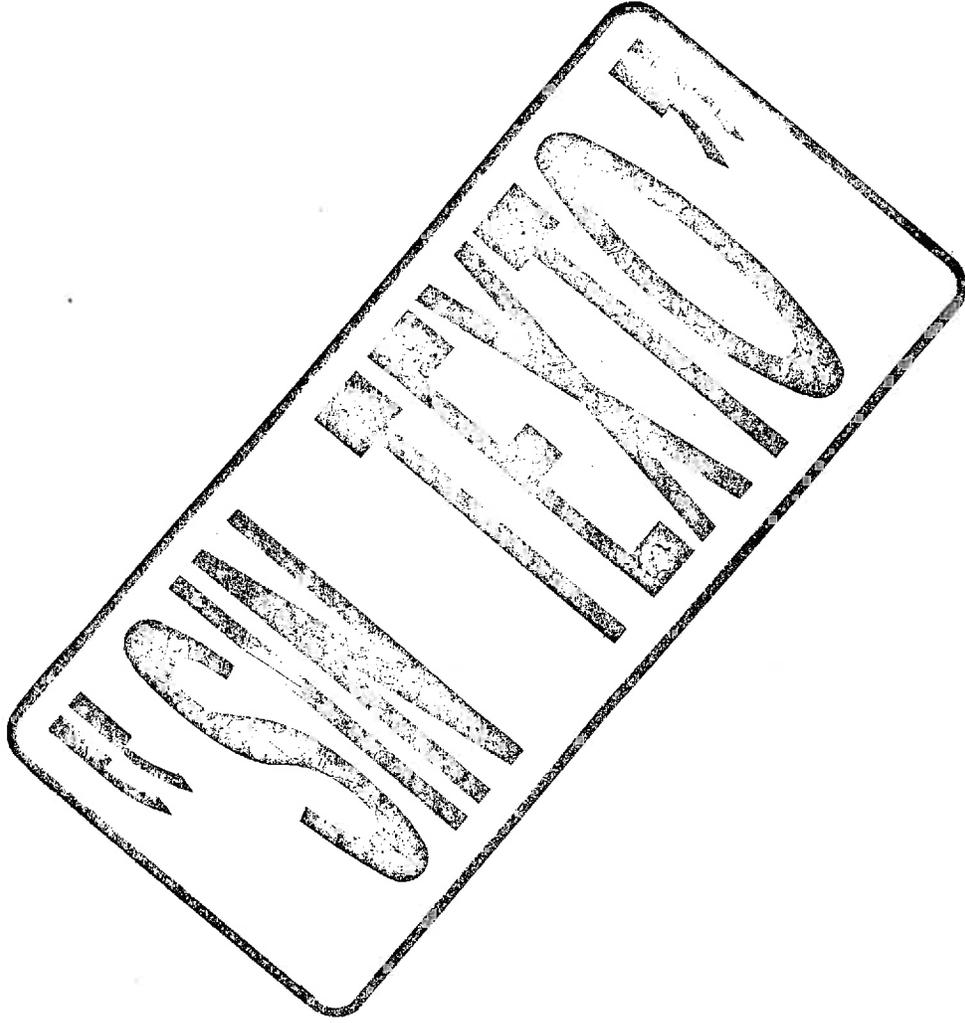

**plarrre**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
 COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS  
 DIVISION DE EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO

**ANEXOS**

**DIVISION DE CONTRATOS**

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES No. LA-019GYR040E-13-2016 ELECTRONICA MEDIANTE LA MODALIDAD DE PRESENTE.

Alpino No. 54  
 Plarrre con Abastecimiento Simuláneo

PROPOSICIÓN ECONOMICA

PROCEDIMIENTO: LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL CONSOLIDADA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES No. LA-019GYR040E-13-2016 ELECTRONICA MEDIANTE LA MODALIDAD DE PRESENTE

NOMBRE DE LA RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE: CASA PLARRRE, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: DIAGONAL DE PATRIOTISMO NO. 1 PRISO A-2, COL. HIPODROMO CONDESA, DEL CUARTIÉNOC, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06170

R.F.C.: CPLR512305F2

TELEFONO: (0155) 51 34 02 70

CORREO ELECTRONICO: ventas@casaplarre.com

FECHA: 29/07/2016

Partida	PREI	SAI	DESCRIPCIÓN	Fuente de Abastecimiento ofertada	Cantidad ofertada	Precio Unitario \$/VA	Importe Total ofertado \$/VA
2	16314	531.191.0391.03.01	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	81% Primera Fuente	118	165.000.00	19.568.000.00
SUB-TOTAL							19.568.000.00
16% I.V.A.							3.134.000.00
TOTAL							22.702.000.00

Partida	Descripción	Cantidad Total	% 1a Fuente	% 2a Fuente	Cantidad 1a Fuente	Cantidad 2a Fuente
2	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	145	81%	19%	118	27

IMPORTE TOTAL EN LETRA: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHENTA PESOS 00/100

Note: En la columna "Cantidad Ofertada", se desplegará el combo con las cantidades correspondientes a la primera y segunda fuente de abastecimiento, a fin de que seleccione la que ofertará.

LOS PRECIOS OFERTADOS SON FUJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

*(Signature)*

ALBERTO PAULINO BASURTO  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CASA PLARRRE, S.A. DE C.V.

Patriotismo D.F.  
 Diagonal de Patriotismo No. 1 Priso A2  
 Col. Hipodromo Condesa, C.P. 06170 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 0270  
 ventas@casaplarre.com

Cuauhtémoc D.F.  
 Av. Cuauhtémoc No. 220-201  
 Col. Doctores, C.P. 06720 México, D.F.  
 Tel. 01 55 5134 3750  
 ventas@casaplarre.com

Monterrey  
 Simón Bolívar No. 1654  
 Col. Mitrás Centro  
 C.P. 64460 Monterrey, N.L.  
 Tel. 01 81 8346 1473  
 ventas\_mty@casaplarre.com

Guadalajara  
 Gral. Antonio León No. 434 Int. 13  
 Col. La Jirafilla  
 C.P. 44680 Guadalajara, Jalisco  
 Tel. 01 33 3630 8781  
 ventas\_gdl@casaplarre.com  
 www.casaplarre.com

**biossmann**

0013

**TO  
TEXT  
TENS  
SINIS**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES  
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Contrato Numero

16BI0046

### ANEXO 3

“REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO Y DIRECTORIO DE UNIDADES”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 03 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

SALE

Handwritten mark



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA**  
**COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS**  
**DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO**

**REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO**

Partida (PRE)	SAI	EQUIPO	Eléctrica	Hidrosanitaria	Gases	Vapor	Tuberia	Desinstalación e Instalación	Nivel de capacitación	Mantenimiento Preventivo	Registro Sanitario	Suspenso de necesidad COFEPRIS	Tiempo de Entrega (Días naturales posteriores al fallo)
1	531.328.0181.02.01	UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si req.		90
2	531.191.0391.03.01	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	Si Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	No Req.	Fundamental	Si Req.	Si req.		90

NOMENCLATURA		TIPO DE CAPACITACIÓN:
No Req		<b>NO REQUERIDA:</b> Por la simplicidad de uso del artículo no se requiere capacitación.
<b>F = FUNDAMENTAL</b>		Capacitación sobre el funcionamiento general, aplica a equipos de baja complejidad tecnológica en los que sola se requiere explicación breve sobre las funciones del equipo. Por su simplicidad en el manejo, el usuario no requiere gran adiestramiento.
<b>I = INTERMEDIA.</b>		Cuando además de la anterior, se requiere de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones.
<b>A = AVANZADA</b>		Además de cubrir de un adiestramiento teórico-práctico para la explotación de las funciones por tratarse de equipos especializados, involucra la instrucción y adiestramiento en aplicaciones clínicas y sobre aquellos factores que garanticen desempeño óptimo, continuo y seguro.

**ANEXOS**

**DIVISION DE CONTRATOS**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS  
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN

Partida	PREI	SAI	Descripción	Guerravaca Quintanas (A)	Queretaro Toxicología (B)	EAO 2016 (A+ B)	REPOSICIÓN	SEDENA	Cantidad Total	% 1a fuente	% 2a fuente	Cantidad 1a fuente	Cantidad 2a fuente	Abastecimiento Simultáneo
1	11795	531.328.0181.02.01	UNIDAD DE ELECTROCRUJIA DE USO GENERAL.	6	1	7	50		57					
2	16314	531.191.0391.03.01	CARRO ROLLO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO.	2	3	5	115	25	145	81%	19%	118	27	
				8	4	12	165	25	202			118	27	

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS  
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

**DIRECTORIO DE UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRADORES DE CONTRATO  
 BIENES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE REPOSICIÓN**

Partida	Delegación	Unidad Médica	Domicilio	Administrador	Cargo	Correo electrónico	PREI	SAI	Descripción	Cantidad	Abastecimiento Simultáneo
2	CCLIMA	UMF11 COLIMA, COL	Calle Doroteo López No. 442, Colonia Magisterial C.P. 28030 Colima, Municipio de Colima, Colima	Ing. Miguel Mier Sánchez	Ingeniero Blomédico Delegacional	miguel.mier@imss.gov.mx	16314	531.191.0391.03.01	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor inarcapaso.	1	*
2	COLIMA	UMF 19 COLIMA, COL	Avenida Javier Mina No. 301, Colonia Colima Centro C.P. 28000 Colima, Municipio de Colima, Colima	Ing. Miguel Mier Sánchez	Ingeniero Blomédico Delegacional	miguel.mier@imss.gov.mx	16314	531.191.0391.03.01	Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador monitor inarcapaso.	1	*

2

01/30/2013 10:00 AM

