



Se manifiesta que el
archivo publicado es
la mejor versión
disponible con la
que cuenta el
Instituto Mexicano
del Seguro Social.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

**CONVENIO
MODIFICATORIO N°
1 (UNO)
AL CONTRATO
U170577**

CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 1 (UNO) AL CONTRATO ABIERTO NÚMERO U170517 PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS DE LOS GRUPOS 060 MATERIAL DE CURACIÓN, 070 MATERIAL RADIOLÓGICO Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO, PARA LA COMPRA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2018, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR MARÍA GUADALUPE SERRANO ZARIÑANA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y, POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TÉCNICO MÉDICO, S.A. DE C.V., EN LO SUBSECUENTE "EL PROVEEDOR", REPRESENTADA POR OSWALDO XAVIER RAMOS PANTOJA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I.- Con fecha 27 de diciembre de 2017 "LAS PARTES" suscribieron el contrato primigenio, derivado del procedimiento de Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica, número LA-019GYR047-E79-2017, con una vigencia a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2018.

II.- En la Cláusula Décima Octava, "Modificaciones al Contrato", del contrato primigenio "LAS PARTES" acordaron que el instrumento jurídico podría ser modificado durante la vigencia del mismo, de conformidad con los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento.

III.- En el Anexo 1 (uno) del contrato primigenio, "LAS PARTES" convinieron las características técnicas y alcances de la adquisición de los bienes, así como el monto a ejercer durante la vigencia del citado instrumento jurídico.

DECLARACIONES

I.- "EL INSTITUTO", declara a través de su representante legal, que:

I.1.- Mediante oficio número 095384611800/2018000988 de fecha 20 de marzo de 2018, recibido el 27 de marzo de 2018, la Titular de la Coordinación de Control de Abasto en su calidad de Área Consolidadora y representante de los administradores del contrato primigenio manifestó que en atención a la petición de "EL PROVEEDOR" y el incumplimiento que presenta la clave 060 166 1903 03 01, de conformidad con lo establecido en el apartado "Inclusión de Registros Sanitarios" del procedimiento de contratación número LA-019GYR047-E79-2017 y en el artículo 52, cuarto párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicitó al Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, la elaboración del presente convenio modificatorio para incluir el registro sanitario 0014C90 SSA; remitiendo para tal efecto, soporte documental y el dictamen técnico de fecha 21 de febrero de 2018, suscrito por el Doctor José Luis Estrada Aguilar,

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 1 de 3

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes que se señalan."



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

**CONVENIO
MODIFICATORIO N°
1 (UNO)
AL CONTRATO
U170577**

Titular de la División Institucional de Cuadros Básicos de Insumos para la Salud. Documentos que se agregan al **Anexo 1 (uno)** del presente convenio.

II.- “EL PROVEEDOR”, declara a través de su representante legal, que:

II.1.- Con escrito de fecha 12 de febrero de 2018, presentó a la Coordinación de Control de Abasto solicitud de inclusión de registro sanitario para la clave 060 166 1903 03 01, documento que se agrega al **Anexo 1 (uno)** del presente instrumento jurídico.

II.2.- Está en condiciones de suministrar a **“EL INSTITUTO”** los bienes en los términos pactados en el contrato primigenio, sin modificar las características técnicas de los bienes acordados.

III.- “LAS PARTES”, declaran por conducto de sus representantes legales, que:

III.1.- Las facultades que les fueron otorgadas no les han sido modificadas, restringidas, ni revocadas de forma alguna, para los efectos que se deriven del presente instrumento legal.

III.2.- Están de acuerdo en celebrar el presente convenio modificatorio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que se otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- “LAS PARTES” convienen en modificar el **Anexo 1 (uno)** del contrato primigenio para incluir el Registro Sanitario a la clave que se describe a continuación, conforme se detalla el **Anexo 1 (uno)** del presente instrumento jurídico, quedando de la siguiente manera:

CLAVE	REGISTRO SANITARIO	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO
060 166 1903 03 01	0014C90 SSA	Arrow Internacional de México, S.A. de C.V.

SEGUNDA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar, a más tardar dentro del plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la firma de este instrumento jurídico, la modificación o el endoso a la garantía de cumplimiento del contrato que se modifica.

TERCERA.- “LAS PARTES” convienen expresamente que salvo lo previsto en el presente convenio, no se modifica, altera o nova en forma alguna lo estipulado en el contrato primigenio.

CUARTA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y el cumplimiento de este convenio modificatorio, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **“LAS PARTES”** se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

*Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes que se señalan.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

**CONVENIO
MODIFICATORIO N°
1 (UNO)
AL CONTRATO
U170577**


de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance de todas y cada una de las cláusulas de este instrumento jurídico, lo ratifican y firman en la Ciudad de México, el día 11 de abril de 2018, por sextuplicado, quedando un ejemplar en poder de "EL PROVEEDOR" y los restantes en poder de "EL INSTITUTO".

"EL INSTITUTO"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

"EL PROVEEDOR"
**ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE
TÉCNICO MÉDICO, S.A. DE C.V.**


MARÍA GUADALUPE SERRANO ZARINANA
Representante Legal

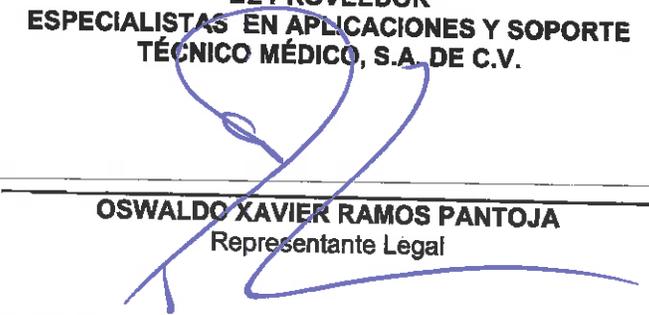
OSWALDO XAVIER RAMOS PANTOJA
Representante Legal

**ÁREA CONSOLIDADORA EN REPRESENTACIÓN DE LOS
ADMINISTRADORES DEL CONTRATO**
Numeral 5.4.13 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS, y Artículos 2 fracción
II y 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público


MARÍA DEL PILAR BUERBA GÓMEZ
Coordinadora de Control de Abasto


AA/JMHN/PDA.

SIN TEXTO

A handwritten mark in blue ink, consisting of a loop followed by a long, sweeping horizontal stroke that extends towards the right edge of the page.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

**CONVENIO
MODIFICATORIO N°
1 (UNO)
AL CONTRATO
U170577**

ANEXO 1


“REQUERIMIENTO Y SUSTENTO DEL CONVENIO”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 23 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

SIN TEXTO

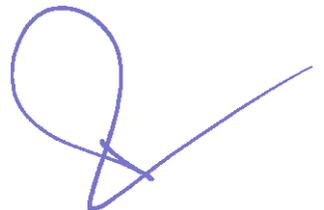A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line that extends to the right.

*CTAC/POV

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO



27 MAR 2018

RECIBIDO
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES
BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Ciudad de México, a 20 de marzo de 2018
095384611800/2018000988

Lic. José Roberto Flores Bañuelos
Titular de la Coordinación de Adquisición de
Bienes y Contratación de Servicios.
Presente.-

En relación al contrato U170577 adjudicado al proveedor **Especialistas en Aplicaciones y Soporte Técnico, S.A. de C.V.**, derivado del procedimiento de Licitación Pública Internacional número **LA-019GYR047-E79-2017**, para atender la necesidad de diversos bienes terapéuticos del presente ejercicio fiscal.

Se hace de su conocimiento que mediante escrito de fecha 12 de febrero del presente año, el proveedor antes mencionado, refiere que en estos momentos se ven imposibilitados de entregar los bienes inicialmente adjudicados, debido a que su fabricante cuenta con desabasto, por lo que solicitó la inclusión del registro sanitario contenidos en la tabla siguiente:

No. de Contrato	Clave					Descripción	No. de Registro Sanitario	Titular de Registro Sanitario	País de Origen Indicado en los registros sanitarios y manifestado por el proveedor.
U170577 <i>CHI</i>	060	166	1903	03	01	CATETERES VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR LONGITUD 13 CM, DE POLIURETANO O SILICON, RADIOPACO, CON DOS LUMENES INTERNOS DE 22 G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATETER INTRODUCIDOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA.	0014C90 SSA	ARROW INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	E.U.A

001133

Atendiendo a la petición del proveedor y el incumplimiento en la entrega que presenta la clave de referencia en los almacenes del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el apartado "inclusión de registros sanitarios" del procedimiento de contratación **LA-019GYR047-E79-2017** en el artículo 52 cuarto párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en mi carácter de área consolidadora y representante de los administradores de contrato, se solicita proceder con el convenio modificatorio en el que se incluya el registro sanitario indicado en el recuadro que antecede, sujetándose a los mismos términos y condiciones de contratación.

En virtud de lo anterior, se anexa al presente soporte documental que se lista a continuación:

- Oficio número 09 A3 61 61 2072/2018/0359 de fecha 07 de marzo del presente año, emitido por la Titular de la División de Medicamentos y Reactivos de la Coordinación de Control Técnico de Insumos, mediante el cual informa el resultado de la revisión técnico-sanitaria-documental e inspección física demuestra que el producto cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria del procedimiento de contratación en comento.
- Resultado Técnico de la Evaluación de Inclusión emitido por el Titular de la División Institucional de Cuadros Básicos e Insumos para la Salud, mediante el cual acredita el cumplimiento de los requisitos técnicos del registro sanitario y carta de cumplimiento de normas a incluir.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



Ciudad de México, a 20 de marzo de 2018
Oficio No. 09538461/1800/2018000988

- Escrito del proveedor donde justifica las causas que motivan dicha solicitud y cuadro de inclusión de registro sanitario.
- Escrito del Titular del Registro Sanitario adjudicado que genera las imposibilidad de entrega.
- Carta de respaldo del Titular del Registro Sanitario a incluir.
- Carta del Proveedor a través de la cual manifiesta el origen de los bienes a incluir.

Agradeciendo su valioso apoyo para que la presente solicitud sea atendida en el menor plazo posible dada la problemática de surtimiento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
La Titular


María del Pilar Buerba Gómez

- Mtro. Pedro Francisco Rangel Magdaleno - Titular de la Unidad de Administración.
- Lic. María Guadalupe Serrano Zarifana - Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios (*) - Para Seguimiento y Registro en SAI.
- Lic. Alma Rosa Medrano Díaz - Titular de la División de Bienes Terapéuticos (*) - Para Seguimiento y Registro en SAI.
- Lic. Laura Rosario Belanzarán González - Titular de la División de Apoyo Normativo al Proceso de Abasto. (*)

Copias enviadas a través del SICGC

GBO/ADMOC/JOV/RECI



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS

UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA

COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD

DIVISIÓN INSTITUCIONAL DE CUADROS BÁSICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPRESA TITULAR DEL REG. SAN.	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	EVA LUACIÓN	EVALUACIÓN	CONTRATO	PROCEDI MIENTO DE CONTRATACIÓN
060.166.1903. 03.01	Catéter venoso central, calibre 4 Fr, longitud 13 cm, de poliuretano o silicón, radiopaco, con dos lúmenes internos de 22 G, con punta flexible, aguja calibre 21 G, con catéter introductor calibre 22 G, sobre una aguja calibre 25 G, con guía de alambre de 0.46 mm de diámetro y 45 cm de longitud y punta en "J", con un dilatador venoso, una jeringa de 5 ml, y dos cápsulas de inyección luer-lock. Estéril y desechable. Pieza. El catéter introductor es opcional; las unidades médicas determinarán su requerimiento y adquisición de acuerdo a las necesidades operativas.	Arrow Internacion al de México, S.A. de C.V.	Prórroga Registro Sanitario 0014C90 SSA	7 agosto 2015	13 diciembre 2020	CUMPLE	CUMPLE	U170577	Licitación Pública Internacional Número LA-019GYR047-E79-2017
060.166.1911. 03.01	Catéter venoso central, calibre 5 Fr y 13 cm de longitud, de poliuretano o silicón, radiopaco, estéril y desechable, con dos lúmenes internos calibres	Arrow Internacion al de México, S.A. de C.V.	Prórroga Registro Sanitario 0014C90 SSA	7 agosto 2015	13 diciembre 2020	CUMPLE	CUMPLE	U170577	Licitación Pública Internacional Número LA-019GYR047-E79-2017

Fecha de emisión: 21/02/2018

Responsable de su revisión: IAC



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS

UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA

COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD

DIVISIÓN INSTITUCIONAL DE CUADROS BÁSICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD

	<p>18 G y 20 G, con punta flexible, con aguja calibre 20 G, con catéter introductor calibre 20 G, sobre una aguja calibre 22 G, con guía de alambre de 0.53 mm de diámetro y 45 cm de longitud y punta en "J" con un dilatador venoso, una jeringa de 5 cc dos cápsulas de inyección luer lock. Pieza. El catéter introductor es opcional; las unidades médicas determinarán su requerimiento y adquisición de acuerdo a las necesidades operativas.</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


ATENTAMENTE

DR. JOSÉ LUIS ESTRADA AGUILAR
TITULAR DE LA DIVISIÓN INSTITUCIONAL DE CUADROS BÁSICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD

Fecha de emisión: 21/02/2018

Responsable de su revisión: IAC

SIN TEXTO

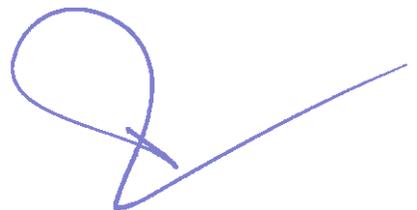A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line extending to the right.

07 de marzo de 2018.

Oficio Núm. 09 A3 61 61 2072/2018/0359

Lic. María del Pilar Buerba Gómez
Titular de la Coordinación de Control de Abasto
Presente

Atendiendo a lo establecido en el numeral 19.2 Inclusión de Registros Sanitarios del Anexo 3 Términos y Condiciones de la presente convocatoria, se informa que con fecha 14 de febrero del año en curso, la empresa Especialistas en Aplicaciones y Soporte Técnico Médico, S.A. de C.V. presentó en esta Coordinación lo siguiente:

- Escrito dirigido a la Coordinación de Control Técnico de Insumos, en papel membretado con la razón social del proveedor, en el que solicita la evaluación del producto que a continuación se señala, haciendo referencia a la Convocatoria de la Licitación Pública Internacional Abierta Número LA-019GYR047-E79-2017 Electrónica.
- La cantidad de muestra indicada en el listado del Anexo "CLAVES CON MUESTRAS 2018": 8 piezas.
- Certificado de análisis del lote de las muestras entregadas.
- Copia legible de la Prórroga del Registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS.

CATÉTERES VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR LONGITUD 13 CM, DE POLIURETANO O SILICÓN, RADIOPACO, CON DOS LÚMENES INTERNOS DE 22 G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATÉTER INTRODUTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUÍA DE ALAMBRE DE 0.46 MM DE DIÁMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN J, CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML Y DOS CÁPSULAS DE INYECCIÓN LUER-LOCK. ESTÉRIL Y DESECHABLE. EL CATÉTER INTRODUTOR ES OPCIONAL; LAS UNIDADES MÉDICAS DETERMINARÁN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS, clave: 060.166.1903.03.01.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Denominación distintiva y(o) Marca:	ARROW ✓	Lote:	23F17E0397
Registro Sanitario:	0014C90 SSA ✓	Fecha de fabricación:	05-JUN-2017
Catálogo o Modelo:	CS-14402	Fecha de caducidad:	2022-05-31
País de origen:	Estados Unidos ✓		
Fabricante:	Arrow International, Inc.* ✓		
Proveedor:	Especialistas en Aplicaciones y Soporte Técnico Médico, S.A. de C.V. ✓		

* De acuerdo al etiquetado del envase primario y a lo referido en el Registro Sanitario 0014C90 SSA, el producto es fabricado por: Arrow International, Inc., e importado y distribuido por Arrow Internacional de México, S.A. de C.V., siendo ésta última Titular del Registro Sanitario.



07 de marzo de 2018.

Oficio Núm. 09 A3 61 61 2072/2018/0359

La revisión técnico-sanitaria-documental e inspección física de la muestra recibida, se llevó a cabo considerando:

- **FEUM-SDM-2014-3ed.** FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS – SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS, 2014, TERCERA EDICIÓN. CATÉTER PEDIÁTRICO PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL CON EQUIPO DE INSERCIÓN POR TÉCNICA SELDINGER. Página(s): 585.
- Los requisitos establecidos en la presente convocatoria de licitación y sus anexos.

A continuación se indican los resultados de la revisión técnico-sanitaria-documental e inspección física efectuada en esta Coordinación:

- De la inspección practicada a la muestra por el Área de Análisis de Materiales Metálicos, se identificó:

1. Inspección.

Cumple (cinco piezas inspeccionadas).

2. Descripción del Cuadro Básico Institucional, conforme a los datos y leyendas indicados en el etiquetado del envase primario o múltiple.

Cumple (El etiquetado del envase primario o múltiple inspeccionado concuerda con lo indicado en la Descripción del Cuadro Básico Institucional).

3. Revisión del Certificado de calidad del fabricante.


Concuerda con las pruebas establecidas en la normatividad aplicable (FEUM-SDM 2014 3RA EDICIÓN PÁGINA 585).

DICTAMEN TÉCNICO

El resultado de la revisión técnico-sanitaria-documental e inspección física demuestra que el producto **cumple** con los requisitos establecidos en la convocatoria de licitación en cuestión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Ing. Mario Alberto Medina Olguín
Titular de la División



07 de marzo de 2018.

Oficio Núm. 09 A3 61 61 2072/2018/0359

Con copia:


- Dr. Arturo Viniegra Osorio.- Titular de la Coordinación de Control Técnico de Insumos.
- Mtro. Ricardo Alexander Márquez Padilla.- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
- Lic. Alma Rosa Medrano Díaz.- Titular de la División de Bienes Terapéuticos.
- Lic. Ana Laura Montes de Oca Choreño.- Titular de la División de Planeación y Control al Abasto.

AUF

ERR

SICGC2018 DMCI0199
SICOCTI 2018-000122

SIN TEXTO

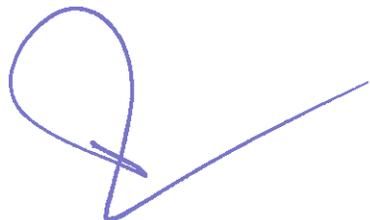A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line extending to the right.



Especialistas en Aplicaciones
EASTIM
 y Soporte Técnico Médico SA de CV

SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE REGISTRO SANITARIO.

CIUDAD DE MEXICO A 12 DE FEBRERO DE 2018.

Instituto Mexicano del Seguro Social
 Coordinación de Control de Abasto
 P r e s e n t e.


OSWALDO XAVIER RAMOS PANTOJA en mi carácter de Representante Legal de la empresa **ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TÉCNICO MÉDICO, S.A. DE C.V.**, en apego al numeral 19.2 de los términos y condiciones del procedimiento de **LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-0196YR047-E79-2017**, contenidas en el anexo del contrato número **U170577**, solicito a usted la inclusión de(los) registro(s) sanitario(s), así como la suscripción del convenio modificatorio correspondiente para la(s) clave(s) de los contratos que se detallan a continuación:
 Para lo cual integro la siguiente documentación e información.

U170577	060	166	1903	03	01	1 - 2	3 - 20	21	22 - 24	25	26
U170577	060	166	1911	03	01	1 - 2	3 - 20	21	22 - 24	25	26


Lo anterior toda vez que (EN ESTOS MOMENTOS NOS VEMOS IMPOSIBILITADOS DE ENTREGAR LOS BIENES INICIALMENTE ADJUDICADOS, DEBIDO A QUE NUESTRA FABRICANTE CUENTA CON DESABASTO)

Sin más por el momento, aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo.

ATEMPARAMENTE

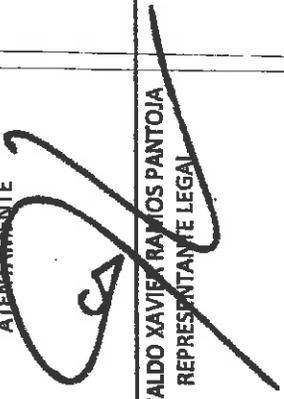
 OSWALDO XAVIER RAMOS PANTOJA
 REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

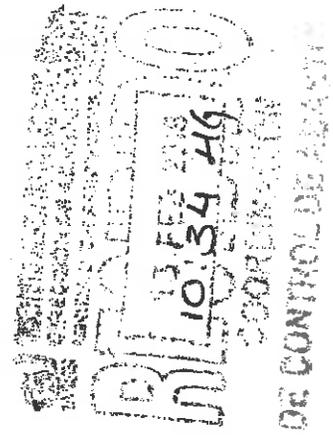



y Soporte Técnico Médico SA de CV

FORMATO DE INCLUSIÓN DE REGISTRO SANITARIO.

CIUDAD DE MÉXICO A 12 DE FEBRERO DE 2018

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO
PRESENTE.

CONTRATO	NO. DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	CLAVE(S)			DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN		NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	NÚMERO DEL REGISTRO SANITARIO	NOMBRE Y R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO	PAÍS DE ORIGEN	NOMBRE DEL FABRICANTE
		GPO.	GEN.	ESP.		DIF.	VAR.					
U170577	LA-019GYR047- E79-2017	060	166	1903	03	01		ARROW INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0014C90 SSA	ARROW INTERNACIONAL DE MÉXICO AIM 930716 2M9	E.U.A.	ARROW INTERNACIONAL INC.




0000

U170577	LA-019GYR047- E79-2017	060	166	1911	03	01	<p>CATERETER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 5 FR Y 13 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICON, RADIOOPACO, ESTERIL Y DESECHABLE, CON DOS LUMENES INTERNOS, CALIBRES 18 G Y 20 G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CALIBRE 20 G, CON CATERETER INTRODUCITOR CALIBRE 20 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 22 G, CON GUJA DE ALAMBRE DE 0.53 MM DE DIAMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN "J" CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 CC DOS CAPSULAS DE INYECCION LUER LOCK. EL CATERETER INTRODUCTOR ES OPCIONAL; LAS UNIDADES MEDICAS DETERMINARAN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS.</p> <p>CODIGO CS-14502 MARCA ARROW</p>	PZA	1	PZA	II	ARROW INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0014C90 SSA	AIM 930716 2M9	E.U.A.	ARROW INTERNACIONAL INC.
---------	---------------------------	-----	-----	------	----	----	--	-----	---	-----	----	---	-------------	----------------	--------	--------------------------

ATENTAMENTE

OSWALDO XAVIER RAMOS PANTOJA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



SECRETARÍA DE SALUD

0003

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS
SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO N°

0014C90 SSA
N° DE SOLICITUD
153300421N0118

Con fundamento en los Artículos 4 párrafo tercero, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción I, 14, 17, 26, 39 fracciones XXI y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Artículos 1, 3 fracciones XXV y XXX, 4 fracción III, 13 inciso A fracción IX, X, 17 bis fracción IV, 194 fracción II, 194 bis, 197, 204, 262, 371, 376, 376 bis, fracción II, 378, 380 y 393 primer párrafo de la Ley General de Salud, 1, 2, 3, 15 y 16 fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 2 inciso c fracción X, 15, 36, y 37 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 1, 3 fracción I inciso b, fracción VII, 4 fracción II inciso c y 14 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1, 2, fracción XI, 82, 83, 153, 157, 184, 189, 190 bis 3, 190 bis 4 y 190 bis 6 y Tercero Transitorio fracción I, II, IV, V y VI, y 214 del Reglamento de Insumos para la Salud; con fundamento en lo dispuesto por el artículo décimo octavo del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010; así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; publicado el 28 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, se prorroga el presente Registro Sanitario bajo las siguientes condiciones:

Domicilio: Av. Industria Automotriz N° 128-G, Edificio A-2 (dentro de las instalaciones de BOMI de México), Parque Industrial El Cocillo, C.P. 50070, Toluca, Estado de México, México.

R.F.C.: AIM 9807182M9

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Denominación Distintiva: Equipo de Cateterización Venosa Central Arrow ✓
Denominación Genérica: Equipo de Cateterización Venosa Central.
Tipo de Insumo para la Salud Art. 262 LGS: Material de Curación. ✓
Clasificación del Insumo para la Salud Art. 83 RIS: Clase II.
Fabricador: 1. Arrow International, Inc.
2. Arrow Internacional de Chihuahua, S.A. de C.V.
Domicilio: 1. 13 Commerce Plaza, Asheville, North Carolina, 27203, E.U.A.
2. Ave. Washington 3701 Interior Circuito Industrial Alta Tecnología, Edificio 40, Colonia Panamericana, C.P. 31200, Chihuahua, Chihuahua, México.
Fabricado para: Arrow International Inc.
Domicilio: 2400 Bernville Road, Reading, Pennsylvania 19605, E.U.A.

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras
Hoja 1 de 4 153300421N0118

Handwritten signature and stamp: COF 088394



Importado y Distribuido por: **Arrow Internacional de México, S.A. de C.V.**

0004

Domicilio: **Av. Industria Automotriz N° 128-C, Edificio A-2 (dentro de las instalaciones de BOMI de México), Parque Industrial El Coecillo, C.P. 50070, Toluca, Estado de México, México.**
Av. Insurgentes 800, Piso 21, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Distrito Federal, México. (Domicilio Fiscal).

Indicación de uso: **Para la administración de soluciones parenterales y medicamentos directamente en cavidad cardiaca, toma de muestras sanguíneas y aplicación de medios de contraste.**

Descripción: **Dispositivos médicos elaborados de materiales plásticos metálicos grado médico. Catéter de un lumen, doble lumen y multilumen. Producto estéril, no tóxico y libre de pirógenos.**

Presentaciones:

Código	Descripción	Presentación (piezas por caja)
Catéteres Venosos Centrales, 1 LUMEN.		
ES-04301	1 LUMEN 16 GA 20 cm C/ RAULERSON Y EXTENSION.	10
ES-04301-P	1 LUMEN 16 GA 20 cm C/ RAULERSON Y EXTENSION.	10
ES-04701	1 LUMEN 14 GA 20 cm C/ RAULERSON Y EXTENSION.	10
ES-04701-P	1 LUMEN 14 GA 20 cm C/ RAULERSON Y EXTENSION.	10
Catéteres Venosos Centrales, 2 LUMEN.		
CS-12702-E	2 LUMEN 7 Fr 16 cm 18/14 GA RAULERSON.	5
CS-16702-E	2 LUMEN 7 Fr 20 cm 16/16 GA.	5
CS-17702-E	2 LUMEN 7 Fr 20 cm 14/18 GA RAULERSON.	5
CS-17702	2 LUMEN 7 Fr 20 cm 14/18 GA.	5
ES-14702	2 LUMEN 7 Fr 30 cm 16/16 GA.	5
CS-10802	2 LUMEN 8 Fr 11 cm 14/14 GA.	5
Catéteres Venosos Centrales, 3 LUMEN.		
CS-12703	3 LUMEN 7 Fr 16 cm 16/18/18 GA.	5
CS-16703	3 LUMEN 7 Fr 20 cm 16/18/18 GA.	5
CS-16703-E	3 LUMEN 7 Fr 20 cm 16/18/18 GA RAULERSON.	5
CS-14703-E	3 LUMEN 7 Fr 30 cm 16/18/18 GA RAULERSON.	5
Catéteres Venosos Centrales Pediátricos.		
ES-04150	CATÉTER PEDIÁTRICO YUGULAR 20 GA 12 cm.	10
CS-24402	CATÉTER PEDIÁTRICO 2 LUMEN 4 Fr 13 cm 18/20 GA.	5
CS-14402	2 LUMEN 4 Fr 13 cm 22/22 GA.	5
CS-15402	2 LUMEN 4 Fr 30 cm 22/22 GA.	5
CS-14502	2 LUMEN 5 Fr 13 cm 18/20 GA.	5
CS-14553	3 LUMEN Femoral 5.5 Fr 30 cm 20/22/22 GA.	5
CS-15402-E	2 LUMEN 4 Fr 8 cm 22/22 GA.	5
CS-14403	3 LUMEN 4 Fr 13 cm 23/23/20 GA.	5

PARTIDA 19
060.166.1903.03.01

PARTIDA 20
060.166.1911.03.01

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmiendas.
Hoja 2 de 4 153300421N0118

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

COF 088395



Catéteres Venosos Centrales, 4 LUMEN.		
CS-15854-E	4 LUMEN 8.5 Fr 20 cm 14/18/18/16 GA RAULERSON.	5
CS-14854-E	4 LUMEN 8.5 Fr 30 cm 14/18/18/16 GA RAULERSON.	5
Catéteres Venosos Centrales, 2 LUMEN.		
CS-16702	2 LUMEN 7 Fr 20 cm 16/16 GA.	5
CS-12402	2 LUMEN 4 Fr 5 cm 22/22 GA.	5
CS-17752	2 LUMEN 7 Fr 60 cm 14/18 GA.	5
ES-14402	2 LUMEN 4 Fr 13 cm 22/22 GA.	5
HO-14702	2 LUMEN 7 Fr 30 cm 16/16 GA.	5
Catéteres Venosos Centrales, 3 LUMEN.		
CS-15123-E	3 LUMEN 12 Fr 20 cm 12/16/12 GA RAULERSON.	5
CS-15123-F	3 LUMEN 12 Fr 20 cm 12/16/12 GA RAULERSON.	5
CS-16123-F	3 LUMEN 12 Fr 25 cm 12/16/12 GA RAULERSON.	5
CS-12123-E	3 LUMEN 12 Fr 16 cm 12/16/12 GA RAULERSON.	5
CS-12123-F	3 LUMEN 12 Fr 16 cm 12/16/12 GA RAULERSON.	5
CS-12703-E	3 LUMEN 7 Fr 16 cm 16/18/18 GA RAULERSON.	5
CS-15553-E	3 LUMEN 5.5 Fr 8 cm 20/22/22 GA.	5
CS-16553-E	3 LUMEN 5.5 Fr 13 cm 20/22/22 GA.	5
CS-16853	3 LUMEN 8.5 Fr 20 cm 14/16/16 GA.	5
HO-14703	3 LUMEN 7 Fr 30 cm 16/18/18 GA.	5
ES-16703	3 LUMEN 7 Fr 40 cm 16/18/18 GA.	5
Catéteres Venosos Centrales Periféricos.		
PR-05042	2 LUMEN 4 Fr 50 cm 22/22 GA.	5
PR-05052	2 LUMEN 5 Fr 50 cm 18/20 GA.	5
PR-05052-LW	2 LUMEN 5 Fr 50 cm 18/20 GA.	5
PR-05052-MW	2 LUMEN 5 Fr 50 cm 18/20 GA.	5
PS-01652	2 LUMEN 5 Fr 50 cm 18/20.	10
PS-01672	2 LUMEN 5 Fr 70 cm 18/20.	10
Catéteres Venosos Centrales.		
CS-04300	16 GA, 20 cm.	10
ES-04218	18 GA, 20 cm.	10
ES-04400	16 GA, 30 cm.	10
ES-04522	22 GA, 10 cm.	10
ES-04706-P	14 GA, 16 Pulgadas.	10
ES-04730	14 GA, 30 cm.	10
CS-24706-E	14 GA, 16 cm.	10
Catéteres Venosos Centrales Periféricos.		
PR-05041	4 Fr x 50	5
PR-05041-LW	4 Fr x 50	5
PR-05041-MW	4 Fr x 50	5
PR-05041-T	4 Fr x 50	5
PS-01651	5 Fr x 50 cm.	10
PS-01671	5 Fr x 70 cm.	10
Catéteres Venosos Centrales Periféricos, 1 LUMEN.		
PK-01451	1 LUMEN 4Fr x 55 cm 18 GA.	5
Catéteres Venosos Centrales MAC.		
ML-00701	1 LUMEN 7 Fr 20 cm 12/12 GA.	5
ML-00702	2 LUMEN 7 Fr 20 cm 16/16 GA.	5
ML-00703	3 LUMEN 7 Fr 20 cm 16/18/18 GA.	5
SI-11142	2 LUMEN 9 Fr x 10 cm MAC.	5
SI-21142	2 LUMEN 9 Fr x 10 cm MAC ARROWGARD BLUE.	5

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras
Hoja 3 de 4 153300421N0118



Catéteres Venosos Centrales ARROW GARD		
Este producto puede causar shock anafiláctico por contener Clorhexidina y Sulfadiazina de plata, el medico deberá estar preparado para cualquier eventualidad.		
CS-27702-E	2 LUMEN 7 Fr 20 cm 14/18 GA Antiséptico.	5
CS-25703-E	3 LUMEN 7 Fr 20 cm 16/18/18 GA Antiséptico.	5
CS-25854-E	4 LUMEN 8.5 Fr 20 cm 14/18/16 GA Antiséptico.	5
CS-24301-E	1 LUMEN 16 Fr 20 cm Antiséptico.	10
CS-24701-E	1 LUMEN 14 Fr 20 cm Antiséptico.	10
CS-24306-E	1 LUMEN 16 Fr 16 cm Antiséptico.	10
CS-24703-E	3 LUMEN 7 Fr 16 cm Antiséptico.	5
CS-22502	2 LUMEN 5 Fr 5 cm GA Antiséptico.	5
CS-22854-E	4 LUMEN 5.5 Fr Antiséptico.	5
CS-22703-E	3 LUMEN 7 Fr 16 cm Antiséptico.	5
CS-25502	2 LUMEN 5 Fr 5 cm Antiséptico.	5
CS-22122-F	2 LUMEN 12 Fr 16 cm Antiséptico.	5
CS-25122-F	2 LUMEN 12 Fr 20 cm Antiséptico.	5
CS-22123-F	3 LUMEN 12 Fr 16 cm Antiséptico.	5
CS-25123-F	3 LUMEN 12 Fr 20 cm Antiséptico.	5
CU-26122-F	2 LUMEN 12 Fr 20 cm Antiséptico.	5
CS-25123-E	3 LUMEN 12 Fr 20 cm Antiséptico.	5
CS-25802-E	2 LUMEN 8 Fr 20 cm Antiséptico.	5
CS-26702-E	2 LUMEN 7 Fr 20 cm Antiséptico.	5
CS-24402	2 LUMEN 4 Fr 13 cm Antiséptico.	5

Caducidad: 60 meses.
 Publicidad: Profesionales de la Salud.
 Registro Sanitario vigente al: 13 de diciembre de 2015.
 Fecha de emisión: 07 de agosto de 2015.
 Fecha de vencimiento: 13 de diciembre de 2020.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD
Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

NORMA MORALES VILLA

OBSERVACIONES AL REGISTRO:

1. El presente Registro Sanitario es un documento auténtico expedido por el gobierno mexicano. Es un requisito indispensable pero no suficiente para la comercialización del producto autorizado, por lo que se expide sin interferir con disposiciones de otras dependencias.
2. La presente autorización será revocada ante cualquier alteración a las condiciones y términos en la que fue otorgada, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.
3. La importación, exportación, acondicionamiento, venta o suministro al público del producto autorizado deberá estar de acuerdo a las condiciones en las que se ha aprobado, por lo que el solicitante deberá especificar cada proceso, señalando el lugar en el cual se lleven a cabo (Razón Social y domicilio).
4. Las presentaciones para el Sector Salud deberán sujetarse a las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General por lo que su autorización no es competencia de esta Comisión.
5. La información contenida en las etiquetas o cartón etiquetas se deberá sujetar a lo establecido en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, deberá estar en idioma español y corresponder a lo autorizado en el presente documento.
6. El contenido de los manuales e instructivos de uso presentados ante esta Comisión, son responsabilidad del fabricante y del titular del Registro, debiendo cumplir con las disposiciones y reglamentación vigente.
7. Se otorga un plazo de 120 días para sujetar la existencia de material de envase y/o producto terminado previo a la presente autorización.
8. El Titular del registro sanitario deberá mantener vigentes la certificación de las buenas prácticas de fabricación durante la existencia del presente registro sanitario.

MINSIC/ALIGTA

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras
 Hoja 4 de 4 153308421N0118

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

COF

088397

Sistemas de Acceso Venoso Central de Arrow

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO.
LA-018GYR047-E79-2017
ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TÉCNICO MÉDICO, S.A. DE C.V.
CATALOGO 7
PARTIDA 19 Y PARTIDA 20


1. Descripción de los bienes

2. Características técnicas

3. Marca y modelo

4. Cantidad

5. Observaciones

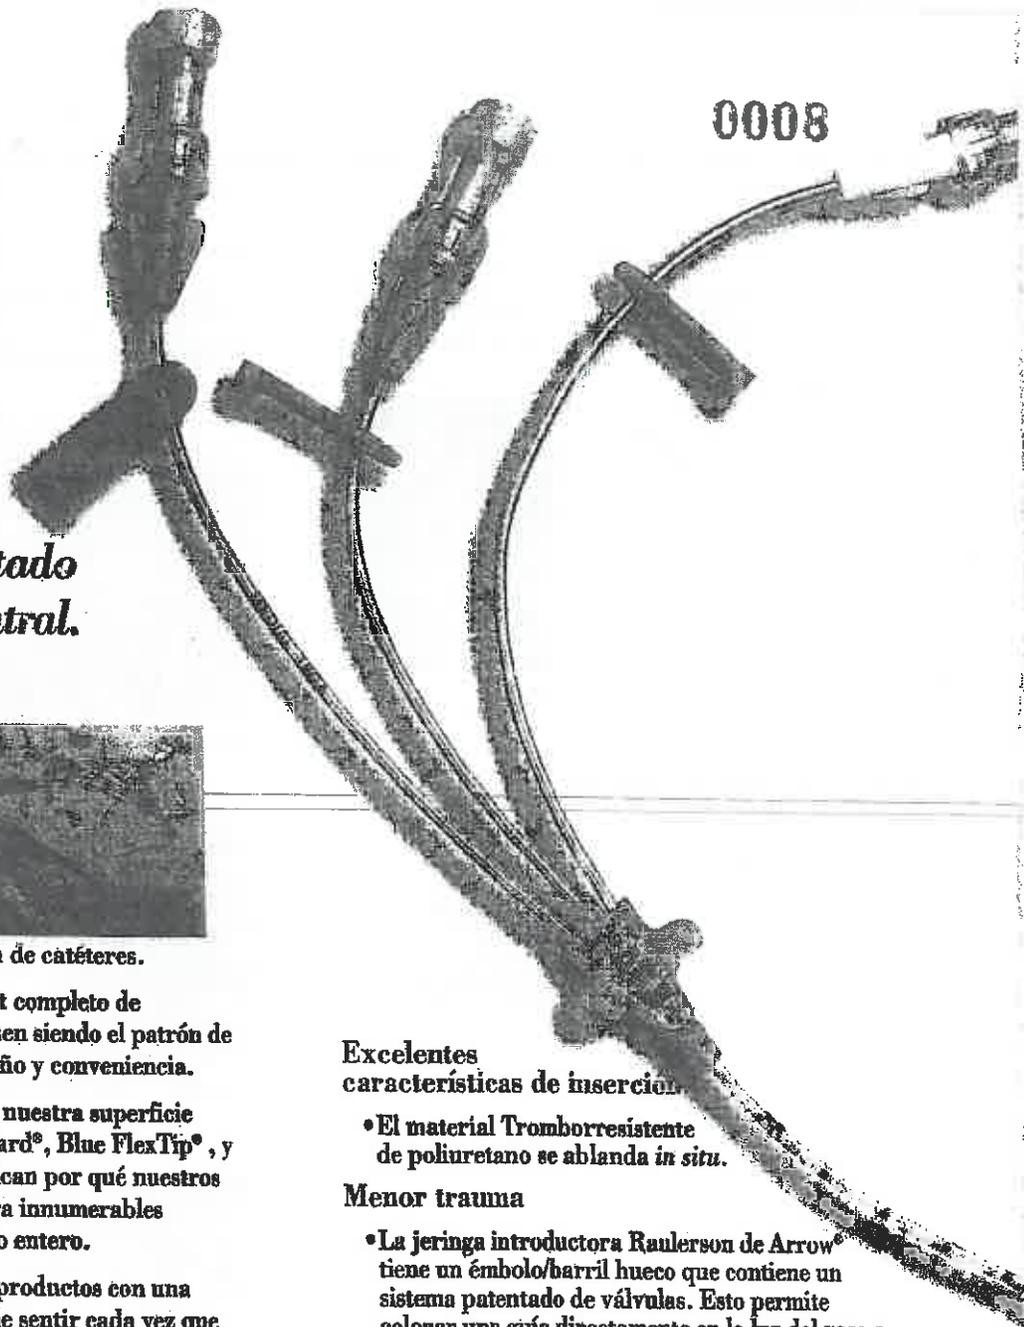

El nombre más respetado en acceso venoso central. Por diseño.

Arrow International ofrece la línea más amplia de catéteres en la industria. Ofrecemos más medidas, más tamaños, más longitudes, mayor variedad de flujos y los kits y sets más completos para los clínicos que cualquier otra compañía de catéteres.

De hecho, Arrow fue pionera en el kit completo de catéteres. Hoy, los kits de Arrow siguen siendo el patrón de referencia de la industria por su diseño y conveniencia.

Otras innovaciones exclusivas, como nuestra superficie antimicrobiana patentada ARROWgard®, Blue FlexTip®, y la jeringa Raulerson de Arrow® explican por qué nuestros catéteres son la primera elección para innumerables profesionales de la salud en el mundo entero.

Por encima de todo esto, ofrecemos productos con una calidad insuperable... algo que puede sentir cada vez que coloca un catéter de Arrow.

Alrededor del hospital y alrededor del mundo, Arrow continua siendo el nombre en el que más se confía en acceso venoso central. Preferido por millones.

Rendimiento probado. Impulsado por la Innovación™.

Menor daño interno, irritación y reducción del riesgo de perforación

- La característica de la mayoría de los catéteres Arrow es la punta Arrow Blue FlexTip, punta integrada en el catéter que es más flexible que el cuerpo del catéter. Permanece abierta aunque se deflacta en caso de contacto con la pared del vaso.



Arrow Blue FlexTip®

Excelentes características de inserción

- El material Tromborresistente de poliuretano se ablanda *in situ*.

Menor trauma

- La jeringa introductora Raulerson de Arrow tiene un émbolo/barril hueco que contiene un sistema patentado de válvulas. Esto permite colocar una guía directamente en la luz del vaso a través de la jeringa de manera que hay menos trauma, menos riesgo de exposición a la sangre y prácticamente sin posibilidad de embolismo gaseoso.

Colocaciones más eficientes

- Arrow Advancer™ le ahorra tiempo y dinero ayudándole a mantener recta la punta en J de la guía e insertarla con una mano, avanzándola hasta la posición adecuada con el pulgar. O si prefiere utilizar un tubo para enderezarla, la parte azul translúcida del tubo enderezador del Arrow Advancer puede desconectarse del resto y usarse de manera independiente.



Arrow Advancer™

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Posicionamientos más precisos

- Una guía con marcas de un centímetro (diámetros disponibles .025", .032" y .035") le permite conocer cuanta guía ha introducido y le ayuda a evitar entrar en el corazón. Y las marcas centimétricas del catéter le ayudan a determinar la profundidad de inserción.

Fiable y sencillo

- Líneas de extensión integrales transparentes con pinzas separables que le permiten mantener el catéter lejos de la zona de inserción, visualizar fácilmente la infusión y reducir el riesgo de embolismo gaseoso.



SharpsAway® Disposal Cup

Ayuda a prevenir accidentes

- SharpsAway® ofrece un método, simple aunque efectivo para eliminar objetos punzantes.

Mejora el confort del paciente

- Ejes de conexión moldeados y flexibles que mejoran el confort del paciente y facilitan su limpieza.




Jeringa Ruikerson Arrow®

Conveniencia


- Todo lo que necesita en un procedimiento CVC está incluido en la completa línea de Arrow de sets y kit standard de CVC.

Componente sin látex para seguridad y tranquilidad del paciente


La selección más extensa de catéteres standard y con protección contra infecciones del líder en Cateterización Venosa Central.

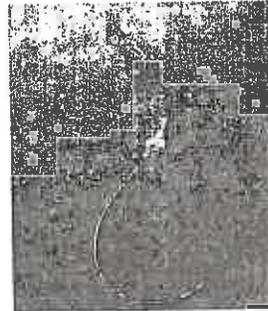


Catéteres de Una Luz

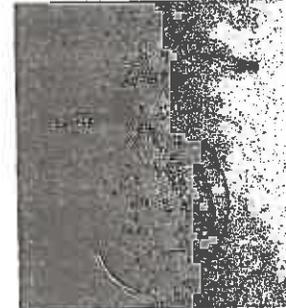


Catéteres de Dos Luces

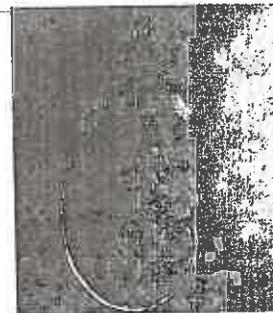

Catéteres de Tres Luces

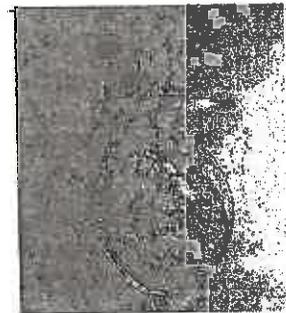

Catéteres de Cuatro Luces

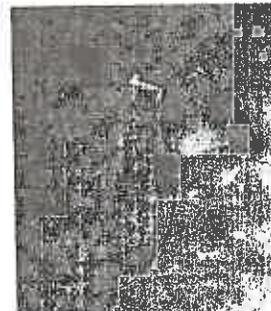


Catéteres Multi-Lumen
Pediátricos



Catéteres You-Bend®

- Arrow ofrece una amplia gama de catéteres venosos centrales para diferentes tallas de pacientes y sitios de inserción. Elegidos en todo el mundo por la administración simultánea de medicamentos, infusión de fluidos, muestras de sangre y monitorización venosa central — a través de una zona de acceso venoso central.
- Los catéteres están disponibles en diferentes longitudes, configuración de luces y diámetros desde 24 Ga. a 14 Fr. tanto en modelos standard como ARROWgard Blue®.

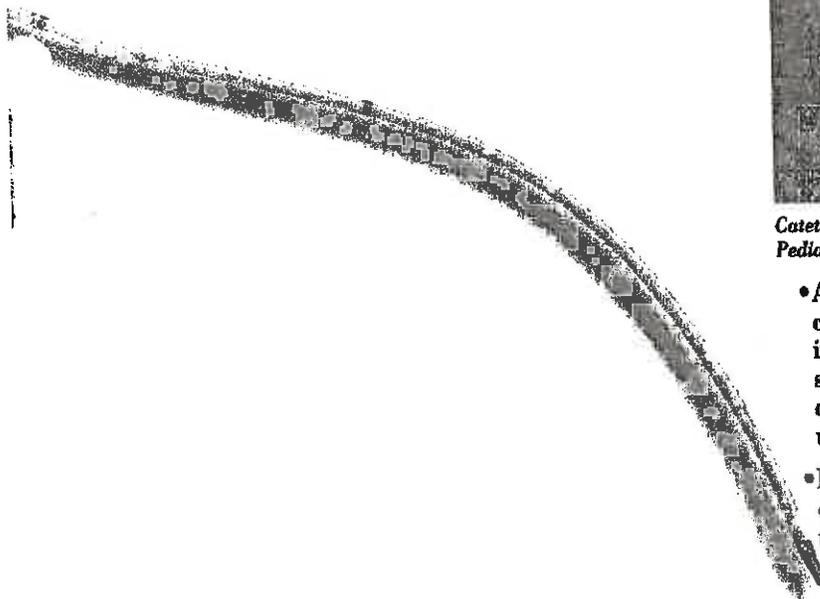

**Los Catéteres Venosos Centrales
ARROWgard Blue® son los únicos
CVC con una década de efectividad
antimicrobiana probada.**

Reconocida por su cuerpo azul, la tecnología ARROWgard está disponible en diferentes tamaños.

- Los CVCs ARROWgard Blue® presentan un recubrimiento resistente a la colonización que molecularmente une dos agentes, clorhexidina (un antiséptico muy conocido) y sulfadiazina de plata, sobre el catéter de poliuretano a lo largo de toda la superficie del catéter.
- Reduce la incidencia de bacteriemia relacionada con CVC hasta un 80%.⁵

Acción antimicrobiana probada contra los mayores patógenos nosocomiales relacionados con catéteres.⁴

Tiempo de permanencia más largo y más seguro.

- Un estudio clínico ha mostrado un considerable aumento del período seguro con los catéteres ARROWgard Blue® comparado con catéteres de control.⁴
- No se han encontrado niveles tóxicos de agentes antimicrobianos en el uso de los catéteres ARROWgard Blue®.

Virtualmente elimina el problema de la resistencia.

Costes sanitarios menores mediante la reducción del tiempo de estancia en el hospital.

Beneficios reales. Características revolucionarias. Mayores opciones.

Efectos en la reducción de costes de ARROWgard Blue®

Multi-lumen CVCs al año	Coste de infección	Coste de infección con ARROWgard Blue®**	Ahorro Total
500	\$580,000	\$116,000	\$464,000
1,000	1,160,000	232,000	928,000
2,000	2,320,000	464,000	1,856,000
5,000	5,800,000	1,160,000	4,640,000

* Asumiendo un 4% de infección (6 infecciones cada 1000 catéteres día).

**Asumiendo un 80% de reducción en infecciones.



**Ahora con
Protección
Antimicrobiana tanto
dentro como fuera.**

**La confianza en la
calidad de Arrow
MAS nuevos
beneficios para
mayor protección.**




Cateteres ARROWgard Blue PLUS®

Ayuda a prevenir las infecciones relacionadas con catéteres

- Todas las vías internas de fluidos están protegidas incluidas las líneas de extensión del catéter y los ejes de conexión.
- La superficie externa tiene ahora una actividad antimicrobiana de mayor duración.
- Los catéteres AGB® utilizan antisépticos probados, clorhexidina, acetato de clorhexidina y sulfadiazina de plata como agentes antimicrobianos.

Identificación del producto rápida y fácil


- El símbolo AGB® identifica la línea de producto ARROWgard Blue PLUS®
- Los gráficos del etiquetado son fáciles de reconocer - incluso apilados en la estantería.
- El eje del catéter es de color azul y muestra el símbolo AGB®

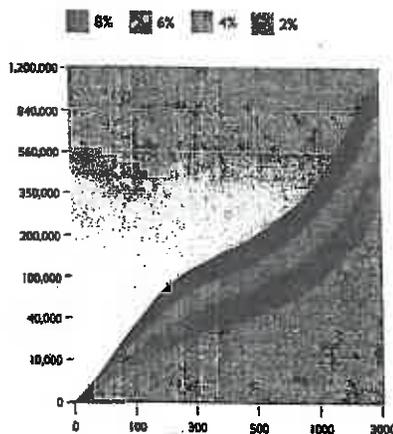

Cateteres colocados al año

Asumiendo 80% de reducción en las infecciones relacionadas con catéteres

MAC™ La mayor versatilidad del catéter de Acceso Multi-Lumen de Arrow (MAC™) proporciona una ventaja sobre otros dispositivos de acceso venoso

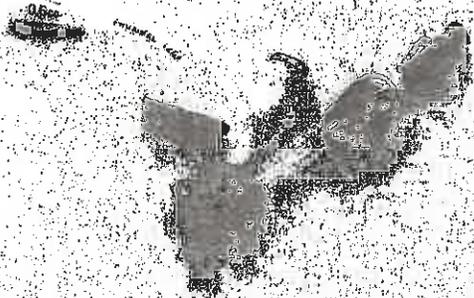

Cateter MAC™ de Arrow

El MAC™ de Arrow ofrece flujos mayores mientras se realiza una monitorización hemodinámica.


- Combina el alto flujo con la capacidad de tener un catéter de termodilución (TD) in situ para monitorización hemodinámica.

Diseñado para la máxima versatilidad:

- Tres Accesorios MAC™ Companion — catéteres de 1-luz, 2-luces y 3-luces — permiten expandir el acceso venoso central vía una única zona de inserción.
- Transición rápida y conveniente desde la infusión a la capacidad de monitorización o viceversa.



Arrow Peel-away Contamination Guard



MAC™ y MAC™ Companion de 2 luces ensamblados

SHARPSAWAY II

Arrow proporciona soluciones innovadoras contra las heridas por punción...

0011

...incrementando el margen de seguridad con los mínimos cambios.

La grapadora de Arrow proporciona un ahorro, alternativo y seguro a la sutura.

- Simplemente tense la piel y presione.
- Una opción rápida y limpia para asegurar catéteres.



Grapadora de Arrow

El receptáculo SharpsAway II™ de Arrow ofrece una forma fácil y segura de mover las agujas usadas de un procedimiento al contenedor.

- El receptáculo rojo y pequeño asegura y protege las agujas de varias formas.
- Con las agujas protegidas, el SharpsAway II™ puede eliminarse en los contenedores mayores del hospital para su destrucción final.



Receptáculo de almacenamiento Arrow SharpsAway II™

Escalpo Protegido añade seguridad y facilidad de uso.

- La hoja se retrae fácilmente en el mango del escalpo después de hacer la incisión en la piel.
- Protege contra las heridas accidentales.
- De colores brillantes para identificarlo fácilmente.



Escalpo protegido

Los CDC de Arrow y los Super Kits también contienen ARROWard Blue PLUS™, ChlorPrep® One-Step y grandes tallas quirúrgicas fenestradas.

- Ayuda a prevenir las infecciones relacionadas con catéteres incluyendo la nueva tecnología ARROWard Blue PLUS™ con protección antimicrobiana tanto interna como externa.
- ChlorPrep® One-Step alcanza las recomendaciones CDC/HA para la preparación rápida y permanente de la piel en el sitio de inserción.
- Papeo estéril de 41" x 55" de ancho que aumenta la barrera de protección.
- Ayuda a reducir las heridas cortopunzantes incluyendo todos los componentes de Seguridad de Arrow.

Producto No.	Medidas del Catéter	No. de Lucas	Sección Calibre*	Guía	Medicación	Sutura	Arrow® Jeringa Boulerson	Dilatador Vascular	Unidades/ Caja	CE
Kits de Cateterización Multi-Lumen										
AK-12123-F	12 Fr. x 6" Poliuretano	3	F-12, 12, 16	.035" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-12123-II	12 Fr. x 6" Poliuretano	3	F-12, 12, 16	.035" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-12402	4 Fr. x 2" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-12702	7 Fr. x 6" Poliuretano	2	H-18, 14	.025" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-12702-SP	7 Fr. x 6" Poliuretano	2	H-18, 14	.025" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-12702-CDC	7 Fr. x 6" Poliuretano	2	H-18, 14	.025" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-12703	7 Fr. x 6" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-12703-B	7 Fr. x 6" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.025" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-12703-CDC	7 Fr. x 6" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.025" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-12703-SP	7 Fr. x 6" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.025" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-12802	8 Fr. x 6" Poliuretano	2	A-14, 14	.032" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-12802-SP	8 Fr. x 6" Poliuretano	2	A-14, 14	.032" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-14402	4 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-14412	4 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-14502	5 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	2	A-18, 20	.021" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-14553	5.5 Fr. x 12" Poliuretano	3	E-20, 22, 22	.018" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-14703	7 Fr. x 12" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-14703-A	7 Fr. x 12" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-14703-H	7 Fr. x 12" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-14703-SP	7 Fr. x 12" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-15123-F	12 Fr. x 6" Poliuretano	3	F-12, 12, 16	.035" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-15123-II	12 Fr. x 6" Poliuretano	3	F-12, 12, 16	.035" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-15402	4 Fr. x 3-1/8" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-15553	5.5 Fr. x 3-1/8" Poliuretano	3	E-20, 22, 22	.018" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-15703	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-15703-A	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-15703-ACDC	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-15703-ASP	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-15703-B	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-15703-BCDC	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-15703-BSP	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-15703-CDC	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-15703-H	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-15703-SP	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-15902	8 Fr. x 8" Poliuretano	2	A-14, 14	.032" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-16402	4 Fr. x 12" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-16553	5.5 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	3	E-20, 22, 22	.018" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-16702	7 Fr. x 8" Poliuretano	2	E-16, 16	.032" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-16702-CDC	7 Fr. x 8" Poliuretano	2	E-16, 16	.032" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-17702	7 Fr. x 8" Poliuretano	2	D-14, 18	.032" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-17702-CDC	7 Fr. x 8" Poliuretano	2	D-14, 18	.032" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-17702-SP	7 Fr. x 8" Poliuretano	2	D-14, 18	.032" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
BB-12702	7 Fr. x 6" Poliuretano	2	D-14, 18	.032" J/SST	X	St. Silk		X	10	N
CK-03000-B	7 Fr. x 6" Poliuretano	2	B-16, 16	.032" J/SST		St. Silk		X	5	Y
NB-12703	7 Fr. x 6" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
YN-15703	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST	X	St. Nylon		X	5	N

Códigos de la guía:

SST = Punta blanca recta
J = Punta blanca en J
M = Marcada

Códigos de Sutura:

St. Silk = Aguja recta, Seda trenzada
St. Nylon = Aguja recta,
Nylon monofilamento

Kits completos: contienen todas las agujas necesarias, jeringas, paños, etc. para la realización de procedimientos de cateterización.

Set: solo contienen los elementos clave.

* Hacer referencia al Diagrama de Sección de la página 11.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Producto No.	Medidas del Catéter	No. de Luces	Sección Calibre*	Guía	Medicación	Sutura	Arrow® Jeringa Raulerson	Dilatador Vascular	Unidades/ Caja	CE
Set de Cateterización Multi-Lumen										
CS-12123-E	12 Fr. x 6" Poliuretano	3	F-12, 12, 16	.035" 'J'/SST				X	5	Y
CS-12123-F	12 Fr. x 6" Poliuretano	3	F-12, 12, 16	.035" 'J'/SST			X	X	5	Y
CS-12402	4 Fr. x 2" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" 'J'/SST				X	5	Y
CS-12702-E	7 Fr. x 6" Poliuretano	2	D-14, 18	.025" 'J'/SST			X	X	5	Y
CS-12703	7 Fr. x 6" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST				X	5	Y
CS-12703-E	7 Fr. x 6" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST			X	X	5	Y
CS-12802	8 Fr. x 6" Poliuretano	2	A-14, 14	.032" 'J'/SST				X	5	Y
CS-14402	4 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" 'J'/SST				X	5	Y
CS-14502	5 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	2	A-18, 20	.021" 'J'/SST				X	5	Y
CS-14553	5.5 Fr. x 12" Poliuretano	3	E-20, 22, 22	.018" 'J'/SST				X	5	Y
CS-14703	7 Fr. x 12" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST				X	5	Y
CS-14703-E	7 Fr. x 12" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST			X	X	5	Y
CS-14703-M	7 Fr. x 12" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST				X	5	N
CS-14854-E	8.5 Fr. x 12" Poliuretano	4	G-14, 18, 16, 18	.032" 'J'/SST			X	X	5	Y
CS-15123-E	12 Fr. x 8" Poliuretano	3	F-12, 12, 16	.035" 'J'/SST			X	X	5	Y
CS-15123-F	12 Fr. x 8" Poliuretano	3	F-12, 12, 16	.035" 'J'/SST			X	X	5	Y
CS-15402-E	4 Fr. x 3-1/8" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" 'J'/SST				X	5	Y
CS-15553-E	5.5 Fr. x 8-1/8" Poliuretano	3	E-20, 22, 22	.018" 'J'/SST				X	5	Y
CS-15703	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST				X	5	Y
CS-15703-E	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST			X	X	5	Y
CS-15703-H	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18	.032" 'J'/SST				X	5	N
CS-15802-E	8 Fr. x 8" Poliuretano	2	A-14, 14	.032" 'J'/SST			X	X	5	Y
CS-15854-E	8.5 Fr. x 8" Poliuretano	4	G-14, 18, 16, 18	.032" 'J'/SST			X	X	5	Y
CS-16123-F	12 Fr. x 10" Poliuretano	3	F-12, 12, 16	.035" 'J'/SST			X	X	5	Y
CS-16402	4 Fr. x 12" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" 'J'/SST				X	5	Y
CS-16553-E	5.5 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	3	E-20, 22, 22	.018" 'J'/SST				X	5	Y
CS-16702	7 Fr. x 8" Poliuretano	2	B-16, 16	.032" 'J'/SST				X	5	Y
CS-16702-E	7 Fr. x 8" Poliuretano	2	B-16, 16	.032" 'J'/SST			X	X	5	Y
CS-17702	7 Fr. x 8" Poliuretano	2	D-14, 18	.032" 'J'/SST				X	5	Y
CS-17702-E	7 Fr. x 8" Poliuretano	2	D-14, 18	.032" 'J'/SST			X	X	5	Y
CS-17752	7 Fr. x 24" Poliuretano	2	D-14, 18	.032" 'J'/SST			X	X	5	Y
CS-18702	7 Fr. x 16" Poliuretano	2	B-16, 16	.032" 'J'/SST				X	5	Y
ES-14402	4 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" SST/SST				X	5	Y
ES-14702	7 Fr. x 12" Poliuretano	2	B-16, 16	.032" 'J'/SST				X	5	Y

PARTIDA 19
080.166.1903.03.01

IDA 20
080.166.1911.03.01

Códigos de la guía: SST = Punta blanda recta
 'J' = Punta blanda en 'J'
 M = Marcada

Códigos de Sutura: St. Silk = Aguja recta, seda trenzado
 St. Nylon = Aguja recta, Nylon monofilamento

Kits completos: contienen todas las agujas necesarias, jeringas, paños, etc. para la realización de procedimientos de cateterización.
 Sets: sólo contienen los elementos clave.

* Hace referencia al diagrama de sección de la página 11.

Producto No.	Medidas del Catéter	No. de Luces	Sección Calibre*	Guía	Medicación	Sutura	Arrow® Jeringa Raulerson	Dilatador Vascular	Unidades/ Caja	CE
Cateteres Multi-Lumen										
ES-18703	7 Fr. x 16" Poliuretano	3	E-16, 18, 18						5	Y
HO-14702	7 Fr. x 12" Poliuretano	2	B-16, 16						5	Y
HO-14703	7 Fr. x 12" Poliuretano	3	E-16, 18, 18						5	Y
MC-12123	12 Fr. x 6" Poliuretano	3	F-12, 12, 16						5	Y
MC-12702	7 Fr. x 6" Poliuretano	2	D-14, 18						5	Y
MC-12703	7 Fr. x 6" Poliuretano	3	E-16, 18, 18						5	Y
MC-14703	7 Fr. x 12" Poliuretano	3	E-16, 18, 18						5	Y
MC-15123	12 Fr. x 8" Poliuretano	3	F-12, 12, 16						5	Y
MC-15703	7 Fr. x 8" Poliuretano	3	E-16, 18, 18						5	Y
MC-16702	7 Fr. x 8" Poliuretano	2	B-16, 16						5	Y
MC-17702	7 Fr. x 8" Poliuretano	2	D-14, 18						5	Y

Kits de Cateterización Multi-Lumen ARROWgard Blue®

AK-22183	12 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	3	F-12, 12, 16	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-22123-F	12 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	3	F-12, 12, 16	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-22123-SK	12 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	3	F-12, 12, 16	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-22502	6 Fr. x 2" Antimicrobiano/Poliuretano	2	A-18, 20	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-22702	7 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	2	E-16, 16	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-22703	7 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-22802	8 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	2	A-14, 14	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-22802-CEG	8 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	2	A-14, 14	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-22802-SK	8 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	3	A-14, 14	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-22854	6.5 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	4	C-14, 18, 18, 18	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-22854-SK	6.5 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	4	C-14, 18, 18, 18	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-24402	8 Fr. x 6-1/8" Antimicrobiano/Poliuretano	2	B-20, 22	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-24703	7 Fr. x 12" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-24703-A	7 Fr. x 12" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-24703-B	7 Fr. x 12" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-24703-ASK	7 Fr. x 12" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-24703-SK	7 Fr. x 12" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-24854	6.5 Fr. x 12" Antimicrobiano/Poliuretano	4	C-14, 18, 18, 18	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-25123	12 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	3	F-12, 12, 16	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-25123-F	12 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	3	F-12, 12, 16	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-25502	6 Fr. x 5-1/8" Antimicrobiano/Poliuretano	2	A-18, 20	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-25703	7 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	Y
AK-25703-A	7 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-25703-B	7 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	3	E-16, 18, 18	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-25802	8 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	2	A-14, 14	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-25802-SK	8 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	2	A-14, 14	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-25854	6.5 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	4	C-14, 18, 18, 18	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-25854-SK	6.5 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	4	C-14, 18, 18, 18	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-26702	7 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	2	B-16, 16	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-27702	7 Fr. x 6" Antimicrobiano/Poliuretano	2	D-14, 18	0.02" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N

Códigos de la guía:

SST = Punta blanda recta
 ' = Punta blanda en ' '
 M = Marcado

Códigos de Sutura:

St. Silk = Aguja recta, Seda trenzada
 St. Nylon = Aguja recta, Nylon monofilamento

Kits completos: contienen todas las agujas necesarias, jeringas, paños, etc. para la realización de procedimientos de cateterización.
 Sets: solo contienen los elementos clave.

* Hacer referencia al Diagrama de Sección de la página 11.

Producto No.	Medidas del Catéter	No. de Luces	Sección Calibre*	Guía	Medicación	Sutura	Arrow® Jeringa Raulerson	Dilatador Vascular	Unidades/Caja	CE
Kits de Cateterización Multi-Lumen ARROWgard Blue® (continuación)										
AK-35703-A	7 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-35703-B	7 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	3	E-16, 18, 18	.035" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
NR-22703	7 Fr. x 6° Antimicrobiano/Poluretano	3	E-16, 18, 18	.035" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
NR-22802-B	8 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	2	A-14, 14	.025" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
NR-25854	8.5 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	4	C-14, 16, 16, 16	.032" J/SST	X	St. Silk		X	5	N

Sets de Cateterización Multi-Lumen ARROWgard Blue®										
CS-22123-F	12 Fr. x 6° Antimicrobiano/Poluretano	3	F-12, 12, 16	.035" J/SST			X	X	5	Y
CS-22502	5 Fr. x 2° Antimicrobiano/Poluretano	2	A-18, 20	.021" J/SST				X	5	Y
CS-24402	4 Fr. x 5-1/8° Antimicrobiano/Poluretano	2	A-18, 20	.018" J/SST				X	5	Y
CS-24703-E	7 Fr. x 12° Antimicrobiano/Poluretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST			X	X	5	Y
CS-25123-E	12 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	3	F-12, 12, 16	.035" J/SST			X	X	5	Y
CS-25123-F	12 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	3	F-12, 12, 16	.035" J/SST			X	X	5	Y
CS-25502	5 Fr. x 3-1/8° Antimicrobiano/Poluretano	2	A-16, 20	.021" J/SST				X	5	Y
CS-25802-E	8 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	2	B-14, 14	.032" J/SST			X	X	5	Y
CS-25854-E	8.5 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	4	C-14, 16, 16, 16	.032" J/SST			X	X	5	Y
CS-28702	7 Fr. x 14° Antimicrobiano/Poluretano	2	B-16, 16	.035" J/SST				X	5	Y

Kits de Cateterización Multi-Lumen AGB® ARROWgard Blue PLUS®										
AK-42702	7 Fr. x 6° Antimicrobiano/Poluretano	2	H-18, 14	.025" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-42702-CDC	7 Fr. x 6° Antimicrobiano/Poluretano	2	H-18, 14	.025" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-42702-SK	7 Fr. x 6° Antimicrobiano/Poluretano	2	H-18, 14	.025" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-42703	7 Fr. x 6° Antimicrobiano/Poluretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-42703-C	7 Fr. x 6° Antimicrobiano/Poluretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-42703-SK	7 Fr. x 6° Antimicrobiano/Poluretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-42703-AX	7 Fr. x 6° Antimicrobiano/Poluretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST	X	None	X	X	5	N
AK-42703-CDC	7 Fr. x 6° Antimicrobiano/Poluretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-42704-BSK	7 Fr. x 6° Antimicrobiano/Poluretano	3	E-16, 18, 18	.025" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-45703	7 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-45703-A	7 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-45703-ASK	7 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-45703-AX	7 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-45703-B	7 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	3	E-16, 18, 18	.025" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-45703-BSK	7 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	3	E-16, 18, 18	.025" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-45703-BX	7 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	3	E-16, 18, 18	.025" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-45703-C	7 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	3	E-16, 18, 18	.025" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-45704-AC	7 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	3	E-16, 18, 18	.025" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-45704-AVC	7 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	3	E-16, 18, 18	.025" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-45704-BC	7 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	3	E-16, 18, 18	.025" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-45704-CDC	7 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	3	E-16, 18, 18	.025" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-45704-ACDC	7 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	3	E-16, 18, 18	.025" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-45704-BCDC	7 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	3	E-16, 18, 18	.025" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-45704-SK	7 Fr. x 12° Antimicrobiano/Poluretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-46702-CDC	7 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	2	B-16, 16	.025" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-46702	7 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	2	B-16, 16	.032" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-46702-SK	7 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	2	B-16, 16	.032" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-47702	7 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	2	D-14, 14	.032" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-47702-SK	7 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	2	D-14, 14	.032" J/SST	X	St. Silk		X	5	N

Sets de Cateterización Multi-Lumen AGB® ARROWgard Blue PLUS®										
CS-22702-E	7 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	2	D-14, 18	.032" J/SST			X	X	5	Y**
CS-22703-E	7 Fr. x 6° Antimicrobiano/Poluretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST			X	X	5	Y**
CS-25703-E	7 Fr. x 6° Antimicrobiano/Poluretano	3	E-16, 18, 18	.032" J/SST			X	X	5	Y**
CS-26702-E	7 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	2	B-16, 16	.032" J/SST			X	X	5	Y**
CS-27702-E	7 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	2	D-14, 18	.032" J/SST			X	X	5	Y**
CS-45703-E	7 Fr. x 8° Antimicrobiano/Poluretano	3	E-16, 18, 18	.025" J/SST	X	St. Silk	X	X	5	Y**

Códigos de la guía: SST = Punto blanco recto
 T = Punto blanco en T
 M = Mordido

Códigos de Sutura: St. Silk = Aguja recta, Seda trenzada
 St. Nylon = Aguja recta, Nylon monofilamento

Kits completos: contienen todas las agujas necesarias, jeringas, paños, etc. para la realización de procedimientos de cateterización.
 Sets: solo contienen los elementos clave.

* Hacer referencia al Diagrama de Sección de la página 11. ** Marcado CE w/AGB® pendiente.

No. Producto	Medidas del Catéter	No. de Lúmenes	Sección Catéter	Guía	Medicación	Sutura	Arrow Jeringa Rayson	Dilatador Vascular	Unidades Caja	CS
Kits de Cateterización Venosa Central ARROWgard Blue®										
AK-2450	16 Ga. x 6" Antimicrobial Polyurethane			0.55" T/SSST	X	St. Silk	X	X	10	N
AK-2451-SK	16 Ga. x 6" Antimicrobial Polyurethane			0.55" T/SSST	X	St. Silk	X	X	10	N
AK-2456	16 Ga. x 6" Antimicrobial Polyurethane			0.55" T/SSST	X	St. Silk		X	10	N
Sets de Cateterización Venosa Central ARROWgard Blue®										
CS-2450-F	16 Ga. x 6" Antimicrobial Polyurethane			0.55" T/SSST			X	X	10	F
CS-2456-F	16 Ga. x 6" Antimicrobial Polyurethane			0.55" T/SSST			X	X	10	F
CS-2470-F	14 Ga. x 8" Antimicrobial Polyurethane			0.55" T/SSST			X	X	10	F
CS-2490-F	14 Ga. x 8" Antimicrobial Polyurethane			0.55" T/SSST			X	X	10	F
Kits de Cateterización para Hemodiálisis de dos lúmenes ARROWgard Blue®										
AE-2512	12 Fr. x 6" Antimicrobial Polyurethane	2	A-12-12	0.55" T/SSSTM	X	St. Silk	X	X	5	N
AE-2512-F	12 Fr. x 6" Antimicrobial Polyurethane	2	A-12-12	0.55" T/SSSTM	X	St. Silk	X	X	5	N
AE-2512	12 Fr. x 6" Antimicrobial Polyurethane	2	A-12-12	0.55" T/SSSTM	X	St. Silk	X	X	5	N
AE-2522-F	12 Fr. x 6" Antimicrobial Polyurethane	2	A-12-12	0.55" T/SSSTM	X	St. Silk	X	X	5	N
Sets de Cateterización para Hemodiálisis de dos lúmenes ARROWgard Blue®										
CS-2512-F	12 Fr. x 6" Antimicrobial Polyurethane	2	A-12-12	0.55" T/SSSTM			X	X	5	F
CS-2512-F	12 Fr. x 6" Antimicrobial Polyurethane	2	A-12-12	0.55" T/SSSTM			X	X	5	F
CS-2522-F	12 Fr. x 6" Antimicrobial Polyurethane	2	A-12-12	0.55" T/SSSTM			X	X	5	F
Cateteres de Hemodiálisis de dos lúmenes ARROWgard Blue®										
HC-2512-F	12 Fr. x 6" Antimicrobial Polyurethane	2	A-12-12						5	F
HC-2522-F	12 Fr. x 6" Antimicrobial Polyurethane	2	A-12-12						5	F
Kits de Cateterización ARROWgard Blue® You-Band®										
AU-2512-F	12 Fr. x 6" Antimicrobial Polyurethane	2	A-12-12	0.55" T/SSSTM	X	St. Silk	X	X	5	N
AU-2512-F	12 Fr. x 6" Antimicrobial Polyurethane	2	A-12-12	0.55" T/SSSTM	X	St. Silk	X	X	5	N
AU-2522-F	12 Fr. x 6" Antimicrobial Polyurethane	2	A-12-12	0.55" T/SSSTM	X	St. Silk	X	X	5	N
Sets de Cateterización ARROWgard Blue® You-Band®										
CU-2512-F	12 Fr. x 6" Antimicrobial Polyurethane	2	A-12-12	0.55" T/SSSTM			X	X	5	F
CU-2512-F	12 Fr. x 6" Antimicrobial Polyurethane	2	A-12-12	0.55" T/SSSTM			X	X	5	F
CU-2522-F	12 Fr. x 6" Antimicrobial Polyurethane	2	A-12-12	0.55" T/SSSTM			X	X	5	F
Kits Pediréticos de Cateterización Multi-Lumen ARROWgard Blue®										
AK-2550	5 Fr. x 2.1" Antimicrobial Polyurethane	2	A-5-2.1	0.55" T/SSST	X	St. Silk		X	5	N
AK-2550	5 Fr. x 2.1" Antimicrobial Polyurethane	2	A-5-2.1	0.55" T/SSST	X	St. Silk		X	5	N
AK-2550	5 Fr. x 2.1" Antimicrobial Polyurethane	2	A-5-2.1	0.55" T/SSST	X	St. Silk		X	5	N
AK-2550	5 Fr. x 2.1" Antimicrobial Polyurethane	2	A-5-2.1	0.55" T/SSST	X	St. Silk		X	5	N
AK-2550	5 Fr. x 2.1" Antimicrobial Polyurethane	2	A-5-2.1	0.55" T/SSST	X	St. Silk		X	5	N
Kits Pediréticos de Cateterización Multi-Lumen ARROWgard Blue®										
CS-2550	5 Fr. x 2.1" Antimicrobial Polyurethane	2	A-5-2.1	0.55" T/SSST			X	X	5	F
CS-2550	5 Fr. x 2.1" Antimicrobial Polyurethane	2	A-5-2.1	0.55" T/SSST			X	X	5	F
CS-2550	5 Fr. x 2.1" Antimicrobial Polyurethane	2	A-5-2.1	0.55" T/SSST			X	X	5	F

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

No. Producto	Medidas del Catéter	No. de Luças	Sección Calibre*	Guía	Medicación	Sutura	Arrow® Jeringa Roulterson	Dilatador Vascular	Unidades/ Caja	CE
Kits de Cateterización Venosa Central										
AK-04050	16 Ga. x 6'			.032" SST/SST				X	20	Y
AK-04150-E	20 Ga. x 5'			.025" J/SST				X	10	Y
AK-04200	16 Ga. x 8"			.032" J/SST		St. Silk		X	10	N
AK-04210	16 Ga. x 8"			.032" J/SST	X	St. Silk		X	10	N
AK-04211	16 Ga. x 8"			.032" J/SST	X	St. Silk		X	10	N
AK-04212	16 Ga. x 8"			.032" J/SST	X	St. Silk		X	10	N
AK-04225	16 Ga. x 8"			.025" J/SST	X	St. Silk		X	10	N
AK-04250	16 Ga. x 35"			.032" J/SST	X			X	10	N
AK-04300	16 Ga. x 8"			.032" J/SST	X	St. Silk		X	10	N
AK-04301	16 Ga. x 8"			.032" J/SST	X	St. Silk		X	10	N
AK-04301-SP	16 Ga. x 8"			.032" J/SST	X	St. Silk		X	10	N
AK-04306	16 Ga. x 6'			.032" J/SST	X	St. Nylon		X	10	N
AK-04306-SP	16 Ga. x 6'			.032" J/SST	X	St. Nylon		X	10	N
AK-04400	16 Ga. x 12"			.032" J/SST		St. Silk		X	10	N
AK-04522	22 Ga. x 4"			.021" J/SST		St. Silk		X	10	N
AK-04550	20 Ga. x 5"			.025" J/SST	X	St. Silk			10	Y
AK-04650-E	24 Ga. x 3-1/2"			.018" J/SST					10	Y
AK-04660	24 Ga. x 5"			.018" J/SST					10	Y
AK-04700	14 Ga. x 8"			.032" J/SST		St. Silk		X	10	N
AK-04800	16 Ga. x 6'			.032" J/SST	X	St. Silk		X	10	N
AK-04825	16 Ga. x 6'			.025" J/SST		St. Silk	X	X	10	Y
CK-04711	14 Ga. x 6'			.032" J/SST	X	St. Silk		X	10	N
SL-04710	14 Ga. x 8"			.032" J/SST	X	St. Silk		X	10	N
Sets de Cateterización Venosa Central										
CS-04225	16 Ga. x 8"			.025" J/SST				X	10	Y
CS-04300	16 Ga. x 8"			.032" J/SST				X	10	Y
CS-04400	16 Ga. x 12"			.032" J/SST				X	10	Y
CS-04700	14 Ga. x 8"			.032" J/SST				X	10	Y
CS-04701	14 Ga. x 8"			.032" J/SST				X	10	Y
ES-04150	20 Ga. x 5"			.025" J/SST				X	10	Y
ES-04218	18 Ga. x 8"			.025" J/SST				X	10	Y
ES-04300	16 Ga. x 8"			.032" J/SST				X	10	Y
ES-04301	16 Ga. x 8"			.032" J/SST				X	10	Y
ES-04301-P	16 Ga. x 8"			.032" J/SST				X	10	Y
ES-04306	16 Ga. x 6'			.032" J/SST				X	10	Y
ES-04400	16 Ga. x 12"			.032" J/SST				X	10	Y

Códigos de la guía:


SST = Punta blanca recta
 J = Punta blanca en 'J'
 M = Marcada

Códigos de Sutura:

St. Silk = Aguja recta, Seda trenzada
 St. Nylon = Aguja recta,
 Nylon monofilamento

Kits completos: contienen todos los agujeros necesarios, jeringas, paños, etc.
 para la realización de procedimientos de cateterización.
 Sets: solo contienen los elementos clave.

* Hacer referencia al Diagrama de Sección de la página 11.
 ** No se vende en los Estados Unidos.

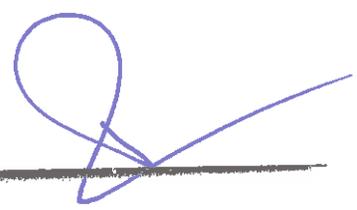

No. Producto	Medidas del Catéter	No. de Luces	Sección Calibre*	Guía	Medicación	Sutura	Arrow® Jeringa Roulerson	Dilatador Vascular	Unidades/Caja	CE
Sets de Cateterización Venosa Central (continuación)										
ES-04522	22 Ga. x 4"			.021" SST/SST				X	10	Y
ES-04700	14 Ga. x 8"			.032" J/SST				X	10	Y
ES-04701	14 Ga. x 8"			.032" J/SST			X	X	10	Y
ES-04701-P	14 Ga. x 8"			.032" J/SST			X	X	10	Y
ES-04706	14 Ga. x 6"			.032" J/SST			X	X	10	Y
ES-04706-P	14 Ga. x 6"			.032" J/SST			X	X	10	Y
ES-04730	14 Ga. x 12"			.032" J/SST				X	10	Y

Catéteres Venosos Centrales

ID-04200	16 Ga. x 8"								25	Y
ID-04301	16 Ga. x 8"								25	Y
ID-04700	14 Ga. x 8"								25	Y

Catéteres de Acceso Multi-Lumen MAC™

AK-11142	14 Fr. x 4"	2	9 Fr., 12	.035" J/SST	X	St. Silk	X	X	10	N
AK-11142-D	14 Fr. x 4"	2	9 Fr., 12	.035" J/SST	X	St. Silk	X	X	10	N
AK-11142-SPC	14 Fr. x 4"	2	9 Fr., 12	.035" J/SST	X	St. Silk	X	X	10	N
AK-21242-HDC	14 Fr. x 4.5"	2	9 Fr., 12	.035" J/SST	X	St. Silk	X	X	10	N
AK-21142-SK	14 Fr. x 4"	2	9 Fr., 12	.035" J/SST	X	St. Silk	X	X	10	N
AK-21242-X	14 Fr. x 4.5"	2	9 Fr., 12	.035" J/SST	X	St. Silk	X	X	10	N
AK-21242-CDC*	14 Fr. x 4.5"	3	9 Fr., 14, 14	.035" J/SST	X	St. Silk	X	X	10	N
CA-11142	14 Fr. x 4"	2	9 Fr., 12	.035" J/SST		St. Silk	X	X	10	Y
SI-11142	14 Fr. x 4"	2	9 Fr., 12	.035" J/SST		St. Silk	X	X	5	Y
SI-21342	14 Fr. x 4"	2	9 Fr., 12	.035" J/SST		St. Silk	X	X	5	Y

Productos Companion MAC™

ML-00701	7 Fr. Polyurethane	1							5	Y
ML-00702	7 Fr. Polyurethane	2	B-16, 16						5	Y
ML-00703	7 Fr. Polyurethane	3	E-16, 18, 18						5	Y
SC-14701	7 Fr. Polyurethane	1							25	Y

Kits de Cateterización para Hemodiálisis de dos luces

AK-12122-F	12 Fr. x 6" Polyurethane	2	A-12, 12	.035" J/SST/M	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-12122-H	12 Fr. x 6" Polyurethane	2	A-12, 12	.035" J/SST/M	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-15122-F	12 Fr. x 8" Polyurethane	2	A-12, 12	.035" J/SST/M	X	St. Silk	X	X	5	N
AK-15122-H	12 Fr. x 8" Polyurethane	2	A-12, 12	.035" J/SST/M	X	St. Silk	X	X	5	N


Sets de Cateterización para Hemodiálisis de dos luces

CS-12122-E	12 Fr. x 6" Polyurethane	2	A-12, 12	.035" J/SST/M			X	X	5	Y
CS-12122-F	12 Fr. x 6" Polyurethane	2	A-12, 12	.035" J/SST/M			X	X	5	Y
CS-15122-E	12 Fr. x 8" Polyurethane	2	A-12, 12	.035" J/SST/M			X	X	5	Y
CS-15122-F	12 Fr. x 8" Polyurethane	2	A-12, 12	.035" J/SST/M			X	X	5	Y
CU-13122-F	12 Fr. x 8" Polyurethane	2	A-12, 12	.035" J/SST/M			X	X	5	Y

Catéteres para Hemodiálisis de dos luces

HC-12122-F	12 Fr. x 6" Polyurethane	2	A-12, 12	.035" J/SST/M			X	X	5	Y
HC-15122-F	12 Fr. x 8" Polyurethane	2	A-12, 12	.035" J/SST/M			X	X	5	Y

Diagrama de Sección

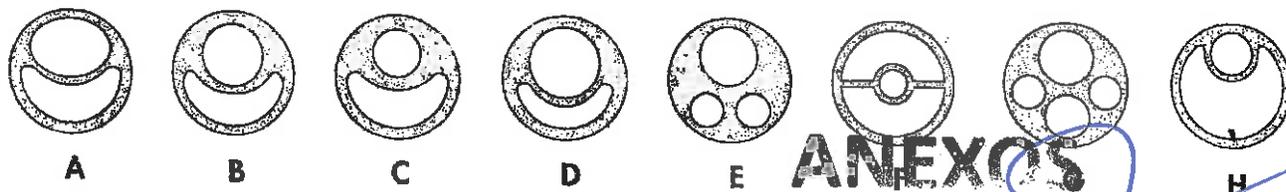

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

* Póngase en contacto con su distribuidor local de Arrow para obtener información sobre la disponibilidad de productos.

No. Producto	Medidas del Catéter	No. de Luces	Sección Calibra*	Guía	Medicación	Sutura	Arrow® Jeringa Raulerson	Dilatador Vascular	Unidades Caja	CE
Kits Pediátricos para Cateterización Multi-Lumen										
AK-12402	4 Fr. x 2" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-14402	4 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-14412	4 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" J/SST		St. Silk		X	5	N
AK-14502	5 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	2	A-18, 20	.021" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-14553	5.5 Fr. x 12" Poliuretano	3	E-20, 22, 22	.018" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-15402	4 Fr. x 3-1/8" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-15553	5.5 Fr. x 3-1/8" Poliuretano	3	E-20, 22, 22	.018" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-16402	4 Fr. x 15" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" J/SST	X	St. Silk		X	5	N
AK-16553	5.5 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	3	E-20, 22, 22	.018" J/SST	X	St. Silk		X	5	N

Sets Pediátricos para Cateterización Multi-Lumen										
CS-12402	4 Fr. x 2" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" J/SST				X	5	Y
CS-14402	4 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" J/SST				X	5	Y
CS-14502	5 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	2	A-18, 20	.021" J/SST				X	5	Y
CS-14553	5.5 Fr. x 12" Poliuretano	3	E-20, 22, 22	.018" J/SST				X	5	Y
CS-15402-E	4 Fr. x 3-1/8" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" J/SST				X	5	Y
CS-15553-E	5.5 Fr. x 3-1/8" Poliuretano	3	E-20, 22, 22	.018" J/SST				X	5	Y
CS-16402	4 Fr. x 15" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" J/SST				X	5	Y
CS-16553-E	5.5 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	3	E-20, 22, 22	.018" J/SST				X	5	Y
ES-14402	4 Fr. x 5-1/8" Poliuretano	2	B-22, 22	.018" SST/SST				X	5	Y

Kits Pediátricos de Hemodiálisis para Cateterización de Dos Luces										
AK-11802-F	3 Fr. x 4" (11cm) Poliuretano	2	A-14, 14	.022" J/SST	X	St. Silk		X	5	N

Kits Pediátricos para Cateterización Venosa Central										
AK-04150-E	20 Ga. x 5"			.025" J/SST				X	10	N
AK-04550	20 Ga. x 5"			.025" J/SST	X	St. Silk		X	10	N
AK-04650-E	24 Ga. x 3-1/2"			.018" J/SST					10	Y
AK-04660	24 Ga. x 5"			.018" J/SST					10	Y

Sets Pediátricos para Cateterización Venosa Central										
ES-04150	20 Ga. x 5"			.025" J/SST				X	10	Y

Códigos de la guía: SST = Punta blanda recta
J = Punta blanda en J
M = Marcado

Códigos de Sutura: St. Silk = Aguja recta, Seda trenzada
St. Nylon = Aguja recta, Nylon monofilamento

Kits completos: contienen todos los agujas necesarias, jeringas, paños, etc. para la realización de procedimientos de cateterización.
Sets: solo contienen los elementos clave.

* Hace referencia al Diagrama de Sección de la página 11.

¹ U.S. Patent Numbers 4,581,028 and 5,019,096.

² U.S. Patent Numbers 4,813,938 and 5,045,065.

Precaución: El color de la sangre aspirada no siempre es un buen indicador del acceso a la vena. Cuando use la jeringa Raulerson de Arrow, utilice la sonda de presión incluida para verificar el acceso a la vena a través de la onda de presión que se estabiliza con un transductor de presión calibrado.

³ U.S. Patent Numbers 5,484,419 and 6,477,402.

⁴ Madok SM, SANPATH BA. Development and evolution of a new polyurethane central venous catheter: Reducing central venous catheter infections. *Complications in Surgery*. June 1992;23-29.


⁵ Maki DG, Stolz SM, Wheeler S, Mermel LA. Prevention of central venous catheter-related bloodstream infection with an antibiotic-impregnated catheter: a prospective randomized controlled trial. *Am J Med*. August 15, 1997.

⁴ Licensed under U.S. Patent No. 5,730,758.

⁷ U.S. Patent No. 6,123,193.

⁸ Marca registrada de Med-Flex Hospital Products Corporation.

Precaución: La ley federal de los EE.UU. limita la venta de este dispositivo por o bajo la orden de un médico. El contenido del envase sin abrir y libre de daños está esterilizado. No contiene medicación. Desechable. Para las advertencias, precauciones o instrucciones de uso, consulte el material informativo del envase.

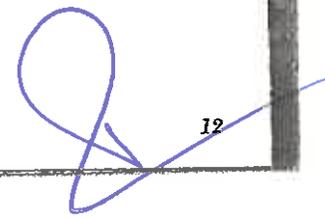


0020



Información Web/Clinica y sobre Productos

Arrow le hace fácil el acceso a información clínica actualizada y detallada en nuestra página web:

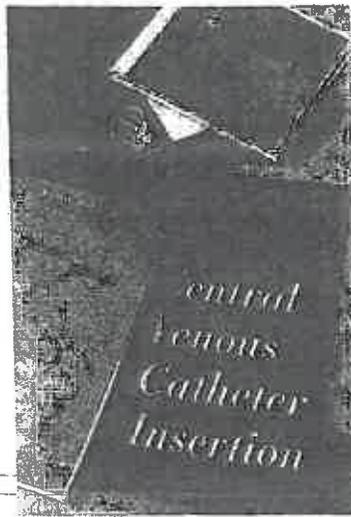

- Descripciones de productos con tablas de contenidos.
- Material educativo.
- Guías de Cuidados de Enfermería.
- Versiones electrónicas de los catálogos de Arrow.
- Información de Contacto de la compañía.
- Información de otros productos de Arrow.
- Preguntas más frecuentes.
- Enlaces útiles.

Para obtener más información o dar su opinión, utilice "Ask Arrow" en nuestra Web. O póngase en contacto con su representante de Arrow llamando al 800-523-8446.



www.arrowintl.com

Para localizar un distribuidor de Arrow o para pedir información, contacte con Atención al cliente en:

United States	International
Tel: 800.523.8446	Tel: +1.610.655.8522
Fax: 800.343.2935	Fax: +1.610.655.8566

Distribución Mundial:

Las oficinas de Ventas de Arrow se localizan en Alemania, Canada, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Japón, México, República Checa y Sudáfrica. Oficinas centrales: Arrow International, Inc., 2400 Bernville Road, Reading, PA 19606 U.S.A. Tel: 810-378-0131

S-CVC-C 1/05 1M © 2005 Arrow International, Inc. U.S.A. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

CARTA DE NORMAS

CIUDAD DE MEXICO A 12 DE FEBRERO DE 2018

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO
P R E S E N T E.

OSWALDO XAVIER RAMOS PANTOJA EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TÉCNICO MÉDICO, S.A. DE C.V., EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 31 Y 39 FRACCIÓN II INCISO B) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, MANIFIESTO QUE LOS BIENES TERAPÉUTICOS DE LOS QUE SOLICITO INCLUSIÓN DE REGISTRO SANITARIO, EN APEGO AL NUMERAL 19.2 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRONICA NO. LA-019GYR047-E79-2017 CONTENIDAS EN EL ANEXO DEL CONTRATO NÚMERO U170577, CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SALUD, EN LOS ARTÍCULOS APLICABLES, CONFORME A LO DECRETADO EN LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SUS SUPLEMENTOS, EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, ESPECÍFICAMENTE CON LAS NORMAS: NOM-241-SSA1-2012 Y NOM-137-SSA1-2008 ESPECIFICACIONES SANITARIAS; ASÍ COMO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS Y A FALTA DE ÉSTAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 53 Y 55 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN; O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE SEÑALAN EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY MENCIONADA O BIEN, CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTES SEÑALADO PARA LA(S) CLAVE(S) DE LA(S) QUE SOLICITO INCLUSIÓN Y A FALTA DE ESTAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.
EN TODOS LOS CASOS CUANDO EL INSTITUTO LO DETERMINE PROCEDENTE, SE ACEPTA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD ANTE EL LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA).

ATENTAMENTE

OSWALDO XAVIER RAMOS PANTOJA
REPRESENTANTE LEGAL



CIUDAD DE MÉXICO, 12 DE FEBRERO DE 2018

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO
PRESENTE.

OSWALDO XAVIER RAMOS PANTOJA, CON LAS FACULTADES QUE LA EMPRESA DENOMINADA **ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TÉCNICO MÉDICO S.A. DE C.V.**, ME OTORGA. SOLICITO DE SU VALIOSA AYUDA CON EL FIN DE QUE NOS SEA AUTORIZADA LA ENTREGA DE BIENES CON REGISTRO SANITARIO DIFERENTE A LOS ASIGNADOS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-019GYR047-E79-2017.

EL ORIGEN DE NUESTRA PETICIÓN, RADICA, EN QUE NUESTRO PROVEEDOR **EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, TIENE DESABASTO DE ALGUNAS MATERIAS PRIMAS NECESARIAS PARA LA FABRICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS QUE ENLISTO A CONTINUACIÓN.

060	166	1903	03	01	DESCRIPCIÓN	060	166	1903	03	01
060	166	1903	03	01	CATETERES VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR LONGITUD 13 CM, DE POLIURETANO O SILICON, RADIOPACO, CON DOS LUMENES INTERNOS DE 22 G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATETER INTRODUCCTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUIA DE ALAMBRE DE 0.46 MM DE DIAMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN "J", CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML Y DOS CAPSULAS DE INYECCION LUER-LOCK. ESTERIL Y DESECHABLE. EL CATETER INTRODUCCTOR ES OPCIONAL; LAS UNIDADES MEDICAS DETERMINARAN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS.	PZA	1			PZA
060	166	1911	03	01	CATETER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 5 FR Y 13 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICON, RADIOPACO, ESTERIL Y DESECHABLE, CON DOS LUMENES INTERNOS, CALIBRES 18 G Y 20 G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CALIBRE 20 G, CON CATETER INTRODUCCTOR CALIBRE 20 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 22 G, CON GUIA DE ALAMBRE DE 0.53 MM DE DIAMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN "J" CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 CC DOS CAPSULAS DE INYECCION LUER LOCK. EL CATETER INTRODUCCTOR ES OPCIONAL; LAS UNIDADES MEDICAS DETERMINARAN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS.	PZA	1			PZA

POR LO ANTES EXPUESTO, ME DIRIJO A USTED PARA QUE SEA AUTORIZADA LA INCLUSIÓN DE LA MARCA ARROW PARA ASÍ DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO.

SIN MAS POR EL MOMENTO AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA AL PRESENTE Y QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN AL RESPECTO.

ATENTAMENTE

OSWALDO XAVIER RAMOS PANTOJA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Zapopan, Jalisco a 08 de Febrero de 2018

ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO S.A. DE C.V.
PRESENTE

Reciba en nombre de Equipos de Biomedicina de México SA de CV, y el mío propio un cordial saludo, deseándole éxito en sus labores diarias.

Me dirijo a usted para informarle por este medio que no contamos con las existencias de los siguientes productos:

clave	descripción	fecha entrega
060.166.1903	CATÉTER VENOSO CENTRAL, CAL 4 FR Y 13 CM DE LONG. DE POLIURETANO, RADIOPAO, CON DOS LÚMENES INTERNOS DE 22G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CAL 21 G, CON CATÉTER INTRODUTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CAL 25 G CON GUÍA DE ALAMBRE DE 0.46 MM DE DIÁMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN "J" CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 CC, DOS CÁPSULAS DE INYECCIÓN LUER LOCK. PIEZA	15 de Marzo de 2018
060.166.1911	CATÉTER VENOSO CENTRAL, CAL. 5 FR Y 13 CM DE LONG. DE POLIURETANO, RADIOPAO, CON DOS LÚMENES INTERNOS CALS. 18 G Y 20 G; CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CAL. 20 G, CON CATÉTER INTRODUTOR CALIBRE 20 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 22 G, CON GUÍA DE ALAMBRE DE 0.53 MM DE DIÁMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN "J" CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 CC, DOS CÁPSULAS DE INYECCIÓN LUER LOCK. PIEZA	15 de Febrero de 2018
060.165.0815	CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE UN LUMEN DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, RADIOPAO, CON AGUJA INTRODUTOR PERCUTÁNEA. NEONATAL. CALIBRE DE 2 FR O 3 FR. PIEZA	15 de Marzo de 2018
060.165.0849	CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE DOBLE LUMEN, DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE POLIURETANO O ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON AGUJA INTRODUTOR CON FUNDA O CAMISA DESPRENDIBLE. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO NEONATAL. CALIBRE 1.9 A 3.0 FR.	28 de Febrero de 2018
060.167.8782	CATÉTER VENOSO SUBCUTÁNEO IMPLANTABLE QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA PUNCIÓN Y UN CATÉTER DE SILICÓN PARA PUNCIÓN Y CATÉTER DE SILICÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA. PIEZA.	15 de Marzo de 2018



0024

Nuestra empresa tiene un desabasto de algunos insumos que requerimos para producir dicho dispositivos y estamos en manos de un tercero para poder fabricar estas claves, por lo cual le extendemos nuestras disculpas por los inconvenientes que esto le conlleva a su empresa.

En esta misma anexo fechas de entrega de estos productos con la finalidad de solicitar prórroga para dichas entregas.

Por la atención que le merezca la presente, y esperando que nuestras relaciones comerciales continúen favorablemente. Quedo cordialmente a su servicio.

Atentamente

[Redacted signature area]

EBIME
R.F.C. EBM-880311-177
REGISTRO PATRONAL C1692320102
Prof. Pino Suarez 1820
Col. El Vigía CP 45140
Zapotlan, Jalisco, México
Tel 30035300

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE, CARGO, FIRMA POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO XVI FORMATO DE CARTA RESPALDO



FECHA: CIUDAD DE MÉXICO A 08 DE FEBRERO DE 2018.

Insurgentes Sur No. 800 Piso 21
Col. del Valle
México, D.F. C.P. 03100
Tel.: 5002-3500
Fax: 5002-3518
www.teleflex.com

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
P R E S E N T E.**


**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA
NO. LA-019GYR047-E79-2017**

EL SUSCRITO AURA ENRIQUETA VÁZQUEZ MARTÍNEZ, EN MI CALIDAD DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE LA EMPRESA **ARROW INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, MANIFIESTO QUE APOYO EL 100% DE LA PROPUESTA QUE PRESENTA **ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TÉCNICO MÉDICO, S.A. DE C.V.** EN EL PROCEDIMIENTO NÚMERO **LA-019GYR047-E79-2017** Y ME OBLIGO A RESPALDAR EN TIEMPO DE ENTREGA Y PLAZO DE GARANTÍA DE LOS INSUMOS CON LAS CLAVES Y/O PARTIDAS QUE SE DETALLAN EN EL SIGUIENTE RECUADRO, OBJETO DE ÉSTE PROCEDIMIENTO.

ASIMISMO, CERTIFICO QUE NUESTRA PLANTA DE PRODUCCIÓN UBICADA EN **312 COMMERCE PLACE, ASHEBORO, NORTH CAROLINA 27203, E.U.A. / AV. WASHINGTON NO. 3701, INTERIOR CIRCUITO INDUSTRIAL ALTA TECNOLOGÍA, EDIF. 40, COLONIA PANAMERICANA, CHIHUAHUA, C.P. 31200, CHIHUAHUA, MÉXICO**, POSEE LA CAPACIDAD TÉCNICA E INFRAESTRUCTURA PARA PRODUCIR Y ENTREGAR EN LOS PLAZOS PREVISTOS, LAS CANTIDADES DE LOS INSUMOS PARA LA SALUD QUE EN SU CASO LE SEAN ADJUDICADOS A LA EMPRESA **ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TÉCNICO MÉDICO, S.A. DE C.V.**, COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

CLAVE					DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			PAIS DE ORIGEN
GPO	GEN	ESP	DF	VR		UNI	CANT	TIPO	
060	166	1903	03	01	CATERERES VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR LONGITUD 13 CM, DE POLIURETANO O SILICON, RADIOPACO, CON DOS LUMENES INTERNOS DE 22 G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATETER INTRODUTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUIA DE ALAMBRE DE 0.46 MM DE DIAMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN "J", CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML Y DOS CAPSULAS DE INYECCION LUER-LOCK. ESTERIL Y DESECHABLE. EL CATETER INTRODUTOR ES OPCIONAL; LAS UNIDADES MEDICAS DETERMINARAN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS.	PZA	1	PZA	E.U.A.
060	166	1911	03	01	CATETER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 5 FR Y 13 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICON, RADIOPACO, ESTERIL Y DESECHABLE, CON DOS LUMENES INTERNOS, CALIBRES 18 G Y 20 G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CALIBRE 20 G, CON CATETER INTRODUTOR CALIBRE 20 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 22 G, CON GUIA DE ALAMBRE DE 0.53 MM DE DIAMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN "J" CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 CC DOS CAPSULAS DE INYECCION LUER LOCK. EL CATETER INTRODUTOR ES OPCIONAL; LAS UNIDADES MEDICAS DETERMINARAN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS.	PZA	1	PZA	E.U.A.

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE MI REPRESENTADA SE COMPROMETE A PONER A LA VISTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD, MÉTODOS DE PRUEBA, SUSTANCIAS DE REFERENCIA Y LOS ESTUDIOS DE ESTABILIDAD ACELERADA Y A LARGO PLAZO, ASÍ COMO LA VALIDACIÓN DE MÉTODOS DE PRUEBA DE LOS BIENES TERAPÉUTICOS QUE RESPALDO, EN EL MOMENTO QUE SE LE REQUIERA.


AURA ENRIQUETA VAZQUEZ MARTÍNEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 ARROW INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
 INSURGENTES SUR NO. 800, PISO 21, COL. DEL VALLE, C.P. 03100, CIUDAD DE MEXICO
 TEL: 5002-3500 FAX: 5002-35-18
 aura.vazquez@teleflex.com



y Soporte Técnico Médico S.A de C.V

ANEXO VII MANIFESTACIÓN DE ORIGEN DE LOS BIENES

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION INTERNACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.4 DE LAS REGLAS PARA LA APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES DE ORIGEN NACIONAL, RESPECTO DEL PRECIO DE LOS BIENES DE IMPORTACIÓN, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTO QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE DICIEMBRE DE 2010

CIUDAD DE MÉXICO A 12 DE FEBRERO DE 2018

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO


PRESENTE

ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-019GYR047-E79-2017 EN EL QUE MI REPRESENTADA, LA EMPRESA ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TÉCNICO MÉDICO, S.A. DE C.V. PARTICIPA A TRAVÉS DE LA PRESENTE PROPUESTA.

SOBRE EL PARTICULAR, Y EN LOS TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LAS "REGLAS PARA LA APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES DE ORIGEN NACIONAL, RESPECTO DEL PRECIO DE LOS BIENES DE IMPORTACIÓN, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTO QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL", EL QUE SUSCRIBE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE, EN EL SUPUESTO DE QUE ME SEA ADJUDICADO EL CONTRATO RESPECTIVO, EL (LA TOTALIDAD DE LOS) BIEN(ES) QUE OFERTO, CON LA MARCA Y/O MODELO INDICADO EN MI PROPOSICIÓN, BAJO LA(S) PARTIDA(S) Y CLAVE(S) 19 (060.166.1903.03.01 (ARROW)). 20 (060.166.1911.03.01 (ARROW)), ES (SON) ORIGINARIO(S) DE E.U.A. PAÍS QUE TIENE SUSCRITO CON LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO TLCAN, DE CONFORMIDAD CON LA REGLA DE ORIGEN APLICABLE DE DICHO TRATADO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

ADICIONALMENTE, MANIFIESTO QUE ANTE UNA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE ORIGEN DEL (LOS) BIEN (ES), ME COMPROMETO A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE ME SEA REQUERIDA POR LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE PERMITA SUSTENTAR EN TODO MOMENTO LA VERACIDAD DE LA PRESENTE, PARA LO CUAL CONSERVARÉ DURANTE TRES AÑOS DICHA INFORMACIÓN.

ATENTAMENTE


OSWALDO XAVIER RAMOS PANTOLÍA
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



SOLICITUD DE ANALISIS DE MUESTRAS

Ciudad de México a 13 de febrero de 2017

COORDINACIÓN DE CONTROL TECNICO DE INSUMOS (COCTI)

Presente.

Oswaldo Xavier Ramos Pantoja en mi carácter de Representante Legal de la Empresa **Especialistas en Aplicaciones y Soporte Técnico Médico S.A. de C.V.** manifiesto que mi representada cumpliendo con el compromiso de solicitud de inclusión de Registro Sanitario para las claves que a continuación se relacionan, bajo los mismos términos y condiciones estipulados en el procedimiento de contratación **LA-019GYR047-E79-2017**:

CLAVE QUÍMICO BÁSICO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	CANTIDAD	UNIDAD	TIPO	TIPO	CANTIDAD	UNIDAD
060.166.1903.03.01	CATETERES VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR LONGITUD 13 CM, DE POLIURETANO O SILICON, RADIOPACO, CON DOS LUMENES INTERNOS DE 22 G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATETER INTRODUCOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUIA DE ALAMBRE DE 0.46 MM DE DIAMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN "J", CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML Y DOS CAPSULAS DE INYECCION LUER-LOCK. ESTERIL Y DESECHABLE. EL CATETER INTRODUCOR ES OPCIONAL; LAS UNIDADES MEDICAS DETERMINARAN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS.	PZA	1	PZA	8 PIEZAS	ARROW	CS-14402	23F17E0397
060.166.1911.03.01	CATETER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 5 FR Y 13 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICON, RADIOPACO, ESTERIL Y DESECHABLE, CON DOS LUMENES INTERNOS, CALIBRES 18 G Y 20 G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CALIBRE 20 G, CON CATETER INTRODUCOR CALIBRE 20 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 22 G, CON GUIA DE ALAMBRE DE 0.53 MM DE DIAMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN "J" CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 CC DOS CAPSULAS DE INYECCION LUER LOCK. EL CATETER INTRODUCOR ES OPCIONAL; LAS UNIDADES MEDICAS DETERMINARAN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS.	PZA	1	PZA	8 PIEZAS	ARROW	CS-14502	23F17G0339

Lo anterior para los fines y efectos a que haya lugar.

ATENTAMENTE

OSWALDO XAVIER RAMOS PANTOJA
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLÍTICAS DE SALUD

ACUSE DE RECIBO DE MUESTRA, SUSTANCIAS DE REFERENCIA, REACTIVOS Y DOCUMENTACIÓN

Fecha de entrega: 13 DE FEBRERO DE 2018

REQUISITO A ENTREGAR		SI	NO	COMENTARIOS
Escrito dirigido al Instituto, en papel membretado con razón social del licitante, en el que solicite el análisis del producto.		X		
Clave:		X		060.166.1911:03:01
Marca:		X		EQUIPO DE CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL ARROW ✓
Fabricante:		X		ARROW INTERNATIONAL, INC. ✓
Número de licitación que corresponda.			X	
Cantidad de muestra indicada en el listado contenido en la convocatoria de licitación en cuestión.		X		8 PIEZAS
Documentación indicada en el listado contenido en la convocatoria de licitación en cuestión:	Certificado de Análisis del lote de las muestras entregadas.	X		
	Metodologías de análisis		X	
	Especificaciones Técnicas del fabricante		X	
	Instructivos de uso		X	
En su caso, sustancias de referencia (reactivos, placa del material de fabricación, espectro de referencia, etc.), en este caso llenar la sección "Sustancias de referencia y reactivos"			X	

José Urbano Fonseca No. 6. Col. Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07760, Ciudad de México.
Teléfonos: Conmutador: 5747 3500, ext. 26121 / Directo: 5754 689



**SUSTANCIAS DE REFERENCIA Y REACTIVOS
ESTANDAR PARA ANALISIS**

Nombre de la sustancia de referencia:	N/A
Lote:	N/A

OPCIÓN 1 MATERIAL DE REFERENCIA (USP/EP/FEUM/COSUFAR, ETC)

REQUISITO A ENTREGAR	SI	NO	COMENTARIOS
Certificado analítico		X	
Hoja de seguridad		X	

OPCIÓN 2 MATERIAL DE REFERENCIA SECUNDARIO

REQUISITO A ENTREGAR	SI	NO	COMENTARIOS
Certificado analítico expedido por el fabricante o distribuidor de la materia prima		X	
Certificado analítico de aprobación de materia prima del Laboratorio		X	
Certificado Analítico de estandarización		X	
Evidencia de análisis completo de la materia prima (reporte de resultados, evidencias, cálculos, pesos)		X	
Evidencia de estandarización de materia prima (reporte de resultados, evidencias, cálculos, pesos)		X	
Evidencia de Pureza (IR, UV/VIS, otros)		X	
Datos crudos de los cálculos		X	

REACTIVOS PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO


REQUISITO A ENTREGAR	SI	NO	COMENTARIOS
Reactivo: Certificado analítico		X	
Lote: Hoja de seguridad		X	
Reactivo: Certificado analítico		X	
Lote: Hoja de seguridad		X	
Reactivo: Certificado analítico		X	
Lote: Hoja de seguridad		X	
Reactivo: Certificado analítico		X	
Lote: Hoja de seguridad		X	
Reactivo: Certificado analítico		X	
Lote: Hoja de seguridad		X	

NOTA: Los reactivos y sustancias de referencia deben estar correctamente identificados, ser vigentes, presentarse en condiciones de almacenaje y conservación adecuados.




DATOS COMPLEMENTARIOS

Numero de Lote:	23F17G0339
Fecha de fabricación:	26 DE JULIO 2017
Fecha de caducidad:	30 DE JUNIO DE 2022
País de Origen:	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Registro Sanitario:	0014690 SSA
Documentos adjuntos:	CERTIFICADO DE ANÁLISIS, REGISTRO SANITARIO
Correo electrónico y teléfonos donde se pueda establecer contacto para solicitud de documentación complementaria:	oramos@eastm.com.mx jmanuel@eastm.com.mx

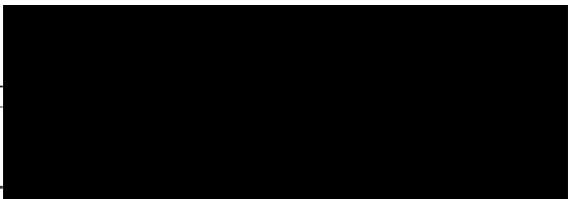

NOMBRE Y FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN

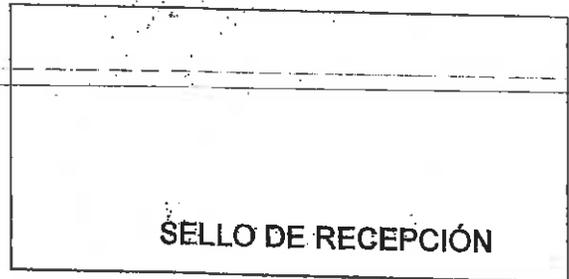

SELLO DE RECEPCIÓN

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE, FIRMA POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

José Urbano Fonseca No. 6. Col. Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07760, Ciudad de México.
 Teléfonos: Conmutador: 5747 3500, ext. 26121 / Directo: 5754 689

Fecha de emisión del formato: 21-ago-17

Página 3 de 3

Clave: 2070-009-057

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLÍTICAS DE SALUD
ACUSE DE RECIBO DE MUESTRA, SUSTANCIAS DE REFERENCIA, REACTIVOS Y DOCUMENTACIÓN

Fecha de entrega: 13 DE FEBRERO DE 2018

REQUISITO A ENTREGAR		SI	NO	COMENTARIOS
Escrito dirigido al Instituto, en papel membretado con razón social del licitante, en el que solicite el análisis del producto.		X		
Clave:		X		060.166.1903.03.01
Marca:		X		EQUIPO DE CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL ARROW
Fabricante:		X		ARROW INTERNATIONAL, INC.
Número de licitación que corresponda.			X	
Cantidad de muestra indicada en el listado contenido en la convocatoria de licitación en cuestión.		X		8 PIEZAS
Documentación indicada en el listado contenido en la convocatoria de licitación en cuestión:	Certificado de Análisis del lote de las muestras entregadas.	X		
	Metodologías de análisis		X	
	Especificaciones Técnicas del fabricante		X	
	Instructivos de uso		X	
En su caso, sustancias de referencia (reactivos, placa del material de fabricación, espectro de referencia, etc.), en este caso llenar la sección "Sustancias de referencia y reactivos"			X	

José Urbano Fonseca No. 6. Col. Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07760, Ciudad de México.
Teléfonos: Conmutador: 5747 3500, ext. 26121 / Directo: 5754 689



SUSTANCIAS DE REFERENCIA Y REACTIVOS

ESTANDAR PARA ANALISIS

Nombre de la sustancia de referencia:	N/A
Lote:	N/A

OPCIÓN 1 MATERIAL DE REFERENCIA (USP/EP/FEUM/COSUFAR, ETC)

REQUISITO A ENTREGAR	SI	NO	COMENTARIOS
Certificado analítico		X	
Hoja de seguridad		X	

OPCIÓN 2 MATERIAL DE REFERENCIA SECUNDARIO

REQUISITO A ENTREGAR	SI	NO	COMENTARIOS
Certificado analítico expedido por el fabricante o distribuidor de la materia prima		X	
Certificado analítico de aprobación de materia prima del laboratorio		X	
Certificado Analítico de estandarización		X	
Evidencia de análisis completo de la materia prima (reporte de resultados, evidencias, cálculos, pesos)		X	
Evidencia de estandarización de materia prima (reporte de resultados, evidencias, cálculos, pesos)		X	
Evidencia de Pureza (IR, UV/VIS, otros)		X	
Datos crudos de los cálculos		X	

REACTIVOS PARA REALIZAR EL ANALISIS DE PRODUCTO TERMINADO

REQUISITO A ENTREGAR	SI	NO	COMENTARIOS
Reactivo: Certificado analítico		X	
Lote: Hoja de seguridad		X	
Reactivo: Certificado analítico		X	
Lote: Hoja de seguridad		X	
Reactivo: Certificado analítico		X	
Lote: Hoja de seguridad		X	
Reactivo: Certificado analítico		X	
Lote: Hoja de seguridad		X	
Reactivo: Certificado analítico		X	
Lote: Hoja de seguridad		X	
Reactivo: Certificado analítico		X	
Lote: Hoja de seguridad		X	

NOTA: Los reactivos y sustancias de referencia deben estar correctamente identificados, ser vigentes, presentarse en condiciones de almacenaje y conservación adecuados.


ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

José Urbano Fonseca No. 6. Col. Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07760, Ciudad de México.
Teléfonos: Conmutador: 5747 3500, ext. 26121 / Directo: 5764 689



DATOS COMPLEMENTARIOS

Número de Lote:	23F17E0397
Fecha de fabricación:	5 DE JUNIO 2017
Fecha de caducidad:	31 DE MAYO 2022
País de Origen:	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Registro Sanitario:	0014C90 SSA
Documentos adjuntos:	CERTIFICADO DE ANÁLISIS, REGISTRO SANITARIO
Correo electrónico y teléfonos donde se pueda establecer contacto para solicitud de documentación complementaria:	oramos@eastm.com.mx jmanuel@eastm.com.mx

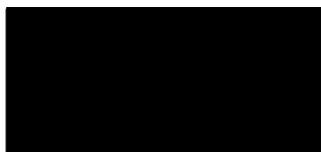

NOMBRE Y FIRMA DE PERSONA QUE ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN



SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE, FIRMA POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016