

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO  
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 531.295.1188.03.01 FECHA IMP.: 04/04/2018  
CLAVE PREI: 000000000011767 HORA IMP.: 17:23:57

**NOMBRE GENÉRICO**

**ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO**

LICITANTE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_  
LICITACIÓN: \_\_\_\_\_ MODELO: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ CATALOGO: \_\_\_\_\_  
CANTIDAD: \_\_\_\_\_

HOJA 1 de 2

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

**1 Definición**

1.1 Equipo utilizado para la exploración física del paciente con fines diagnósticos.

**2 Descripción**

- 2.1 Otoscopio de la misma marca del mango (Indicar marca y modelo).
  - 2.1.1 Con iluminación Xenón Halógena o LED a través de fibra óptica de 3.5 volts como mínimo.
  - 2.1.2 Lente con 2.5 aumentos como mínimo.
  - 2.1.3 Con 4 espéculos reusables en diferentes tamaños como mínimo.
  - 2.1.4 Con sistema sellado o hermético para pruebas neumáticas.
  - 2.1.5 Que permita la inserción de instrumentos externos.
- 2.2 Oftalmoscopio de la misma marca del mango (Indicar marca y modelo).
  - 2.2.1 Con iluminación Xenón Halógena o LED a través de fibra óptica de 3.5 volts como mínimo, con óptica libre de sombras.
  - 2.2.2 Con selector de al menos 5 aperturas y al menos dos filtros (Azul y Verde).
  - 2.2.3 Con al menos 28 lentes para dioptrías dentro del rango de -25 a +40.
- 2.3 Mango (Indicar marca y modelo).
  - 2.3.1 Metálico de acabado moleteado.
  - 2.3.2 Con control de intensidad de luz.
  - 2.3.3 Alimentación por baterías recargables y alcalinas compatibles con el mango, tipo C, tipo D o tipo AA.
- 2.3.4 Con sistema mecánico de giro, no de tornillo, para el acoplamiento del otoscopio y oftalmoscopio al mango.

**3 Accesorios**

- 3.1 Estuche rígido para guarda del equipo y sus componentes.
- 3.2 Cargador con transformador AC, compatible con el mango (Indicar número de parte).
- 3.3 Batería recargable compatible con el mango (Indicar número de parte).

**4 Consumibles**

- 4.1 Al menos 10 espéculos desechables en diferentes tamaños como mínimo (Indicar número de parte).
- 4.2 Lámpara de repuesto en el caso de ofertar tecnología Xenón Halógena (Indicar número de parte).
- 4.3 Al menos dos juegos de Baterías alcalinas compatibles con el mango.

**5 Instalación**

- 5.1 No requiere.



**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO  
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 531.295.1188.03.01 FECHA IMP.: 04/04/2018  
CLAVE PREI: 000000000011767 HORA IMP.: 17:23:57  
NOMBRE GENÉRICO


**ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO**

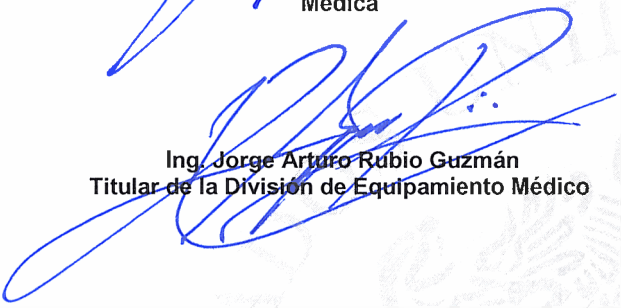
LICITANTE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_  
LICITACIÓN: \_\_\_\_\_ MODELO: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ CATALOGO: \_\_\_\_\_  
CANTIDAD: \_\_\_\_\_

HOJA 2 de 2

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

6 **Mantenimiento**  
6.1 No requiere.

  
Lic. David Baca Grande  
Titular de la Coordinación de Planeación de Infraestructura  
Médica

  
Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán  
Titular de la División de Equipamiento Médico

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**