

ACTA DE 2DA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

En la Ciudad de Mexicali Baja California, siendo las **13:30 horas**, del **11 de Septiembre de 2026,** se reunieron en el aula magna de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicado en Calzada Lázaro Cárdenas #3069 Fraccionamiento Nuevo Mexicali, C.P. 21600, en la ciudad de Mexicali, Baja California los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo la Segunda Junta de Aclaraciones de la convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), y los artículos 90 y 91 de su Reglamento y en el numeral 4 de la convocatoria.

Este acto es presidido por el **Ing. Cristofer Félix López**, Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios mediante oficio de designación 029001050100/574/2022 de fecha 02 de noviembre de 2022, de conformidad con las facultades conferidas en el artículo 144 fracción XXIII (en caso de OOAD), del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, el numeral 7.1.1.1 del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Administrativos, así como el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS.

Se informa que el presente acto está siendo videograbado, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 6 y 8 de la sección II del "Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante DOF) el 20 de agosto de 2015; y los "Acuerdos por el que se Modifica el Diverso que expide el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones", publicados en el DOF el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017.

DESARROLLO DEL ACTO

Quien preside, informó que con fundamento en el artículo 44 de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a las respuestas y/o modificaciones otorgadas en la segunda junta de aclaraciones, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de la Plataforma Compras MX, y cuyas preguntas se hayan recibido a más tardar a las 6 horas contabilizadas a partir de la incorporación del acta de la primer junta de aclaraciones en la Plataforma Compras MX.; es decir, hasta las **22:32 horas tiempo de Baja California del día 08 de Septiembre de 2026.**





ACTA DE 2DA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

Vencido el plazo referido anteriormente, se verificó en la Plataforma Compras MX si existen preguntas (repreguntas) por parte de los licitantes respecto a las respuestas y/o modificaciones dadas a las solicitudes de aclaración, señalando que SI se recibió preguntas (repreguntas) tal como se consta en la pantalla de la Plataforma Compras MX que se acompaña a la presente acta como **Anexo I**, de los siguientes licitantes:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	ESCRITO DE INTERÉS	No. DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN
1	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	SI	21
2	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	SI	1
3	ESCALA BIOMEDICA SA DE CV	SI	1
4	INDUSTRIAS COBRAMEX SA DE CV	SI	42
5	INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION MEDICA SA DE CV	SI	3
6	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	SI	2
7	MEDIXSA SA DE CV	SI	18
8	NUDOMI SA DE CV	SI	41
9	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	SI	35
10	RADAMES VARGAS ORTEGA	SI	25
11	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	SI	45
TOTAL			**283**

También se hace constar que los licitantes ADALU INGENIERIA SA DE CV, AMC BIOMEDICAL SA DE CV, CAF HEALTHCARE SYSTEMS SA DE CV, CASONATO STEELCO SPA SA DE CV, COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV, COMERLAT SA DE CV, CONSORCIO MEDICO MIUS S DE RL DE CV, CORINDAL SA DE CV, DEWIMED SA DIMSA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV, DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV, ENDOMEDICA SA DE CV, EQUIPOS BIOMEDICOS PROFESIONALES SA DE CV, EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV, FEHLMEX SA DE CV, GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV, GRUPO FAYX SA DE CV, GRUPO INSOMA S A P I DE CV, HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV, HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV, INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV, INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS KALF SA DE CV, INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS PARA LA VIDA SA DE CV, JOSE SAFAR BOUERI, JUAMA SA DE CV, LINK GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV, LUMAFESA S DE RL DE CV, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV, MED RENT SA DE CV, MEDICA LUTESA SA DE CV, MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV, MINARIC SA DE CV, NURIMED SA DE CV, OMCORE MEDICAL SA DE CV, OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL SA DE CV, POLAR HOSPITALARIA SA DE CV, RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV,



ACTA DE 2DA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV, SIAI MEDICS SA DE CV, SOLUCIONES MEDICAS COMERCIAL SA DE CV, SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV, TECNOMEDICS SA DE CV Y VARLIX MEXICO SA DE CV, únicamente presentaron manifiesto de interés en participar sin solicitar aclaraciones, así mismo los licitantes ANDREA RUIZ FERMAN, AR BIOMEDICAL SOLUTIONS SA DE CV, BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL SA DE CV, BIOCARE SYSTEMS SAS DE CV, BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV, CEIFMED SA DE CV, COMERCIAL SANCUE SA DE CV, COMERCIALIZADORA ALEFARM SA DE CV, CONDUIT LIFE SA DE CV, CORPORATIVO LA FRONTERA DE TJ. SA DE CV, CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV, DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV, DISTRIBUIDORA LAREAL OLIVERA Y LOPEZ SA DE CV, DTM TECNOLOGIAS SA DE CV, DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ, DW-MED SA DE CV, GERD YERIK SA DE CV, GESTUM CONSULTORES SA DE CV, HEALTHCARE MARKETING SA DE CV, HUMAN CARE HS SA DE CV, IMEDIC SOLUTIONS MEXICO S A P I DE CV, INELBIO SA DE CV, KOOLFER SA DE CV, LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV, MEDIKAL-MUNERIS SA DE CV, MEDIPULSE SA DE CV, MEGAMED SA DE CV, MIGUEL ANGEL CALDERON ZARZA, RAYMUNDO DANIEL PEREZ VELASCO, REHABILITACION Y MEDICINA DE VANGUARDIA SA DE CV, SERVICIENTIFICA-MEDICA SA DE CV, SUSTAIN MEDICAL GROUP S DE RL DE CV, TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV, TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV, TRIDEX MEDICAL S DE RL DE CV, VICAMPZ MEDIC SAS y ZENTILIA LAB S A P I DE CV, únicamente visualizaron el procedimiento sin presentar manifiesto de interés y sin solicitar aclaraciones.

Se hace constar que mediante correo electrónico de fecha 01 de Septiembre del año en curso, el Mtro. Chistrian Omar Arroyo Manjarrez.- Auditor de la Oficina Regional número 1 del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, manifestó que: En seguimiento a la **Segunda Junta de aclaraciones** del procedimiento de Licitación Pública Número **LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026 para la Adquisición de 39 partidas de equipo asociado a obra Equipamiento Médico (Con Instalación) para el ejercicio 2026,** con fundamento en el artículo 87 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), podrá verificar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en la Ley de la materia y demás disposiciones aplicables, en correlación con el artículo 83, párrafo quinto del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Derivado de la verificación a las respuestas y nuevas solicitudes de aclaración presentadas por parte de la proveeduría a través de la Plataforma de Compras MX sobre las respuestas emitida por las áreas técnica y contratante, y al constatar que **sí se presentaron** solicitudes de repreguntas, lo cual se tiene por reproducido en el acta respectiva.

ACTA DE 2DA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

Al respecto, es obligación del área contratante y técnica dar **contestación de forma clara, precisa y congruente a las preguntas de los licitantes**, asimismo no se deberá remitir de forma general a lo previsto en la convocatoria a la licitación Pública o en su caso deberá señalar el apartado específico de la misma en que se encuentre la respuesta al planteamiento, lo anterior de conformidad con el artículo 91 fracciones II y III del Reglamento de la LAASSP.

Finalmente, con fundamento en el artículo 43 de la LAASSP, se solicita a las personas representantes del área contratante, área requirente y/o técnica, en el ámbito de sus facultades y responsabilidades en caso de **modificaciones susceptibles de realizarse a los aspectos establecidos en la convocatoria, en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características;** siendo todo lo que deseo manifestar.

De conformidad con los artículos 35 antepenúltimo párrafo de la Ley y 90 de su Reglamento, a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador.

CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES

Acto seguido, quien preside el acto, informa que se ha dado respuesta a los cuestionamientos recibidos y solicita a los presentes la dispensa de su lectura dado el volumen de las solicitudes de aclaración y adjunta como si a la letra se insertara, como **Anexo II** de la presente acta.

PRECISIONES A LA CONVOCATORIA

Quien preside el acto, consulto al representante del área técnica si era su deseo efectuar alguna precisión a la convocatoria, a lo que el área requirente manifiesta que NO existen precisiones de carácter técnico a la convocatoria, el área convocante manifiesta que NO existen precisiones de carácter legal-administrativo.

CIERRE DEL ACTA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento, así como sus respectivos anexos y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.



ACTA DE 2DA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como en el antepenúltimo párrafo del punto 4 de la convocatoria se pondrá una copia al finalizar el acto a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en el tablero de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, ubicada en el Almacén Delegacional, con domicilio en Calzada Lázaro Cárdenas #3069 Fraccionamiento Nuevo Mexicali, C.P. 21600 Mexicali, Baja California, por un término no menor a 5 días hábiles, así mismo, se difundirá un ejemplar del acta en la Plataforma Compras MX para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al (los) acto(s), en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.

Se hace del conocimiento de los licitantes que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo **el día 18 de Septiembre de 2026 a las 09:30 horas** tiempo de Baja California, a través de la Plataforma Compras MX en el aula magna de la oficina de Adquisiciones en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, con domicilio en Calzada Lázaro Cárdenas #3069 Fraccionamiento Nuevo Mexicali, C.P. 21600 Mexicali, Baja California.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo las **15:07 horas** del día **11 de Septiembre de 2026**, firmando los presentes para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al acta, quienes reciben copia de la misma.

Esta acta consta de 06 fojas útiles y 2 (dos) anexos constantes de 63 fojas.

---**FIN DE TEXTO** ---

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Ing. Cristofer Félix López.- Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	Firmada Electrónicamente mediante Firma Electrónica Avanzada (e.firma)
Lic. Melissa Marlen Solano Correa.- Titular de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	



2026 año de Margarita Maza

ACTA DE 2DA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
LAP. Edwin Jafett Iglesias Martinez.- N47 Líder de Proyecto	


Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO I
PANTALLA DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

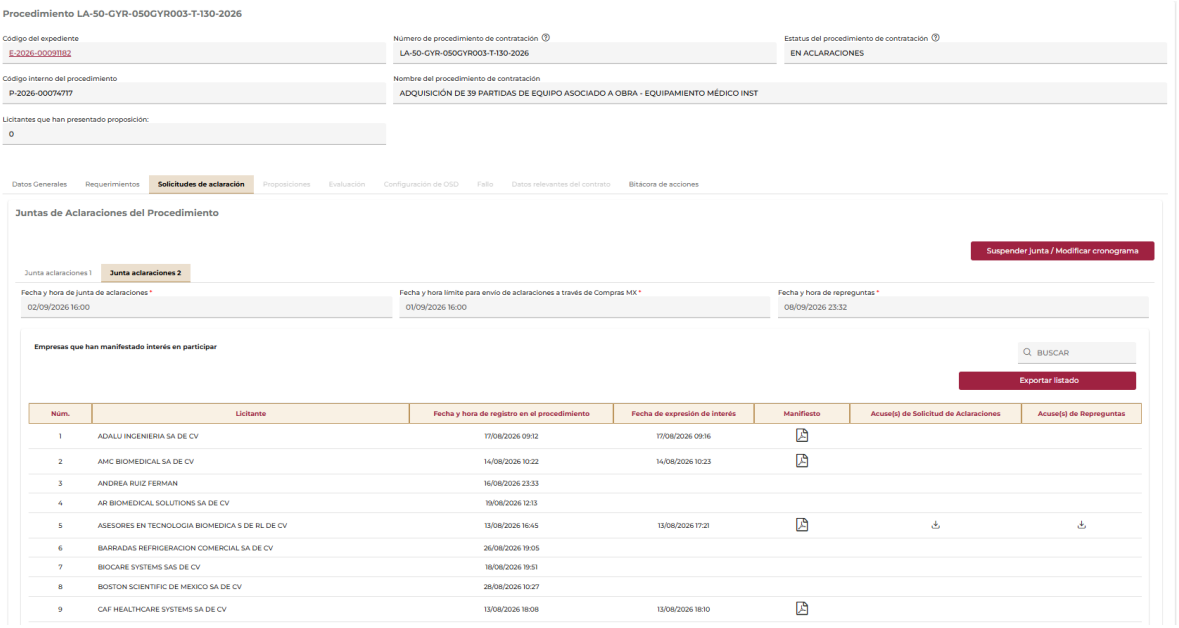

Procedimiento LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

Código del expediente: E-2026-00091182
Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026
Estatus del procedimiento de contratación: EN ACLARACIONES
Código interno del procedimiento: P-2026-00074717
Nombre del procedimiento de contratación: ADQUISICIÓN DE 39 PARTIDAS DE EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO INST
Licitantes que han presentado proposición: 0

Datos Generales | Requerimientos | Solicitudes de aclaración | Proposiciones | Evaluación | Configuración de OSD | Fallo | Datos relevantes del contrato | Bitácora de acciones

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Suspender junta / Modificar cronograma

Junta aclaraciones 1 | Junta aclaraciones 2

Fecha y hora de junta de aclaraciones *: 02/09/2026 16:00
Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Compras MX *: 01/09/2026 16:00
Fecha y hora de repreguntas *: 08/09/2026 23:32

Empresas que han manifestado interés en participar

BUSCAR
Exportar listado

Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
1	ADALU INGENIERIA SA DE CV	17/08/2026 09:12	17/08/2026 09:16			
2	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	14/08/2026 10:22	14/08/2026 10:23			
3	ANDREA RUIZ FERMAN	16/08/2026 23:33				
4	AR BIOMEDICAL SOLUTIONS SA DE CV	19/08/2026 12:13				
5	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	13/08/2026 16:45	13/08/2026 17:21			
6	BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL SA DE CV	26/08/2026 19:05				
7	BIOCARE SYSTEMS SAS DE CV	18/08/2026 19:51				
8	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	28/08/2026 10:27				
9	CAF HEALTHCARE SYSTEMS SA DE CV	13/08/2026 18:08	13/08/2026 18:10			

2026 año de Margarita Maza



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO I
PANTALLA DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

10	CASONATO STEELCO SPA SA DE CV	14/08/2026 13:29	14/08/2026 13:29			
11	CEIFMED SA DE CV	18/08/2026 16:01				
12	COMERCIAL SANCUE SA DE CV	13/08/2026 19:39				
13	COMERCIALIZACION E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	14/08/2026 09:27	17/08/2026 09:34			
14	COMERCIALIZADORA ALEFARM SA DE CV	17/08/2026 09:57				
15	COMERLAT SA DE CV	17/08/2026 09:04	17/08/2026 09:04			
16	CONDUIT LIFE SA DE CV	18/08/2026 17:02				
17	CONSORCIO MEDICO MIUS S DE RL DE CV	14/08/2026 12:03	14/08/2026 12:07			
18	CORINDAL SA DE CV	14/08/2026 12:17	14/08/2026 15:07			
19	CORPORATIVO LA FRONTERA DE TJ. SA DE CV	17/08/2026 10:37				
20	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	14/08/2026 17:50				
21	DEWIMED SA	17/08/2026 19:01	17/08/2026 19:01			
22	DIMSA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	14/08/2026 15:33	14/08/2026 15:34			
23	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	31/08/2026 11:34				
24	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV	20/08/2026 11:21				
25	DISTRIBUIDORA LAREAL OLIVERA Y LOPEZ SA DE CV	01/09/2026 14:27				
26	DRÄGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	15/08/2026 19:28	16/08/2026 13:10			
27	DTM TECNOLOGIAS SA DE CV	20/08/2026 11:36				
28	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	31/08/2026 13:30				
29	DW-MED SA DE CV	18/08/2026 17:12				
30	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	14/08/2026 09:53	14/08/2026 09:56			
31	ENDOMEDICA SA DE CV	14/08/2026 16:14	14/08/2026 16:15			
32	EQUIPOS BIOMEDICOS PROFESIONALES SA DE CV	14/08/2026 08:39	14/08/2026 08:39			
33	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	14/08/2026 16:44	28/08/2026 18:48			
34	ESCALA BIOMEDICA SA DE CV	14/08/2026 10:52	14/08/2026 10:54			
35	FEHLMEX SA DE CV	14/08/2026 09:25	14/08/2026 09:25			
36	GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	14/08/2026 12:05	14/08/2026 12:06			
37	GERD YERIK SA DE CV	31/08/2026 20:01				

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO I
PANTALLA DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

38	GESTUM CONSULTORES SA DE CV	14/08/2026 16:01				
39	GRUPO FAYX SA DE CV	18/08/2026 09:41	28/08/2026 20:42			
40	GRUPO INSOMA S A P I DE CV	18/08/2026 08:39	18/08/2026 09:04			
41	HEALTHCARE MARKETING SA DE CV	14/08/2026 11:05				
42	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	13/08/2026 17:02	28/08/2026 21:52			
43	HOSPITIUM SOLUTIONS SA DE CV	17/08/2026 10:10	17/08/2026 10:10			
44	HUMAN CARE HS SA DE CV	25/08/2026 12:03				
45	IMEDIC SOLUTIONS MEXICO S A P I DE CV	18/08/2026 16:16				
46	INDUSTRIAS COBRAMEX SA DE CV	14/08/2026 12:49	01/09/2026 08:22			
47	INELBIO SA DE CV	17/08/2026 16:09				
48	INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION MEDICA SA DE CV	17/08/2026 00:20	17/08/2026 00:20			
49	INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	16/08/2026 22:42	16/08/2026 22:43			
50	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	15/08/2026 16:55	15/08/2026 16:56			
51	INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS KALF SA DE CV	15/08/2026 21:30	15/08/2026 21:31			
52	INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS PARA LA VIDA SA DE CV	14/08/2026 20:20	14/08/2026 20:20			
53	JOSE SAFAR BOUERI	14/08/2026 11:24	14/08/2026 16:43			
54	JUAMA SA DE CV	14/08/2026 16:31	14/08/2026 16:51			
55	KOOLFER SA DE CV	26/08/2026 11:26				
56	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV	01/09/2026 09:41				
57	LINK GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	14/08/2026 18:34	14/08/2026 18:35			
58	LUMAFESA S DE RL DE CV	13/08/2026 17:23	13/08/2026 17:24			
59	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	16/08/2026 23:22	16/08/2026 23:25			
60	MED RENT SA DE CV	17/08/2026 10:04	17/08/2026 10:05			
61	MEDICA LUTESA SA DE CV	13/08/2026 17:28	13/08/2026 17:29			
62	MEDICAL ADVANCED SUPPLIES SA DE CV	16/08/2026 08:37	16/08/2026 08:40			
63	MEDIKAL-MUNERIS SA DE CV	19/08/2026 13:57				
64	MEDIPULSE SA DE CV	14/08/2026 13:02				

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO I
PANTALLA DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

65	MEDIXSA SA DE CV	16/08/2026 14:57	16/08/2026 14:58			
66	MEGAMED SA DE CV	19/08/2026 16:40				
67	MIGUEL ANGEL CALDERON ZARZA	31/08/2026 13:01				
68	MINARIC SA DE CV	13/08/2026 17:47	13/08/2026 17:48			
69	NUDOMI SA DE CV	13/08/2026 17:25	13/08/2026 17:26			
70	NURIMED SA DE CV	14/08/2026 12:02	14/08/2026 12:03			
71	OMCORE MEDICAL SA DE CV	13/08/2026 17:12	13/08/2026 17:12			
72	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL SA DE CV	27/08/2026 11:20	01/09/2026 11:18			
73	OPTI REPRESENTACIONES S DE RL DE CV	03/09/2026 18:23				
74	POLAR HOSPITALARIA SA DE CV	17/08/2026 10:44	17/08/2026 13:16			
75	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	17/08/2026 08:38	17/08/2026 08:38			
76	RADAMES VARGAS ORTEGA	08/09/2026 22:16	08/09/2026 22:17			
77	RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV	14/08/2026 14:19	14/08/2026 16:09			
78	RAYMUNDO DANIEL PEREZ VELASCO	19/08/2026 18:49				
79	REHABILITACION Y MEDICINA DE VANGUARDIA SA DE CV	13/08/2026 23:11				
80	SERVICIENTIFICA-MEDICA SA DE CV	19/08/2026 09:05				
81	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	13/08/2026 18:51	13/08/2026 18:51			
82	SIAI MEDICS SA DE CV	13/08/2026 23:59	13/08/2026 23:59			
83	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	14/08/2026 16:18	14/08/2026 16:19			
84	SOLUCIONES MEDICAS COMERCIAL SA DE CV	16/08/2026 12:34	16/08/2026 12:35			
85	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV	14/08/2026 13:46	14/08/2026 13:48			
86	SUSTAIN MEDICAL GROUP S DE RL DE CV	24/08/2026 12:23				
87	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	14/08/2026 11:40				
88	TECNOMEDICS SA DE CV	20/08/2026 16:25	01/09/2026 10:02			
89	TELECOMUNICACION Y EQUIPOS SA DE CV	18/08/2026 15:13				
90	TRIDEX MEDICAL S DE RL DE CV	18/08/2026 18:33				
91	VARLIX MEXICO SA DE CV	14/08/2026 08:03	14/08/2026 08:04			
92	VICAMPZ MEDIC SAS	22/08/2026 17:29				
93	ZENTILIA LAB S A P I DE CV	18/08/2026 11:12				

« ‹ 1 › » 100



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
1	INDUSTRIAS COBRAMEX SA DE CV	PREGUNTA 216	RESPECTO A LAS EXIGENCIAS RELATIVAS A LA PRESENTACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICADOS Y/U OFICIOS EMITIDOS POR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) PARA LOS EQUIPOS O INSUMOS REQUERIDOS EN ESTE PROCEDIMIENTO: TODA VEZ QUE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA 7 DE JULIO DE 2025 SE PUBLICARON LAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA SIMPLIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y PRÓRROGAS DE REGISTROS SANITARIOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, EN CUYOS ARTÍCULOS TRANSITORIO SEGUNDO Y TRANSITORIO TERCERO SE ESTABLECE EL MARCO DE VIGENCIA, PRÓRROGAS Y/O EXCEPCIONES CORRESPONDIENTES PARA DICHOS TRÁMITES Y DOCUMENTOS: ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE CONFIRME SI ACEPTARÁ COMO VÁLIDOS Y SUFICIENTES LOS REGISTROS SANITARIOS, PRÓRROGAS, CERTIFICADOS E INSUMOS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN O EXCEPCIÓN, QUE SE APEGUEN A LOS PLAZOS, SUPUESTOS Y DISPOSICIONES NORMATIVAS SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS SEGUNDO Y TERCERO DEL CITADO ACUERDO PUBLICADO EN EL DOF DEL 7 JULIO DE 2025, ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN DE EMITIDA POR LA COFEPRIS?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
2	INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 57	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR SELECCIONABLE ENTRE 3500, 4000, 4500 Y 5000 KELVIN QUE DA COLORES CÁLIDOS Y FRÍOS Y PERMITE UNA BUENA OBSERVACIÓN DE LOS COLORES REALES DE LOS TEJIDOS DURANTE UN	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO, ¿SE ACEPTA?		
3	INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 60	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR MODO ENDO O MODO LUZ AMBIENTAL QUE PERMITE LA ILUMINACIÓN DURANTE PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA O ENDOSCOPÍA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
4	INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 47	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y DEJARNOS OFERTAR BATERÍA DE RESERVA EN CASO DE FALLA ELÉCTRICA QUE SIRVE COMO UN RESPALDO DE ALIMENTACIÓN, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
5	INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 55	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR SELECCIONABLE ENTRE 3500, 4000, 4500 Y 5000 KELVIN QUE DA COLORES CÁLIDOS Y FRÍOS Y PERMITE UNA BUENA OBSERVACIÓN DE LOS COLORES REALES DE LOS TEJIDOS DURANTE UN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
6	INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 56	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y DEJARNOS OFERTAR BATERÍA DE RESERVA EN CASO DE FALLA ELÉCTRICA QUE SIRVE COMO UN RESPALDO DE ALIMENTACIÓN, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
7	INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 48	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR AJUSTE DE CABEZAL DE +/-45° CON ALTURA DE AJUSTABLE DE 113.1 CM Y UN GIRO DE 360°, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
	INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION	PREGUNTA 49	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE	ÁREA TÉCNICA





Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
	MEDICA SA DE CV		RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR SELECCIONABLE ENTRE 3500, 4000, 4500 Y 5000 KELVIN QUE DA COLORES CÁLIDOS Y FRÍOS Y PERMITE UNA BUENA OBSERVACIÓN DE LOS COLORES REALES DE LOS TEJIDOS DURANTE UN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO, ¿SE ACEPTA?	CONVOCATORIA.	
9	INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 50	SE ENTIENDE QUE SE PUEDE OFERTAR DIÁMETRO AJUSTABLE DE 18 A 37 CM SIEMPRE QUE ESTE CUBRA EL RANGO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA DE 20 A 25 CM, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.	ÁREA TÉCNICA
10	INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 61	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA EN 6 NIVELES POSIBLES POR MEDIO DEL PANEL DE CONTROL EN CÚPULA ACTIVADO POR MEDIO DE SENSORES DE MOVIMIENTOS DE LAS MANOS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
11	INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 64	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y NOS PERMITA OFERTAR DISEÑO QUE REDUCE LAS PERTURBACIONES DEL FLUJO LAMINAR CON FORMA REDONDEADA Y LISA EN UN 32% SEGÚN DIN 1946-4, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
12	INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION MEDICA SA DE CV	PREGUNTA 65	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y DEJARNOS OFERTAR BATERÍA DE RESERVA EN CASO DE FALLA ELÉCTRICA QUE SIRVE COMO UN RESPALDO DE ALIMENTACIÓN, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
13	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	SEGUNDA VUELTA, PREGUNTA 152 DEL LICITANTE ASESORES EN TECNOLOGIA	PARTIDA 39 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS NEONATAL 4 CAMAS. PUNTO 1.3.8.1 QUE PERMITA EL DESPLIEGUE SIMULTANEO DE 3 CURVAS DE ECG A ELEGIR DE 12 DERIVACIONES.	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
		BIOMEDICA S DE RL DE CV	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR EL PRESENTE REQUERIMIENTO Y PERMITIR OFERTAR EL DESPLIEGUE DE HASTA UNA CURVA DE ECG OBTENIDA MEDIANTE UNA CONFIGURACIÓN DE 3 PUNTAS, CONSIDERANDO QUE EL EQUIPO ESTÁ DIRIGIDO A PACIENTES NEONATALES, EN QUIENES EL ESPACIO DISPONIBLE EN EL TÓRAX ES REDUCIDO, LO QUE PUEDE DIFICULTAR LA COLOCACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE ELECTRODOS, AUNADO A QUE LA PIEL DEL PACIENTE NEONATAL ES MÁS SENSIBLE. LO ANTERIOR, MANTENIENDO LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA PARA EL MONITOREO ELECTROCARDIOGRÁFICO CONTINUO DEL PACIENTE NEONATAL, ¿SE ACEPTA?		
14	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	SEGUNDA VUELTA, PREGUNTA 153 DEL LICITANTE ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	PARTIDA 39 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS NEONATAL 4 CAMAS. PUNTO 1.3.8.2 FUNCION DE DESPLIEGUE SIMULTANEO DE HASTA 12 DERIVACIONES. DERIDO A QUE EL ESPACIO EN EL PECHO DEL PACIENTE NO PERMITE LA CORRECTA COLOCACION DE 12 DERIVACIONES, OCASIONANDO UNA MALA COLOCACION DE LAS PUNTAS PARA LA SELECCION DE 12 DERIVACIONES AUNADO A QUE LA PIEL DEL PACIENTE CRITICO NEONATAL NO SE ENCUENTRA COMPLETAMENTE QUERATINIZADA, OCASIONANDO LESIONES AL PACIENTE, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE EL DESPLIEGUE DE HASTA 1 CURVA ECG A PARTIR DE TRES PUNTAS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
15	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	SEGUNDA VUELTA, PREGUNTA 151 DEL LICITANTE ASESORES EN TECNOLOGIA	PARTIDA 39 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS NEONATAL 4 CAMAS. PUNTO 1.3.9 MONITOREO DE SPO2. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
		BIOMEDICA S DE RL DE CV	RESPUESTA A ESTE PUNTO E INTEGRE LA MEDICIÓN DE INDICE DE PERFUSIÓN MEDIANTE EL SENSOR DE SPO2, YA QUE EN PACIENTES NEONATALES EL INDICE DE PERFUSION ES UN INDICADOR TEMPRANO DE FALLAS HEMODINAMICAS, LO CUAL AYUDA AL PERSONAL MEDICO A ACTUAR DE FORMA TEMPRANA Y PREVENIR URGENCIAS EN UCIN. ¿SE ACEPTA?		
16	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	SEGUNDA VUELTA, PREGUNTA 159 DEL LICITANTE ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	PARTIDA 21 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS (CUATRO CAMAS) PUNTO 1.3.11 TENDENCIAS GRAFICAS Y NUMERICAS DE 72 HORAS COMO MINIMO DE TODOS LOS PARAMETROS SELECCIONABLES POR EL USUARIO. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, YA QUE EL FIN DEL ALMACENAMIENTO DE TENDENCIAS ES CORROBORAR LA EVOLUCIÓN DEL PACIENTE DURANTE SU HOSPITALIZACIÓN Y AL ESTAR LAS TENDENCIAS DISPONIBLES EN LA CENTRAL DE MONITOREO PARA SU REVISION Y VISUALIZACION, SE CUMPLE ESTE OBJETIVO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
17	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	SEGUNDA VUELTA, PREGUNTA 161 DEL LICITANTE ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	PARTIDA 22 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS (CUATRO CAMAS) PUNTO 1.3.11 TENDENCIAS GRAFICAS Y NUMERICAS DE 72 HORAS COMO MINIMO DE TODOS LOS PARAMETROS SELECCIONABLES POR EL USUARIO. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, YA QUE EL FIN DEL ALMACENAMIENTO DE TENDENCIAS ES CORROBORAR LA EVOLUCIÓN DEL PACIENTE DURANTE SU HOSPITALIZACIÓN Y AL ESTAR LAS TENDENCIAS DISPONIBLES EN LA CENTRAL DE MONITOREO PARA SU REVISION Y VISUALIZACION, SE CUMPLE	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			ESTE OBJETIVO. ¿SE ACEPTA?		
18	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	SEGUNDA VUELTA, PREGUNTA 163 DEL LICITANTE ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	PARTIDA 39 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS (CUATRO CAMAS) PUNTO 1.3.11 TENDENCIAS GRAFICAS Y NUMERICAS DE 72 HORAS COMO MINIMO DE TODOS LOS PARAMETROS SELECCIONABLES POR EL USUARIO. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, YA QUE EL FIN DEL ALMACENAMIENTO DE TENDENCIAS ES CORROBORAR LA EVOLUCIÓN DEL PACIENTE DURANTE SU HOSPITALIZACIÓN Y AL ESTAR LAS TENDENCIAS DISPONIBLES EN LA CENTRAL DE MONITOREO PARA SU REVISION Y VISUALIZACION, SE CUMPLE ESTE OBJETIVO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
19	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	SEGUNDA VUELTA, PREGUNTA 164 DEL LICITANTE ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	PARTIDA 21. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, CUATRO CAMAS PUNTO PUNTO 2.11: IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA O TECNOLOGÍA SIMILAR CON VELOCIDAD MÍNIMA DE 45 PPM Y DENSIDAD DE IMPRESIÓN 1200 X 1200 DPI. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE Y NOS PERMITA OFERTAR UNA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 40 PPM, YA QUE LA DIFERENCIA DE 5 PPM NO COMPROMETE LA FUNCIONALIDAD, DESEMPEÑO NI EFICIENCIA OPERATIVA DE LA CENTRAL DE MONITOREO, MANTENIENDO LA RESOLUCIÓN DE 1200 X 1200 DPI, PLENA COMPATIBILIDAD CON EL SISTEMA Y GARANTIZANDO CALIDAD EN LA IMPRESIÓN DE REPORTES CLÍNICOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
20	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	SEGUNDA VUELTA, PREGUNTA 165 DEL LICITANTE ASESORES EN TECNOLOGIA	PARTIDA 22. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, CUATRO CAMAS PUNTO PUNTO 2.11: IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA O TECNOLOGÍA SIMILAR CON VELOCIDAD MÍNIMA DE 45	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
		BIOMEDICA S DE RL DE CV	PPM Y DENSIDAD DE IMPRESIÓN 1200 X 1200 DPI. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE Y NOS PERMITA OFERTAR UNA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 40 PPM, YA QUE LA DIFERENCIA DE 5 PPM NO COMPROMETE LA FUNCIONALIDAD, DESEMPEÑO NI EFICIENCIA OPERATIVA DE LA CENTRAL DE MONITOREO, MANTENIENDO LA RESOLUCIÓN DE 1200 X 1200 DPI, PLENA COMPATIBILIDAD CON EL SISTEMA Y GARANTIZANDO CALIDAD EN LA IMPRESIÓN DE REPORTES CLÍNICOS. ¿SE ACEPTA?		
21	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	SEGUNDA VUELTA, PREGUNTA 166 DEL LICITANTE ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	PARTIDA 39. CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, CUATRO CAMAS PUNTO PUNTO 2.11: IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA O TECNOLOGÍA SIMILAR CON VELOCIDAD MÍNIMA DE 45 PPM Y DENSIDAD DE IMPRESIÓN 1200 X 1200 DPI. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE Y NOS PERMITA OFERTAR UNA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 40 PPM, YA QUE LA DIFERENCIA DE 5 PPM NO COMPROMETE LA FUNCIONALIDAD, DESEMPEÑO NI EFICIENCIA OPERATIVA DE LA CENTRAL DE MONITOREO, MANTENIENDO LA RESOLUCIÓN DE 1200 X 1200 DPI, PLENA COMPATIBILIDAD CON EL SISTEMA Y GARANTIZANDO CALIDAD EN LA IMPRESIÓN DE REPORTES CLÍNICOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
22	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	SEGUNDA VUELTA, PREGUNTA167 DEL LICITANTE ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	PARTIDA 39 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS NEONATAL, CUATRO CAMAS. PUNTO 2.3.1. BRAZALETE REUSABLE LIBRE DE LÁTEX, CUATRO (4) PIEZAS EN TOTAL, PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA CON MANGUERA Y CONECTOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			CONVOCANTE RECONSIDERE Y NOS PERMITA OFERTAR 10 BRAZALETES DESECHABLES POR CADA BRAZALETE REUSABLE SOLICITADO, RESULTANDO UN TOTAL DE 40 PIEZAS, YA QUE EN PACIENTES NEONATALES LA REUTILIZACIÓN DE BRAZALETES INCREMENTA EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN CRUZADA, MIENTRAS QUE LOS DESECHABLES ASEGURAN LA MISMA FUNCIONALIDAD EN LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA CON MANGUERA Y CONECTOR, MANTENIENDO LA PRECISIÓN DIAGNÓSTICA, LA SEGURIDAD CLÍNICA Y LA EFICIENCIA OPERATIVA DEL SISTEMA DE MONITOREO, ADEMÁS DE ALINEARSE CON LAS MEJORES PRÁCTICAS DE CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS. ¿SE ACEPTA?		
23	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	SEGUNDA VUELTA, PREGUNTA 168 DEL LICITANTE ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	PARTIDA 39 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS NEONATAL, CUATRO CAMAS. PUNTO 2.3.2. TAMAÑO NEONATAL, EN TRES DIFERENTES TAMAÑOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE Y NOS PERMITA OFERTAR 10 BRAZALETES DESECHABLES EN LOS TAMAÑOS SOLICITADOS POR CADA BRAZALETE REUSABLE, RESULTANDO UN TOTAL DE 30 PIEZAS, YA QUE LA MEDICIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA EN ESTE GRUPO DE PACIENTES SE REALIZA BAJO PARÁMETROS ESTANDARIZADOS Y EL USO DE UN ÚNICO TAMAÑO CUBRE ADECUADAMENTE EL RANGO DE CIRCUNFERENCIAS NEONATALES SIN AFECTAR LA PRECISIÓN NI LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
24	ASESORES EN TECNOLOGIA	SEGUNDA VUELTA, PREGUNTA 168 DEL	PARTIDA 39 CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS NEONATAL,	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE	ÁREA TÉCNICA



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
	BIOMEDICA S DE RL DE CV	LICITANTE ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	CUATRO CAMAS. PUNTO 2.3.2. TAMAÑO NEONATAL, EN TRES DIFERENTES TAMAÑOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE Y NOS PERMITA OFERTAR TRES BRAZALETES REUSABLES LIBRES DE LÁTEX DE UN SOLO TAMAÑO NEONATAL YA QUE LA MEDICIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA EN ESTE GRUPO DE PACIENTES SE REALIZA BAJO PARÁMETROS ESTANDARIZADOS Y EL USO DE UN ÚNICO TAMAÑO CUBRE ADECUADAMENTE EL RANGO DE CIRCUNFERENCIAS NEONATALES SIN AFECTAR LA PRECISIÓN NI LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	CONVOCATORIA.	
25	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	SEGUNDA VUELTA, PREGUNTA 170 DEL LICITANTE ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	PARTIDA 12, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 1.10 INDICADO EN LA PRESENTE PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR NOS PERMITA OFERTAR EL LLENADO DE LA LAVADORA ULTRASÓNICA MEDIANTE CONTENENEDORES EXTERNOS YA QUE ESTO NO PERJUDICA EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
26	ELECTRONICA Y MEDICINA SA	MODIFICACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO DE LA JA	FAVOR DE CONFIRMAR SI LAS ADECUACIONES O MODIFICACIONES REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA CONSTRUCTORA Y SI DEBERÁN ENTREGARSE AL LICITANTE ADJUDICADO ANTES DE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO.	SE INFORMA A LA PROVEEDURIA QUE DEBERA, CONSIDERAR LO ESTIPULADO EN LA CONVOCATORIA, ASI COMO A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, Y ESPECIFICAMENTE A LO ESTIPULADO EN ACTA DE 2DA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026, TRANSMITIDA EN PLATAFORMA, EN SU ANEXO III MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
27	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA NO. 53 DEL LICITANTE SIEMENS	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPOLAR 2. ACCESORIOS NUMERAL 2.1 INYECTOR DUAL DE MEDIO DE CONTRASTE DE ALTA PRESIÓN INTERFASADO O SINCRONIZADO AL	NO SE DA RESPUESTA, TODA VEZ QUE NO EXISTE UN CUESTIONAMIENTO.	ÁREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
		HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	EQUIPO (INCLUIR MARCA Y MODELO). (SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR EQUIPOS CON CONFIGURACIÓN MONOCABEZAL O DUAL, CONSIDERANDO QUE AMBAS CONFIGURACIONES PERMITEN LA ADMINISTRACIÓN CONTROLADA DE MEDIO DE CONTRASTE REQUERIDA EN PROCEDIMIENTOS ANGIOGRÁFICOS. ASIMISMO, LIMITAR EL REQUERIMIENTO EXCLUSIVAMENTE A UNA CONFIGURACIÓN DUAL PODRÍA RESTRINGIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONSIDERANDO QUE EXISTEN EQUIPOS DISPONIBLES EN EL MERCADO, INCLUYENDO TECNOLOGÍA OFERTADA POR OTROS LICITANTES QUE PARTICIPAN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, QUE NO CUENTAN CON DICHA CONFIGURACIÓN. POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS ACEPTAR AMBAS CONFIGURACIONES, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LOS PARÁMETROS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD REQUERIDOS.		
28	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA NO. 143 DEL LICITANTE NUDOMI SA DE CV	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPOLAR 2. ACCESORIOS NUMERAL 2.7 (10) DIEZ MANDILES PLOMADOS, (10) DIEZ ANTEOJOS PLOMADOS, (10) DIEZ PARES DE GUANTES PLOMADOS, (10) DIEZ COLLARINES PLOMADOS, (5) CINCO PROTECTORES GONADALES Y (1) UN PORTA MANDILES CON CAPACIDAD PARA 10 MANDILES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE, PARA LA PRESENTE PARTIDA, SE OFERTE LA SIGUIENTE CANTIDAD DE ACCESORIOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA: (5) CINCO MANDILES PLOMADOS, (5) CINCO ANTEOJOS PLOMADOS, (5) CINCO PARES	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			DE GUANTES PLOMADOS, (5) CINCO COLLARINES PLOMADOS, (5) CINCO PROTECTORES GONADALES Y (1) UN PORTA MANDILES CON CAPACIDAD PARA 10 MANDILES. LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LA PROPUESTA ECONÓMICA Y OFRECER CONDICIONES MÁS COMPETITIVAS, SIN COMPROMETER LA FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD NI EL NIVEL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA REQUERIDO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO. EN ESTE SENTIDO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE CONFIRME SI ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?		
29	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA NO. 145 DEL LICITANTE NUDOMI SA DE CV	PARTIDA 4 UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUROSCOPÍA DIGITAL CON TELEMANDO NUMERAL 2.2. CONSIDERANDO QUE: TANTO LA CONFIGURACIÓN MONOCABEZAL COMO LA DUAL CUMPLEN CLÍNICAMENTE CON LA ADMINISTRACIÓN CONTROLADA DE MEDIO DE CONTRASTE A ALTA PRESIÓN PARA LOS PROCEDIMIENTOS INTERVENCIONISTAS. LA OPCIÓN MONOCABEZAL OPTIMIZA LA EFICIENCIA OPERATIVA EN SALA (MENOR TIEMPO DE PREPARACIÓN) Y REPRESENTA UNA ALTERNATIVA TÉCNICAMENTE FUNCIONAL, CON MENOR COSTO DE INSUMOS Y ECONÓMICAMENTE COMPETITIVA, GARANTIZANDO LOS MISMOS PARÁMETROS DE DESEMPEÑO Y SEGURIDAD. ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS ACEPTE LA PARTICIPACIÓN DE INYECTORES CON CONFIGURACIÓN MONOCABEZAL O DUAL, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LOS PARÁMETROS TÉCNICOS DE PRESIÓN,	EL LICITANTE PODRA OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES, NO OBSTANTE EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO. SE VERIFICARÁ LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE, LA CUAL DEBERÁ SER LEGIBLE, AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS.	ÁREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			FLUJO, VOLUMEN, SEGURIDAD E INTEGRACIÓN REQUERIDOS?		
30	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA NO. 148 DEL LICITANTE NUDOMI SA DE CV	PARTIDA 4 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUROSCOPIADIGITAL CON TELEMANDO NUMERAL 2.3 UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE UPS, DE AL MENOS 20 MINUTOS A PLENA CARGA PARA TODO EL EQUIPO Y EL EQUIPO DE CÓMPUTO (INCLUIR MARCA Y MODELO) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE NOS PERMITA OFERTAR UNA UNIDAD DE ENERGÍA INTINTERRUMPIBLE UPS DE 10 MINUTOS DE RESPALDO PARA TODO EL EQUIPO Y EQUIPO DE CÓMPUTO YA QUE EL OBJETIVO PRIMARIO DE UN UPS EN UN SISTEMA DE IMAGENOLOGÍA ES PERMITIR LA CONCLUSIÓN DE LA FASE CRÍTICA DE UN PROCEDIMIENTO EN CURSO O, EN SU DEFECTO, REALIZAR EL GUARDADO SEGURO DE IMÁGENES Y EL APAGADO CONTROLADO DEL EQUIPO (SAFE SHUTDOWN). UN TIEMPO DE AUTONOMÍA DE 10 MINUTOS ES MÁS QUE SUFICIENTE PARA REALIZAR ESTAS ACCIONES SIN COMPROMETER LA SEGURIDAD DEL PACIENTE NI LA INTEGRIDAD DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS DEL SISTEMA.	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
31	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA NO. 144 DEL LICITANTE NUDOMI SA DE CV	PARTIDA 1 ANGIOGRAFO ARCO MONOPOLAR 2. ACCESORIOS NUMERAL 2.1 INYECTOR DUAL DE MEDIO DE CONTRASTE DE ALTA PRESIÓN INTERFASADO O SINCRONIZADO AL EQUIPO (INCLUIR MARCA Y MODELO). (SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO). CONSIDERANDO QUE LA FUNCIÓN PRINCIPAL DEL INYECTOR EN LOS PROCEDIMIENTOS ANGIOGRÁFICOS CONSISTE EN LA ADMINISTRACIÓN CONTROLADA DE MEDIO DE CONTRASTE A ALTA PRESIÓN, Y QUE ACTUALMENTE EXISTEN SOLUCIONES CON	EL LICITANTE PODRA OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES, NO OBSTANTE EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO. SE VERIFICARÁ LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE, LA CUAL DEBERÁ SER LEGIBLE, AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS.	ÁREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			CONFIGURACIÓN MONOCABEZAL Y DUAL QUE PERMITEN ATENDER LAS NECESIDADES PROPIAS DE LOS PROCEDIMIENTOS ANGIOGRÁFICOS, DE ACUERDO CON SUS CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS CLÍNICOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LA ACEPTACIÓN DE AMBAS CONFIGURACIONES. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE LA CONFIGURACIÓN MONOCABEZAL OFRECE VENTAJAS COMO UNA OPERACIÓN MÁS SENCILLA, MENOR CONSUMO Y COSTO DE INSUMOS, ASÍ COMO UNA REDUCCIÓN EN LOS TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA PREPARACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO PREVIO AL PROCEDIMIENTO, FAVORECIENDO LA EFICIENCIA OPERATIVA DE LA SALA DE ANGIOGRAFÍA. ASIMISMO, ESTA CONFIGURACIÓN PERMITE CONTAR CON UNA ALTERNATIVA TÉCNICAMENTE FUNCIONAL Y ECONÓMICAMENTE COMPETITIVA, SIN MENOSCABO DE LOS PARÁMETROS DE DESEMPEÑO Y SEGURIDAD REQUERIDOS. POR LO ANTERIOR, ¿SERÍA POSIBLE QUE LA CONVOCANTE PERMITA LA PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS CON CONFIGURACIÓN MONOCABEZAL O DUAL, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LOS PARÁMETROS TÉCNICOS REQUERIDOS DE PRESIÓN, FLUJO, VOLUMEN, SEGURIDAD E INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE ANGIOGRAFÍA, GARANTIZANDO CON ELLO EL ADECUADO DESEMPEÑO Y SEGURIDAD DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS?		
32	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA NO. 149	J) GARANTÍAS DE ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE BIENES, CALIDAD DE	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
		DEL LICITANTE NUDOMI SA DE CV	SERVICIOS Y DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, QUE EN SU CASO APLIQUEN. C. MANTENIMIENTO MAYOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE OMITIR ESTE REQUERIMIENTO YA QUE AL TRATARSE DE EQUIPOS EN SU PERIODO INICIAL DE OPERACIÓN, SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIO QUEDAN PLENAMENTE CUBIERTOS POR LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BAJO GARANTÍA. EXIMIR EL MANTENIMIENTO MAYOR EVITARÁ REPERCUTIR COSTOS DE INTERVENCIONES COMPLEJAS NO REQUERIDAS A CORTO PLAZO, FAVORECIENDO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS PARA LA INSTITUCIÓN.		
33	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA 114 DEL LICITANTE NUDOMI S.A. DE C.V.	PARTIDA 1. ANGIÓGRAFO ARCO MONOPLANAR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RCONSIDERE NOS PERMITA OFERTAR 1 (UNO) TRANSDUCTOR TRANSTORÁCICO MATRICIAL CON CAPACIDAD DE REALIZAR 3D ASÍ COMO CUANTIFICACIÓN DE AURÍCULA Y VENTRÍCULO IZQUIERDO Y LOS CATÉTERES INTRACARDIACOS DE MANERA OPCIONAL, SE DA CUMPLIMIENTO AL PRESENTE PUNTO ¿FAVOR DE ACLARAR?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
34	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA 115 DEL LICITANTE NUDOMI S.A. DE C.V.	PARTIDA 1. ANGIÓGRAFO ARCO MONOPLANAR, PUNTO2.9 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DARÁ POR CUMPLIDO EL PRESENTE PUNTO, TODA VEZ QUE LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS SEAN DEMOSTRADAS DOCUMENTALMENTE A	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			TRAVÉS DE FOLLETOS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O CARTAS DEL FABRICANTE INTEGRADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?		
35	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA 115 DEL LICITANTE NUDOMI S.A. DE C.V.	PARTIDA 1. ANGIÓGRAFO ARCO MONOPLANAR, EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR ESTE PUNTO Y CLASIFICARLO COMO OPCIONAL. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y LA CONCURRENCIA DE LICITANTES, DADO QUE DIVERSAS CASAS COMERCIALES CUENTAN CON ARQUITECTURAS TECNOLÓGICAS DISTINTAS QUE GARANTIZAN LA MISMA FUNCIONALIDAD MÉDICA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
36	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA 116 DEL LICITANTE NUDOMI S.A. DE C.V.	PARTIDA 1. ANGIÓGRAFO ARCO MONOPLANAR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR DONDE SE SOLICITAN CATÉTERES INTRACARDÍACOS , Y CONSIDERANDO QUE LA EVALUACIÓN CARDÍACA REQUERIDA SE SATISFACE DE FORMA INTEGRAL Y NO INVASIVA MEDIANTE EL TRANSDUCTOR TRANSTORÁCICO MATRICIAL (CON ADQUISICIÓN 3D Y HERRAMIENTAS DE CUANTIFICACIÓN AURICULAR Y VENTRICULAR), MIENTRAS QUE LA TÉCNICA INTRACARDÍACA DEPENDE DE CONSUMIBLES DE TERCEROS DE ESPECIALIDAD; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE NOS PERMITA OFERTAR DICHO TRANSDUCTOR TRANSTORÁCICO, QUEDANDO EL SUMINISTRO DE LOS CATÉTERES INTRACARDÍACOS DE MANERA OPCIONAL, SIN QUE SU NO INCLUSIÓN	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?		
37	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA 117 DEL LICITANTE NUDOMI S.A. DE C.V.	PARTIDA 1. ANGIÓGRAFO ARCO MONOPLANA TODA VEZ QUE LA APLICACIÓN TRANSTORÁCICA CON ADQUISICIÓN VOLUMÉTRICA 3D CUBRE LA EVALUACIÓN CARDÍACA REQUERIDA DE FORMA NO INVASIVA, MIENTRAS QUE LA APLICACIÓN INTRACARDÍACA ES UNA TÉCNICA ESPECIALIZADA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DE ULTRASONIDO TRANSTORÁCICO 2D/3D CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A TRANSESOFÁGICO, CONSIDERANDO COMO OPCIONALES LA FUNCIONALIDAD DE ULTRASONIDO INTRACARDÍACO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN ?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
38	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA 118 DEL LICITANTE NUDOMI S.A. DE C.V.	PARTIDA 1. ANGIÓGRAFO ARCO MONOPLANA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI, SE DARÁ POR TÉCNICAMENTE CUMPLIDO EL REQUERIMIENTO AL PRESENTAR LA CONSOLA/SISTEMA DE ULTRASONIDO CORRESPONDIENTE, BASTANDO CON DEMOSTRAR Y ACREDITAR DOCUMENTALMENTE MEDIANTE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA O FOLLETO DEL FABRICANTE QUE EL EQUIPO CUENTA CON LA CAPACIDAD PARA REALIZAR DICHAS MODALIDADES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
39	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA 105 DEL LICITANTE NUDOMI S.A. DE C.V.	PARTIDA 5 UNIDAD RADIOGRÁFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE DIGITAL PUNTO. 1.1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR EL REQUERIMIENTO Y PERMITIR QUE EL GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA PUEDA SER REFERENCIADO	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA Y ESPECIFICACIONES PROPIAS DE CADA FABRICANTE, CONSIDERANDO QUE LA FRECUENCIA EN KHZ CONSTITUYE UNA CARACTERÍSTICA INTERNA DE DISEÑO DEL GENERADOR Y NO NECESARIAMENTE UN PARÁMETRO QUE DETERMINE POR SÍ MISMO EL DESEMPEÑO CLÍNICO DEL SISTEMA. EN ESTE SENTIDO, SOLICITAMOS SE PERMITA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO MEDIANTE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE QUE DEMUESTRE QUE EL SISTEMA CUENTA CON UN GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS DE POTENCIA, ESTABILIDAD Y DESEMPEÑO CORRESPONDIENTES, SIN ESTABLECER COMO CONDICIÓN INDISPENSABLE LA PRESENTACIÓN DE UN VALOR ESPECÍFICO DE FRECUENCIA EN KHZ. ¿SE ACEPTA?		
40	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA 107 DEL LICITANTE NUDOMI S.A. DE C.V.	PARTIDA 5 UNIDAD RADIOGRÁFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE DIGITAL PUNTO 2.1.2 SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR ESTABLECER COMO REQUISITO DE ACUERDO A LA ARQUITECTURA DE CADA FABRICANTE, UNA RESOLUCIÓN DE 2 MP O MAYOR CUMPLIENDO CON RESOLUCIÓN FULL HD O EL EQUIVALENTE CON UNA LUMINANCIA DE 250 NITS (CD/M^2) O MAYOR. LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE LOS MONITORES CON RESOLUCIÓN FULL HD O FULL HD+ CON LA LUMINANCIA PERMITEN UNA ADECUADA VISUALIZACIÓN DE LAS IMÁGENES E INFORMACIÓN CLÍNICA, OFRECIENDO UNA RESOLUCIÓN SUFICIENTE PARA LA OPERACIÓN Y VISUALIZACIÓN DEL SISTEMA. EN ESTE SENTIDO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			CONVOCANTE PERMITIR MONITORES CON UNA RESOLUCIÓN DE 2 MP O MAYOR, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN DE SOLUCIONES TÉCNICAMENTE ADECUADAS. ¿ES ACEPTABLE OFERTAR NUESTRA PROPUESTA?		
41	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA 108 DEL LICITANTE NUDOMI S.A. DE C.V.	PARTIDA 4 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 1.2 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR EL REQUERIMIENTO Y PERMITIR QUE EL GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA PUEDA SER REFERENCIADO DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA Y ESPECIFICACIONES PROPIAS DE CADA FABRICANTE, CONSIDERANDO QUE LA FRECUENCIA EN KHZ CONSTITUYE UNA CARACTERÍSTICA INTERNA DE DISEÑO DEL GENERADOR Y NO NECESARIAMENTE UN PARÁMETRO QUE DETERMINE POR SÍ MISMO EL DESEMPEÑO CLÍNICO DEL SISTEMA. EN ESTE SENTIDO, SOLICITAMOS SE PERMITA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO MEDIANTE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE QUE DEMUESTRE QUE EL SISTEMA CUENTA CON UN GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS DE POTENCIA, ESTABILIDAD Y DESEMPEÑO CORRESPONDIENTES, SIN ESTABLECER COMO CONDICIÓN INDISPENSABLE LA PRESENTACIÓN DE UN VALOR ESPECÍFICO DE FRECUENCIA EN KHZ. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
42	ASESORES EN TECNOLOGIA BIOMEDICA S DE RL DE CV	SEGUNDA VUELTA, PREGUNTA 170 DEL LICITANTE ASESORES EN TECNOLOGIA	PARTIDA 12, PUNTO 1.1.10 POR LO QUE DEBEMOS ENTENDER QUE SE TIENE QUE PROVEER DE LA INSTALACIÓN DE UNA TOMA DE AGUA CON SUAVIZADOR PARA QUE DE LA MISMA EL USUARIO PUEDA	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE EN EL NUMERAL 1.10 EL LICITANTE PUEDE INCLUIR EN SU PROPUESTA CAPACIDAD DE TOMA DE AGUA O LLENADO MANUAL. SIN EMBARGO, ESTO NO EXIME LA	ÁREA TÉCNICA



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
		BIOMEDICA S DE RL DE CV	SACAR AGUA PARA EL EQUIPO, FAVOR DE ACLARAR.	OBLIGATORIEDAD DE CONTAR CON LA TOMA DE AGUA CON SUAVIZADOR DE AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE (NUMERAL 4.3), YA QUE LA DEFINICIÓN DE QUE EL EQUIPO SE LLENE DE MANERA MANUAL REPRESENTA QUE EL USUARIO TENGA QUE ABRIR/CERRAR EL SUMINISTRO DE AGUA DE LA RED FIJA PARA EL LLENADO DE LA LAVADORA ULTRASÓNICA. NO SE ACEPTARÁ EL LLENADO MEDIANTE CONTENEDORES EXTERNOS O GARRAFONES.	
43	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 88 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA EMITIDA Y PERMITA OFERTAR EQUIPOS DE DOBLE PUERTA, CONFIGURABLES PARA OPERAR COMO PUERTA ÚNICA, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
44	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 89 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA EMITIDA Y PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CÁMARA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 Y UNA CAPACIDAD DE 296 LITROS, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
45	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 90 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA EMITIDA Y PERMITA OFERTAR UN FILTRO HEPA PARA LA FASE DE VENTILACIÓN Y SECADO, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
46	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 91 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA EMITIDA Y PERMITA OFERTAR CANASTILLAS DE ACERO INOXIDABLE ELECTROPULIDO, ABIERTAS Y SIN TAPA, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
47	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 92 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA EMITIDA Y PERMITA OFERTAR UN (1) CARRO DE TRANSPORTE TIPO RACK DE ACERO INOXIDABLE ELECTROPULIDO, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
48	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 93 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA EMITIDA Y PERMITA OFERTAR EL USO DE ACERO INOXIDABLE SIN RESTRINGIR EXCLUSIVAMENTE AL TIPO 304, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
49	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 95 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA EMITIDA Y PERMITA OFERTAR DETERGENTE ENZIMÁTICO LÍQUIDO EN PRESENTACIÓN DE GALÓN CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
50	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 96 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA EMITIDA Y PERMITA OFERTAR UN SELLO CON DISEÑO TIPO LABERINTO, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
51	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 221 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA EMITIDA Y PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y/O VISUALES DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL EVENTO, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
52	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 222 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA EMITIDA Y PERMITA QUE EL SUMINISTRO DEL ABRILLANTADOR SEA OPCIONAL, EN CASO DE QUE EL	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
		C.V.	DETERGENTE PROVISTO INCORPORE ESTA CARACTERÍSTICA EN SU FORMULACIÓN, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?		
53	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 223 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA EMITIDA Y PERMITA OFERTAR UN ESTERILIZADOR CON CAPACIDAD ÚTIL DE 250 LITROS CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
54	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 224 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA EMITIDA Y PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DE CONTROL BASADO EN MICROCOMPUTADOR Y CIRCUITOS PERIFÉRICOS CON SENSORES RTD, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
55	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 225 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA EMITIDA Y PERMITA OFERTAR TEMPERATURAS DE 135°C PARA EL CICLO DE INSTRUMENTAL Y DE 132°C PARA EL DE TEXTILES, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
56	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 226 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA EMITIDA Y PERMITA OFERTAR UNA IMPRESORA INTEGRADA PARA LA GENERACIÓN DEL RESPALDO Y TRAZABILIDAD FÍSICA DE LOS CICLOS, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
57	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 227 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA EMITIDA Y PERMITA OFERTAR UN FILTRO DE RETENCIÓN BACTERIOLÓGICA DE ALTA EFICIENCIA CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?		
58	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 228 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA EMITIDA Y PERMITA OFERTAR UNA IMPRESORA INTERCONSTRUIDA CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
59	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 229 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA EMITIDA Y PERMITA OFERTAR CARROS DE CARGA TIPO RACK EQUIPADOS CON LAS PARRILLAS O ESTANTES CORRESPONDIENTES AL DISEÑO DE FÁBRICA, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
60	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 230 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA EMITIDA Y PERMITA OFERTAR LOS CONSUMIBLES ACORDES A LA TECNOLOGÍA ESPECÍFICA DE LA IMPRESORA, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
61	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 231 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA EMITIDA Y PERMITA OFERTAR CAJAS DE BOLSAS PARA ESTERILIZACIÓN CON DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE FÁBRICA EQUIVALENTES A LAS SOLICITADAS, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
62	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 232 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA EMITIDA Y PERMITA OFERTAR LOS COMPONENTES DE CONDUCCIÓN, CONEXIÓN Y CONTROL CONFORME A LA CONFIGURACIÓN Y TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
63	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 236 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA EMITIDA Y PERMITA OFERTAR UN PANEL FRONTAL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE COMO ESPECIFICACIÓN MÍNIMA, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
64	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 237 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA EMITIDA Y PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO EQUIPADO CON SENSORES DE TEMPERATURA TIPO RTD Y TRANSDUCTORES DE PRESIÓN, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
65	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 238 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA EMITIDA Y PERMITA OFERTAR UN FILTRO ANTIBACTERÍAS, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
66	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 240 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y EVITAR LIMITAR LA CONCURRENCIA DE FABRICANTES Y PROVEEDORES, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR LA OFERTA DE EQUIPOS QUE CUENTEN CON UN AJUSTE VERTICAL HACIA ARRIBA DE 45° O MAYOR Y HACIA ABAJO DE 70° O MAYOR, CONSIDERANDO QUE DICHAS CARACTERÍSTICAS PERMITEN CUMPLIR FUNCIONALMENTE CON LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
67	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 241 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE	CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y PERMITIR LA CONCURRENCIA DE EQUIPOS DE DIFERENTES FABRICANTES, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
		C.V.	PERMITIR ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERÍA AL 100% MEDIANTE CARTA DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, CUANDO DICHA INFORMACIÓN NO SE ENCUENTRE ESPECIFICADA EN EL MANUAL O FICHA TÉCNICA, SIEMPRE QUE EL EQUIPO CUMPLA TÉCNICAMENTE CON LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?		
68	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 242 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y EVITAR LIMITAR LA CONCURRENCIA DE DIFERENTES FABRICANTES, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR EQUIPOS QUE CUENTEN CON UN AJUSTE VERTICAL HACIA ARRIBA DE 45° O MAYOR Y HACIA ABAJO DE 70° O MAYOR, CONSIDERANDO QUE DICHAS CARACTERÍSTICAS PERMITEN CUMPLIR FUNCIONALMENTE CON LAS NECESIDADES REQUERIDAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
69	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 243 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y EVITAR LIMITAR LA CONCURRENCIA DE DIFERENTES FABRICANTES, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR SISTEMAS DE ILUMINACIÓN QUIRÚRGICA CON TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE EN UN RANGO DE 3,500 K A 5,000 K, SIEMPRE QUE SE GARANTICE UNA ADECUADA REPRODUCCIÓN CROMÁTICA Y SE CUMPLAN LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS DE ILUMINACIÓN SOLICITADAS. LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE LA TEMPERATURA DE COLOR	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			CORRELACIONADA (CCT) DETERMINA LA APARIENCIA CROMÁTICA DE LA LUZ, MIENTRAS QUE LA REPRODUCCIÓN DE LOS COLORES SE EVALÚA MEDIANTE PARÁMETROS ESPECÍFICOS COMO EL ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI). POR LO ANTERIOR, UN RANGO DE 3,500 K A 5,000 K PERMITE AJUSTAR LA TONALIDAD DE LA ILUMINACIÓN DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL PROCEDIMIENTO, SIN COMPROMETER LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?		
70	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 244 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y EVITAR LIMITAR LA CONCURRENCIA DE DIFERENTES FABRICANTES, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR SISTEMAS DE ILUMINACIÓN QUIRÚRGICA CON TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE EN UN RANGO DE 3,500 K A 5,000 K, SIEMPRE QUE SE GARANTICE UNA ADECUADA REPRODUCCIÓN CROMÁTICA Y SE CUMPLAN LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS DE ILUMINACIÓN SOLICITADAS. LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE LA TEMPERATURA DE COLOR (CCT) ÚNICAMENTE DETERMINA LA APARIENCIA CROMÁTICA DE LA LUZ, MIENTRAS QUE LA REPRODUCCIÓN DE LOS COLORES SE EVALÚA MEDIANTE PARÁMETROS ESPECÍFICOS COMO EL ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI), POR LO QUE UN MAYOR VALOR DE KELVIN NO REPRESENTA POR SÍ MISMO UN MAYOR DESEMPEÑO O FUNCIONALIDAD. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
71	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 245 DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y EVITAR LIMITAR LA CONCURRENCIA DE DIFERENTES FABRICANTES, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR COMO CRITERIO MÍNIMO UNA AUTONOMÍA DE 1 HORA (60 MINUTOS) PARA EL UPS, SIEMPRE QUE PERMITA MANTENER LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DURANTE DICHO PERIODO. LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE EN LAS BASES SE ESTABLECEN DIFERENTES TIEMPOS DE AUTONOMÍA, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE UNIFICAR EL CRITERIO Y PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS QUE CUENTEN CON UNA AUTONOMÍA MÍNIMA DE 60 MINUTOS, SIN COMPROMETER LA FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
72	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	100	DERIVADO DE LA RESPUESTA OTORGADA POR LA. CONVOCANTE A LA EMPRESA MEDIXSA S.A. DE C.V., Y CON EL OBJETIVO DE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 2.1. CALIDAD, EL CUAL ESTABLECE A LA LETRA QUE LOS LICITANTES: "ENTREGARÁN ESCRITO LIBRE QUE EL BIEN OFERTADO CUMPLE CON LO SOLICITADO, DONDE DESGLOSARÁN LO REQUERIDO EN EL ANEXO TÉCNICO Y EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DESCRITOS EN EL ANEXO 1 (UNO)"; SE SOLICITA AMABLEMENTE CONFIRMAR LO SIGUIENTE: PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL, ¿BASTARÁ CON PRESENTAR UN ÚNICO ESCRITO LIBRE EN EL QUE SE INTEGRE UNA RELACIÓN O TABLA CON LAS PARTIDAS EXACTAS EN LAS QUE	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			OFERTAMOS, MANIFESTANDO QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LO SOLICITADO E INCLUYENDO EN ESE MISMO DOCUMENTO EL CONTENIDO O LA REFERENCIA A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y EL ANEXO TÉCNICO, SIN QUE RESULTE CAUSAL DE DESECHAMIENTO EL NO TRANSCRIBIR DE FORMA LITERAL E ÍNTEGRA TODOS LOS DOCUMENTOS DENTRO DEL CUERPO DEL ESCRITO LIBRE? ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?		
73	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	101	DERIVADO DE LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA MEDIXSA, S.A. DE C.V., EN RELACIÓN CON EL ANEXO NO. 4.8, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR UN SOLO FORMATO QUE AMPARE LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS OFERTADAS Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE DESTINO CONFORME AL ANEXO NO. 3.5, O SI DEBERÁ PRESENTARSE UN ANEXO NO. 4.8 INDEPENDIENTE POR CADA PARTIDA Y/O UNIDAD MÉDICA. FAVOR DE ACLARAR.	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE SE DEBE INTEGRAR EN SU PROPUESTA UN ANEXO NO. 4.8 POR CADA PARTIDA Y UNIDAD MEDICA.	ÁREA TÉCNICA
74	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	101	DERIVADO DE LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA MEDIXSA, S.A. DE C.V., SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN RELATIVA A LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN E INSTALACIÓN SEÑALADA EN ESTE APARTADO, SERÁ SUFICIENTE INTEGRAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA EL ANEXO NO. 4.8 DEBIDAMENTE REQUISITADO Y FIRMADO, SIN QUE SEA NECESARIO PRESENTAR ESCRITOS LIBRES ADICIONALES SOBRE EL MISMO COMPROMISO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
75	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA NO. 53, LICITANTE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV PARTIDA 1. ARCO MONOPLANAR PUNTO 2.1.	UN INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE DE UN SOLO CABEZAL PERMITE REALIZAR PROCEDIMIENTOS ANGIOGRÁFICOS DE MANERA SEGURA Y EFICIENTE, YA QUE, AL CONCLUIR LA INYECCIÓN AUTOMATIZADA, EL MEDIO DE CONTRASTE CONTINÚA DISTRIBUYÉNDOSE FISIOLÓGICAMENTE MEDIANTE EL FLUJO SANGUÍNEO DEL PACIENTE, SIN REQUERIR NECESARIAMENTE UNA INYECCIÓN POSTERIOR DE SOLUCIÓN SALINA. POR ELLO, UN SEGUNDO CABEZAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A DICHA SOLUCIÓN NO REPRESENTA UN BENEFICIO INDISPENSABLE, MIENTRAS QUE PUEDE INCREMENTAR LA COMPLEJIDAD DE PREPARACIÓN Y OPERACIÓN, ASÍ COMO EL RIESGO DE ERRORES DE MANIPULACIÓN E INTRODUCCIÓN DE BURBUJAS DE AIRE. ASIMISMO, IMPLICA MAYORES COSTOS DE EQUIPO, CONSUMIBLES, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. POR LO ANTERIOR, Y CON EL PROPÓSITO DE FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE MAYORES ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS SIN AFECTAR LA FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD Y CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE DE UN SOLO CABEZAL, INTERFASADO O SINCRONIZADO CON EL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	EL LICITANTE PODRA OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES, NO OBSTANTE EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO. SE VERIFICARÁ LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE, LA CUAL DEBERÁ SER LEGIBLE, AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS.	ÁREA TÉCNICA
76	MEDIXSA SA DE CV	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA POR LA CONVOCANTE A LA PREGUNTA NO. 85 REALIZADA POR LA EMPRESA MEDISXA	PARTIDA 32 DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA POR LA CONVOCANTE A LA PREGUNTA NO. 85 REALIZADA POR LA EMPRESA MEDISXA SA DE CV EN LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES. EN CASO DE SER NEGATIVA LA ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR UN EQUIPO	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
		SA DE CV EN LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES.	QUE TENGA LA CAPACIDAD A FUTURO DE EXPORTAR LA INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD EN TIEMPO REAL DE LA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO A TRAVÉS DE UN PUERTO ETHERNET (EL SOFTWARE DE TRAZABILIDAD EN TIEMPO REAL NO ES PARTE DE LA OFERTA), ¿ES CORRECTO?.		
77	MEDIXSA SA DE CV	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA POR LA CONVOCANTE A LA PREGUNTA NO. 99 REALIZADA POR LA EMPRESA MEDISXA SA DE CV EN LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES.	PARTIDA 33 DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA POR LA CONVOCANTE A LA PREGUNTA NO. 99 REALIZADA POR LA EMPRESA MEDISXA SA DE CV EN LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA RESPECTO A LA POSIBILIDAD DE EXPORTAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD A TRAVÉS DE UNA MEMORIA SD INCLUYENDO UN ADAPTADOR SD A USB, EL CUAL PUEDE SER UTILIZADO EN CUALQUIER EQUIPO DE CÓMPUTO QUE UTILICE PARA SU SISTEMA DE TRAZABILIDAD.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
78	MEDIXSA SA DE CV	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA POR LA CONVOCANTE A LA PREGUNTA NO. 99 EN LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES REALIZADA POR LA EMPRESA MEDISXA SA DE CV.	PARTIDA 33 DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA POR LA CONVOCANTE A LA PREGUNTA NO. 99 EN LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES REALIZADA POR LA EMPRESA MEDISXA SA DE CV. PREGUNTA: EN CASO DE SER NEGATIVA LA ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA LA CAPACIDAD A FUTURO DE EXPORTAR LA INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD EN TIEMPO REAL DE LA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO A TRAVÉS DE UN PUERTO ETHERNET (EL SOFTWARE DE TRAZABILIDAD EN TIEMPO REAL NO ES PARTE DE LA OFERTA), ¿ES CORRECTO?.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
79	ESCALA BIOMEDICA SA DE CV	PREGUNTAS NO. 174 Y 175 DEL LICITANTE ESCALA	LA RESPUESTA DADA A LA EMPRESA ESCALA BIOMÉDICA, SEÑALAN QUE NO ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN,	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE NO SE DEBE INTEGRAR EN SU PROPUESTA INFORMACIÓN EN LA COLUMNA	ÁREA TÉCNICA





Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
		BIOMÉDICA S.A. DE C.V.	RESPECTO AL ANEXO 19, SIN EMBARGO, NO CLARIFICAN QUE TIPO DE INFORMACIÓN DEBEMOS COLOCAR EN LA COLUMNA CON TITULO "INCLUIDO EN PROP", LA CUAL ESTÁ A LADO DERECHO DE LA COLUMNA DE "DESCRIPCIÓN DEL BIEN PROPUESTO". ¿ PODRÍAN INDICAR QUE TIPO DE INFORMACIÓN SE DEBE PONER EN LA COLUMNA "INCLUIDO EN PROP"?	"INCLUIDO EN PROP.". INVARIABLEMENTE SE DEBE INDICAR TODA LA INFORMACIÓN RESTANTE SOLICITADA EN EL ANEXO NÚMERO 19 (DIECINUEVE) E INTEGRARLA EN SU PROPOSICIÓN.	
80	ESCALA BIOMEDICA SA DE CV	PREGUNTA NO. 176 DEL LICITANTE ESCALA BIOMÉDICA S.A. DE C.V.	LA RESPUESTA DADA EN LA PREGUNTA REFERIDA, INDICAN QUE NO SE ACEPTA LA SOLICITUD, Y QUE DEBEMOS APEGARNOS A LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE, SIN EMBARGO, NUESTRA SOLICITUD NO BUSCA REALIZAR ALGÚN CAMBIO A LAS BASES DE LA LICITACIÓN, EN PARTICULAR AL ANEXO 19, LO QUE SOLICITAMOS ES QUE ACLAREN QUE TIPO DE INFORMACIÓN DEBEMOS COLOCAR EN CADA UNA DE LAS COLUMNAS DEL ANEXO 19, DEBIDO A QUE EN LA CONVOCATORIA PUBLICADA NO EXISTE UNA GUÍA DE LLENADO DEL ANEXO 19, POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA, PROPORCIONEN LA GUÍA DE LLENADO DEL ANEXO 19, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DEL ID DE PREGUNTA 133485.	ÁREA TÉCNICA
81	ESCALA BIOMEDICA SA DE CV	PREGUNTA NO. 201 DEL LICITANTE ESCALA BIOMÉDICA SA DE CV	DE ACUERDO CON LO CONTESTADO EN LA PREGUNTA DE REFERENCIA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL AIRE ACONDICIONADO, SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LAS ADECUACIONES DE OBRA CIVIL NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN LAS PARTIDAS 1, 4 Y 5 SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA CONVOCANTE Y SE EJECUTARAN DE ACUERDO A LA GUÍA MECÁNICA DEL LICITANTE ADJUDICADO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	FAVOR DE REMITIRSE A LO ESTIPULADO EN ACTA DE 2DA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026, TRANSMITIDA EN PLATAFORMA, EN SU ANEXO III MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
82	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE	PARTIDA 4 UNIDAD RADIOLOGICA Y	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A	ÁREA TÉCNICA



ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
		ACLARACIONES, PREGUNTA 109 DEL LICITANTE NUDOMI S.A. DE C.V.	FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO : SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR EL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN ESTE PUNTO Y PERMITIR EL CUMPLIMIENTO CON UN SISTEMA QUE CUENTA CON UN RANGO DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 1.0 MS A 4 S, CONSIDERANDO QUE EL EQUIPO OFERTADO INCORPORA LA TECNOLOGÍA INTELIGENTE DE EXPOSICIÓN, LA CUAL OPTIMIZA Y ADAPTA AUTOMÁTICAMENTE LOS PARÁMETROS DE EXPOSICIÓN DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ANATOMÍA DEL PACIENTE, AJUSTANDO KV Y MA EN TIEMPOS DEL ORDEN DE MILISEGUNDOS, PERMITIENDO OBTENER LA CALIDAD DE IMAGEN REQUERIDA CON LA CANTIDAD DE RADIACIÓN NECESARIA; ADICIONALMENTE, EN LAS APLICACIONES DE FLUOROSCOPIA, PERMITE OPTIMIZAR LOS PARÁMETROS DE EXPOSICIÓN Y EVITA LA NECESIDAD OPERATIVA DE MANTENER EXPOSICIONES CONTINUAS PROLONGADAS DE HASTA 5 SEGUNDOS, SIN LIMITAR LA REALIZACIÓN DE LAS APLICACIONES RADIOGRÁFICAS Y FLUOROSCÓPICAS CONTEMPLADAS PARA EL SISTEMA. ¿ES ACEPTABLE NUESTRA PROPUESTA?	LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	
83	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA 111 DEL LICITANTE NUDOMI S.A. DE C.V.	PARTIDA 4 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 1.6 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR EL REQUERIMIENTO Y, A FIN DE GARANTIZAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE CONDICIONES ENTRE LAS DISTINTAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			DEL MERCADO RECONSIDERAR EL REQUERIMIENTO Y PERMITIR EL CUMPLIMIENTO MEDIANTE UN SISTEMA QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD DE PROGRAMAR VALORES Y TÉCNICAS DIRECTAMENTE, MISMOS QUE PUEDEN CONFIGURARSE DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD Y LOS PROTOCOLOS CLÍNICOS REQUERIDOS; ESTA FUNCIONALIDAD PERMITE ESTABLECER LOS PARÁMETROS DE EXPOSICIÓN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ADAPTAR LA TÉCNICA A LAS DIFERENTES NECESIDADES CLÍNICAS, PROPORCIONANDO AL USUARIO LA FLEXIBILIDAD NECESARIA PARA CONFIGURAR LOS PROTOCOLOS QUE REQUIERA LA UNIDAD, SIN LIMITAR SU APLICACIÓN A UN NÚMERO PREDETERMINADO DE CONFIGURACIONES. ¿ES ACEPTABLE NUESTRA PROPUESTA?		
84	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA 113 DEL LICITANTE NUDOMI S.A. DE C.V.	PARTIDA 4 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 2.1.3.2 SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR ESTABLECER COMO REQUISITO DE ACUERDO A LA ARQUITECTURA DE CADA FABRICANTE, UNA RESOLUCIÓN DE 2 MP O MAYOR CUMPLIENDO CON RESOLUCIÓN FULL HD O EL EQUIVALENTE CON UNA LUMINANCIA DE 250 NITS (CD/M^2) O MAYOR. LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE LOS MONITORES CON RESOLUCIÓN FULL HD O FULL HD+ CON LA LUMINANCIA PERMITEN UNA ADECUADA VISUALIZACIÓN DE LAS IMÁGENES E INFORMACIÓN CLÍNICA, OFRECIENDO UNA RESOLUCIÓN SUFICIENTE PARA LA OPERACIÓN Y VISUALIZACIÓN DEL	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			SISTEMA. EN ESTE SENTIDO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR MONITORES CON UNA RESOLUCIÓN DE 2 MP O MAYOR, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN DE SOLUCIONES TÉCNICAMENTE ADECUADAS. ¿ES ACEPTABLE OFERTAR NUESTRA PROPUESTA?		
85	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA 132 DEL LICITANTE NUDOMI S.A. DE C.V.	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 1.7 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR EL PRESENTE REQUISITO, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER LA LIBRE CONCURRENCIA Y EVITAR LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES, Y CONFIRMAR SI SE ACEPTA QUE LAS FUNCIONES DE MANIPULACIÓN DE IMÁGENES, ROTACIÓN DE LAS IMÁGENES ADQUIRIDAS EN EL EQUIPO, VISUALIZACIÓN DE LA IMAGEN FLUOROSCÓPICA Y REALIZACIÓN DE ZOOM, PUEDAN SER EJECUTADAS MEDIANTE EL PANEL TÁCTIL (TOUCH PANEL) MONTADO EN LA MESA Y/O MEDIANTE CONTROLES INTERACTIVOS INTEGRADOS A LOS LADOS DE LA MESA DE EXAMEN, TODA VEZ QUE PERMITIR QUE DICHAS FUNCIONES SEAN OPERADAS A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE ESTOS CONTROLES NO LIMITA NI AFECTA EL FUNCIONAMIENTO PRINCIPAL DEL EQUIPO Y, POR EL CONTRARIO, PERMITE MANTENER UN ADECUADO FLUJO DE TRABAJO DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
86	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA 135 DEL LICITANTE NUDOMI S.A. DE C.V.	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 2.2.7 EN APEGO A LOS PRINCIPIOS DE LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA, Y CON LA FINALIDAD DE EVITAR REQUISITOS QUE PUDIERAN LIMITAR INNECESARIAMENTE LA	EL LICITANTE PODRA OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES, NO OBSTANTE EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO. SE VERIFICARÁ LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE,	ÁREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS QUE CUMPLEN PLENAMENTE CON LA FUNCIONALIDAD CLÍNICA REQUERIDA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI SE ACEPTA OFERTAR UNA ESCALA DE GANANCIA/AMPLITUD DE LA SEÑAL ELECTROCARDIOGRÁFICA CON RANGOS DE 0.25 CM/MV, 0.5 CM/MV, 1 CM/MV Y 2 CM/MV. PERMITEN LA ADECUADA VISUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA AMPLITUD DE LA SEÑAL ELECTROCARDIOGRÁFICA DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS MEDIANTE EL POLÍGRAFO, GARANTIZANDO SU PLENA FUNCIONALIDAD DIAGNÓSTICA. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA GANANCIA CORRESPONDE A LA ESCALA DE REPRESENTACIÓN DE LA AMPLITUD DE LA SEÑAL, DETERMINANDO LA ALTURA CON LA QUE SE VISUALIZAN LAS ONDAS ELECTROCARDIOGRÁFICAS, SIENDO 1 CM/MV LA ESCALA ESTÁNDAR DE CALIBRACIÓN CLÍNICA, LOS RANGOS OFERTADOS PERMITEN UNA VISUALIZACIÓN CLARA Y ADECUADA DE LA SEÑAL ECG, SIN AFECTAR LA OBTENCIÓN, INTERPRETACIÓN, DIAGNÓSTICO NI LA TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS Y TERAPÉUTICAS, POR LO QUE CONSTITUYEN UNA ALTERNATIVA TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE Y FUNCIONAL. ¿SE ACEPTA?	LA CUAL DEBERÁ SER LEGIBLE, AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS.	
87	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA 136 DEL LICITANTE NUDOMI S.A. DE C.V.	PARTIDA 1.ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 2.9.1 SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONCIDERE QUE EN APEGO AL PRINCIPIO DE LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y CONSIDERANDO QUE LAS DIMENSIONES FÍSICAS DE LOS GABINETES DE UPS VARÍAN SEGÚN EL	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			FABRICANTE Y EL DISEÑO DE SUS BATERÍAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI SE ACEPTA OFERTAR UN SISTEMA UPS DE 100 KVA CON AUTONOMÍA DE 9 MINUTOS O MAYOR, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL GABINETE Y BANCO DE BATERÍAS SE ADECUEN AL ESPACIO FÍSICO DESTINADO EN LA UNIDAD MÉDICA YA QUE CON ESTA CAPACIDAD Y ESTE TIEMPO ES SUFICIENTE PARA PODER TERMINAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO CON SEGURIDAD PARA EL PACIENTE ¿SE ACEPTA?		
88	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA 143 DEL LICITANTE NUDOMI S.A. DE C.V.	PARTIDA 1.ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR NUMERAL 2. ACCESORIOS NUMERAL PUNTO 2.7 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE NOS PERMITA OFERATAR QUE, PARA LA PRESENTE PARTIDA, SE OFERTE LA SIGUIENTE CANTIDAD DE ACCESORIOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA: (5) CINCO MANDILES PLOMADOS, (5) CINCO ANTEOJOS PLOMADOS, (5) CINCO PARES DE GUANTES PLOMADOS, (5) CINCO COLLARINES PLOMADOS, (5) CINCO PROTECTORES GONADALES Y (1) UN PORTA MANDILES CON CAPACIDAD PARA 10 MANDILES. LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LA PROPUESTA ECONÓMICA, SIN COMPROMETER LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO, SEGURIDAD NI EL NIVEL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA REQUERIDO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO.¿ SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
89	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA 144 DEL LICITANTE NUDOMI S.A. DE C.V.	PARTIDA 1. ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR NUMERAL 2. ACCESORIOS PUNTO 2.1 EN APEGO A LOS PRINCIPIOS DE LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA, COMPETENCIA Y MEJOR COSTO-BENEFICIO PARA LA	EL LICITANTE PODRA OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES, NO OBSTANTE EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO. SE VERIFICARÁ LA	ÁREA TÉCNICA



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			INSTITUCIÓN, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR EL REQUERIMIENTO RELATIVO A UN "INYECTOR DUAL DE MEDIO DE CONTRASTE DE ALTA PRESIÓN", TODA VEZ QUE, PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE HEMODINAMIA Y ANGIOGRAFÍA CON ARCO MONOPLANAR, LA ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO DE CONTRASTE SE EFECTÚA DE MANERA CONTROLADA Y PROGRAMADA, POR LO QUE LA UTILIZACIÓN DE UN SISTEMA DE DOBLE CABEZAL NO CONSTITUYE UNA CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LLEVAR A CABO DICHOS ESTUDIOS NI PARA GARANTIZAR SU ADECUADO DESEMPEÑO CLÍNICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA DE OFERTAR UN INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE DE ALTA PRESIÓN DE UN SOLO CABEZAL (MONOCABEZAL), EN SUSTITUCIÓN DEL INYECTOR DUAL, SIEMPRE QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, DE SEGURIDAD, PRESIÓN, FLUJO, SINCRONIZACIÓN Y REGISTRO SANITARIO SOLICITADAS?	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE, LA CUAL DEBERÁ SER LEGIBLE, AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS.	
90	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA 106 DEL LICITANTE NUDOMI S.A. DE C.V.	PARTIDA 5 UNIDAD RADIOGRÁFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE DIGITAL PUNTO 1.4.5 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR LA RESPUESTA Y PERMITIR ACREDITAR EL REQUERIMIENTO MEDIANTE LA TECNOLOGÍA INCORPORADA EN NUESTRO SISTEMA, EL CUAL CUENTA CON FRENOS ELECTROMAGNÉTICOS TRANSVERSOS PARA MOVIMIENTOS EN PARTES DEL SISTEMA. ESTA ARQUITECTURA PROPORCIONA UN POSICIONAMIENTO PRECISO, SEGURO Y CONTROLADO DE LOS DIFERENTES	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			COMPONENTES MÓVILES DEL EQUIPO, CUMPLIENDO CON LA FINALIDAD DEL REQUERIMIENTO. ¿ES ACEPTABLE NUESTRA PROPUESTA?		
91	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA 110 DEL LICITANTE NUDOMI S.A. DE C.V.	PARTIDA 4 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 1.6 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR EL CUMPLIMIENTO CON MÁS DE 600 PROGRAMAS ANATÓMICOS RADIOGRÁFICOS PREPROGRAMABLES, CONSIDERANDO QUE ESTA CAPACIDAD PERMITE CONFIGURAR Y ALMACENAR UNA AMPLIA VARIEDAD DE PROTOCOLOS DE ACUERDO CON LA ANATOMÍA, PROYECCIÓN Y TÉCNICA RADIOGRÁFICA REQUERIDA, SIENDO SUFICIENTE PARA ATENDER LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y ESTUDIOS DE UN CENTRO DE ALTO VOLUMEN. ASIMISMO, EL NÚMERO DE PROGRAMAS PREPROGRAMABLES NO LIMITA LA CAPACIDAD CLÍNICA DEL SISTEMA, YA QUE LOS PROTOCOLOS PUEDEN CONFIGURARSE Y AJUSTARSE CONFORME A LAS NECESIDADES DE CADA ESTUDIO. ¿ES ACEPTABLE NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
92	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA 120 DEL LICITANTE NUDOMI S.A. DE C.V.	PARTIDA 1.ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 1.2.6 DETECTOR PLANO CON DIMENSIONES 30 X 30 CM (11" X 11") O MAYOR, CON AL MENOS TRES CAMPOS DE ENTRADA O ZOOM Y UNA MATRIZ DE 1024 X 1024 O MAYOR Y 14 BITS: SOLICITO AMABLENTE A LA CONVOCANTE RECONCIDERE QUE SOLICITAR UNA MATRIZ DE 1024 X 1024 O MAYOR Y DE AL MENOS 16 BITS, DEBIDO A QUE ESTE PROPORCIONA MAYORES ESCALA DE GRISES	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			MEJORANDO ASÍ LA CALIDAD DE IMAGEN, SE ENTIENDE QUE NO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO,¿SE ACEPTA?		
93	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA 123 DEL LICITANTE NUDOMI S.A. DE C.V.	PARTIDA 1.ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO. 1.2.1 ROTACIÓN CON PROYECCIÓN RAO EN GRADOS DE 110° O MAYOR CON VELOCIDAD DE 20°/S O MAYOR. SOLICITO AMABLENTE A LA CONVOCANTE RECONCIDERE QUE SOLICITAR COMO MÍNIMO 120° PARA UNA MEJOR ADQUISICIÓN ASI COMO MAYOR INFORMACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES, SE ENTIENDE QUE NO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
94	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA 124 DEL LICITANTE NUDOMI S.A. DE C.V.	PARTIDA 1.ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 1.2.2 ROTACIÓN CON PROYECCIÓN LAO EN GRADOS DE 105° O MAYOR CON VELOCIDAD DE 20°/S O MAYOR. SOLICITO AMABLENTE A LA CONVOCANTE RECONCIDERE QUE, SOLICITAR COMO MÍNIMO 120°CON UNA VELOCIDAD DE 25°/S PARA UNA MEJOR ADQUISICIÓN ASI COMO MAYOR INFORMACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES, SE ENTIENDE QUE NO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
95	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA 125 DEL LICITANTE NUDOMI S.A. DE C.V.	PARTIDA 1.ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO 1.5.1 CON LONGITUD DE AL MENOS 280 CM. SOLICITO AMABLENTE A LA CONVOCANTE RECONCIDERE QUE SOLICITAR COMO MÍNIMO 310 CM PARA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			FAVORECER AL ESPACIO DE MANIOBRA CON PACIENTE, SE ENTIENDE QUE NO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO, ¿SE ACEPTA?		
96	NUDOMI SA DE CV	SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, PREGUNTA 126 DEL LICITANTE NUDOMI S.A. DE C.V.	PARTIDA 1.ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR PUNTO. 1.5.5 CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO DEL PACIENTE DE 200 KG O MAYOR, MÁS PESO DE ACCESORIOS Y MANIOBRAS DE RCP. SOLICITO AMABLENTE A LA CONVOCANTE RECONCIDERE QUE SOLICITAR COMO MÍNIMO 250 KG DE SOPORTE DE PESO DEL PACIENTE PARA FAVORECER USO CON DIVERSOS PACIENTES ASÍ COMO TENER UN MAYOR RANGO DE CONSIDERACIÓN EN EL PESO DE LOS ACCESORIOS,SE ENTIENDE QUE NO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
97	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	PREGUNTA NO. 69, LICITANTE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV PARTIDA 4. UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO PUNTO 1.5. FLUOROSCOPIA CONTINUA Y PULSADA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA, YA QUE NUESTRO SISTEMA CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA, SIN EMBARGO DEBIDO A LA DIFICULTAD DE REFERENCIACIÓN TEXTUAL SOLICITAMOS NOS PERMITA DAR CUMPLIMIENTO MEDIANTE UNA CARTA DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
98	MEDIXSA SA DE CV	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA POR LA CONVOCANTE A LA PREGUNTA NO. 83 REALIZADA POR LA EMPRESA MEDISXA	PARTIDA 19 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO (MEDIANO CON CAPACIDAD ÚTIL DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA POR LA CONVOCANTE A LA PREGUNTA NO. 83 REALIZADA POR LA EMPRESA MEDISXA SA DE CV EN LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES.	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
		SA DE CV EN LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES.	PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA Y SE NOS PERMITA OFERTAR LA POSIBILIDAD DE EXPORTAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD A TRAVÉS DE UNA MEMORIA SD (MEMORIA SD INCLUIDA) INCLUYENDO UN ADAPTADOR SD A USB(ADAPTADOR INCLUIDO) , EL CUAL PUEDE SER UTILIZADO EN CUALQUIER EQUIPO DE CÓMPUTO QUE UTILICE PARA SU SISTEMA DE TRAZABILIDAD. ¿SE ACEPTA?		
99	MEDIXSA SA DE CV	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA POR LA CONVOCANTE A LA PREGUNTA NO. 83 REALIZADA POR LA EMPRESA MEDISXA SA DE CV EN LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES.	PARTIDA 19 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO (MEDIANO CON CAPACIDAD ÚTIL DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA POR LA CONVOCANTE A LA PREGUNTA NO. 83 REALIZADA POR LA EMPRESA MEDISXA SA DE CV EN LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES. PREGUNTA: EN CASO DE SER NEGATIVA LA ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA LA CAPACIDAD A FUTURO DE EXPORTAR LA INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD EN TIEMPO REAL DE LA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO A TRAVÉS DE UN PUERTO ETHERNET (EL SOFTWARE DE TRAZABILIDAD EN TIEMPO REAL NO ES PARTE DE LA OFERTA), ¿ES CORRECTO?.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
100	MEDIXSA SA DE CV	DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA POR LA CONVOCANTE A LA PREGUNTA NO. 85 REALIZADA POR LA EMPRESA MEDISXA SA DE CV EN LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES.	PARTIDA 32 DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA POR LA CONVOCANTE A LA PREGUNTA NO. 85 REALIZADA POR LA EMPRESA MEDISXA SA DE CV EN LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE SU RESPUESTA RESPECTO A LA POSIBILIDAD DE EXPORTAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD A TRAVÉS DE UNA MEMORIA SD INCLUYENDO UN	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			ADAPTADOR SD A USB, EL CUAL PUEDE SER UTILIZADO EN CUALQUIER EQUIPO DE CÓMPUTO QUE UTILICE PARA SU SISTEMA DE TRAZABILIDAD.		
101	RADAMES VARGAS ORTEGA	PREGUNTA NO. 1 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DEL PUNTO SOLICITADO 1.1.8.18 TENDENCIA DE ETCO2 DE LA PARTIDA 2 "POLISOMNOGRAFO" MI REPRESENTADA SOLICITA NOS PERMITA BRINDAR UN MONITOR DE CAPNOGRAFÍA INDEPENDIENTE Y DEDICADO ESPECÍFICAMENTE A LA MEDICIÓN Y MONITORIZACIÓN CONTINUA DE CO2, EL CUAL PERMITA LA VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL DE ETCO2, FRECUENCIA RESPIRATORIA DERIVADA DEL CO2 Y LA ONDA CAPNOGRÁFICA, ASÍ COMO EL ANÁLISIS DE SUS TENDENCIAS Y CAMBIOS EN EL PATRÓN VENTILATORIO. LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE DESDE EL PUNTO DE VISTA FISIOLÓGICO Y CLÍNICO, LA CAPNOGRAFÍA CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA PARA LA VALORACIÓN CONTINUA DE LA VENTILACIÓN, Y QUE LA FUNCIONALIDAD CLÍNICA REQUERIDA SE DETERMINA POR LA CAPACIDAD DEL SISTEMA PARA OBTENER, MOSTRAR Y MONITORIZAR DE FORMA CONTINUA EL ETCO2 Y LA ONDA CAPNOGRÁFICA, Y NO NECESARIAMENTE POR LA UBICACIÓN FÍSICA DEL MÓDULO DE MEDICIÓN DENTRO O FUERA DEL EQUIPO. EN ESTE SENTIDO, UNA SOLUCIÓN DEDICADA PERMITE MANTENER LA VIGILANCIA CONTINUA DE LA VENTILACIÓN Y LA IDENTIFICACIÓN OPORTUNA DE CAMBIOS COMPATIBLES CON APNEA, HIPOVENTILACIÓN, OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA, ALTERACIONES DEL PATRÓN RESPIRATORIO O EVENTOS RELACIONADOS CON EL CIRCUITO RESPIRATORIO, SIN MODIFICAR LA FINALIDAD CLÍNICA DEL	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			REQUERIMIENTO. ASIMISMO, ESTA ALTERNATIVA PERMITE DAR CUMPLIMIENTO A LA FINALIDAD DEL REQUERIMIENTO MEDIANTE UNA SOLUCIÓN ESPECÍFICAMENTE DISEÑADA PARA LA VISUALIZACIÓN Y TENDENCIA DE ETCO2 Y CAPNOGRAFÍA, SIN MENOSCABO DE LA SEGURIDAD, DESEMPEÑO, PRECISIÓN Y UTILIDAD CLÍNICA DEL EQUIPO SOLICITADO, FAVORECIENDO ADEMÁS LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?		
102	RADAMES VARGAS ORTEGA	NUMERO DE PREGUNTA NO. 2 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DEL PUNTO SOLICITADO 2.10 CABLE Y SENSOR PARA CAPNÓGRAFO TRANSCUTÁNEO COMPATIBLE CON POLISOMNÓGRAFO (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE). DE LA PARTIDA 2 "POLISOMNOGRAFO" EN VIRTUD DE QUE LA SOLICITUD PLANTEADA SE ENCUENTRA ORIENTADA A GARANTIZAR LA MEDICIÓN Y MONITORIZACIÓN DE CO2 DURANTE EL ESTUDIO DE POLISOMNOGRAFÍA, Y CONSIDERANDO QUE LA SOLUCIÓN PROPUESTA MEDIANTE TECNOLOGÍA SIDESTREAM PERMITE REALIZAR LA MEDICIÓN DE CO2 DE FORMA CONTINUA, OBTENIENDO LOS VALORES DE ETCO2 Y FICO2, ASÍ COMO LA REPRESENTACIÓN DE LA ONDA DE CAPNOGRAFÍA MI REPRESENTADA SOLICITA NOS PERMITA BRINDAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA FINALIDAD CLÍNICA DEL REQUERIMIENTO, PERMITIRÁ OFERTAR DICHA SOLUCIÓN MEDIANTE UN CAPNÓGRAFO ESPECIALIZADO E INDEPENDIENTE, UTILIZANDO KITS DESECHABLES SIDESTREAM CON CÁNULAS NASALES, SIEMPRE QUE EL SISTEMA PERMITA LA ADQUISICIÓN, VISUALIZACIÓN, REGISTRO Y CORRELACIÓN DE LOS	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			PARÁMETROS DE CO2 CON LAS DEMÁS SEÑALES FISIOLÓGICAS DEL ESTUDIO DE POLISOMNOGRAFÍA, SIN MENOSCABO DE LA CALIDAD, CONTINUIDAD Y TRAZABILIDAD DE LOS DATOS OBTENIDOS. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE LA TECNOLOGÍA SIDESTREAM CON CAPNOGRAFÍA ESPECÍFICAMENTE DISEÑADA PARA LA MONITORIZACIÓN DE CO2 PERMITE UNA EVALUACIÓN OBJETIVA Y CONTINUA DE LA VENTILACIÓN DEL PACIENTE, Y NO REPRESENTA UNA LIMITACIÓN FUNCIONAL RESPECTO DE LA FINALIDAD DEL REQUERIMIENTO, SINO UNA ALTERNATIVA TECNOLÓGICA EQUIVALENTE PARA LA OBTENCIÓN DEL PARÁMETRO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?		
103	RADAMES VARGAS ORTEGA	NUMERO DE PREGUNTA NO.7 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DEL PUNTO SOLICITADO 2.4 CABLE Y AL MENOS DOS SENSORES DE MOVIMIENTO OCULAR. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE). DE LA PARTIDA 2 "POLISOMNOGRAFO" TODA VEZ QUE EL REQUERIMIENTO ESTABLECE COMO FINALIDAD LA DETECCIÓN Y REGISTRO DE LOS MOVIMIENTOS OCULARES DURANTE EL ESTUDIO DE POLISOMNOGRAFÍA, Y NO SE ADVIERTE QUE LA FUNCIONALIDAD DEPENDA DE QUE EL CABLE Y LOS SENSORES DEBAN SER SUMINISTRADOS NECESARIAMENTE COMO COMPONENTES FÍSICAMENTE INDEPENDIENTES, MI REPRESENTADA SOLICITA NOS PERMITA BRINDAR UNA SOLUCIÓN PARA LA DETECCIÓN DE MOVIMIENTOS OCULARES CONSTITUIDA POR UN CABLE COMPLETO CON TRONCAL Y CONECTORES TIPO SNAP, COMPATIBLE CON ELECTRODOS DE ELECTROOCULOGRAFÍA QUE UTILICEN ESTE SISTEMA DE CONEXIÓN, SIEMPRE QUE LA CONFIGURACIÓN OFERTADA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			PERMITA REALIZAR LA ADQUISICIÓN, TRANSMISIÓN, REGISTRO Y VISUALIZACIÓN DE LAS SEÑALES DE MOVIMIENTO OCULAR REQUERIDAS, ASÍ COMO SU INTEGRACIÓN Y CORRELACIÓN CON EL RESTO DE LOS CANALES DEL ESTUDIO DE POLISOMNOGRAFÍA. (SIGUE...)		
104	RADAMES VARGAS ORTEGA	NUMERO DE PREGUNTA NO.7 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	(... CONTINUACION DE LA PREGUNTA ANTERIOR) LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE DESDE EL PUNTO DE VISTA FISIOLÓGICO Y FUNCIONAL, LA ELECTROOCULOGRAFÍA (EOG) DETECTA LOS MOVIMIENTOS OCULARES A PARTIR DE LAS VARIACIONES DEL POTENCIAL CORNEO-RETINIANO MEDIANTE ELECTRODOS COLOCADOS EN POSICIONES PRÓXIMAS A LOS CANTOS OCULARES, POR LO QUE LA FUNCIONALIDAD CLÍNICA REQUERIDA SE DETERMINA POR LA CAPACIDAD DEL SISTEMA PARA CAPTAR Y REGISTRAR ADECUADAMENTE DICHA SEÑAL, Y NO POR LA CONFIGURACIÓN FÍSICA ESPECÍFICA EN LA QUE SE PRESENTEN EL CABLE Y LOS ELECTRODOS. ASIMISMO, UNA SOLUCIÓN MEDIANTE CABLE TRONCAL CON CONECTORES TIPO SNAP PERMITE ESTABLECER UNA INTERFAZ ELÉCTRICA DIRECTA Y SEGURA CON ELECTRODOS COMPATIBLES, REDUCIENDO EL NÚMERO DE PUNTOS DE INTERCONEXIÓN Y, CON ELLO, POTENCIALES FUENTES DE DESCONEXIÓN, INTERMITENCIAS O ARTEFACTOS DURANTE EL REGISTRO DE SEÑALES BIOELÉCTRICAS DE BAJA AMPLITUD. POR LO ANTERIOR, SI LA SOLUCIÓN OFERTADA CUMPLE CON LA MISMA FINALIDAD FUNCIONAL, PERMITE EL REGISTRO DE LOS DOS CANALES DE MOVIMIENTO OCULAR REQUERIDOS Y ES TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			SISTEMA DE POLISOMNOGRAFÍA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE PODRÁ OFERTARSE DICHA CONFIGURACIÓN, AUN CUANDO LOS ELECTRODOS SEAN UN ELEMENTO CONSUMIBLE INDEPENDIENTE Y SE CONECTEN AL CABLE MEDIANTE CONECTORES TIPO SNAP, SIN QUE ESTO REPRESENTE INCUMPLIMIENTO DEL PUNTO 2.4. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?		
105	RADAMES VARGAS ORTEGA	NUMERO DE PREGUNTA NO.39 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DEL PUNTO 1.10.1. DE UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO. MI REPRESENTADA SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFERTAR ALTURA FIJA A 83 CM. LA SOLUCIÓN PROPUESTA SE ENCUENTRA DENTRO DEL INTERVALO DE ALTURA SEÑALADO COMO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE Y PERMITE MANTENER AL PACIENTE EN UNA POSICIÓN ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS RADIOGRÁFICOS Y FLUOROSCÓPICOS PARA LOS CUALES ESTÁ DESTINADA LA UNIDAD. EN ESTE SENTIDO, UNA MESA CON ALTURA FIJA DE 83 CM PUEDE CUMPLIR DICHAS FUNCIONES CUANDO LA GEOMETRÍA DEL SISTEMA, EL RECORRIDO DEL TUBO, EL DETECTOR, LA BASCULACIÓN Y LOS DEMÁS ELEMENTOS DE POSICIONAMIENTO HAN SIDO DISEÑADOS PARA OPERAR DE MANERA INTEGRADA A DICHA ALTURA. UNA CONFIGURACIÓN DE ALTURA FIJA PUEDE ELIMINAR MECANISMOS MÓVILES ADICIONALES Y PROPORCIONAR UNA POSICIÓN DE TRABAJO CONSTANTE, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD MECÁNICA DE LA MESA DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS, DE ACUERDO CON EL DISEÑO DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
106	RADAMES VARGAS ORTEGA	NUMERO DE PREGUNTA NO.40 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DEL PUNTO 1.6. DE UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO. MI REPRESENTADA SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFERTAR SELECCIÓN DE RADIOGRAFÍA PROGRAMADA ANATÓMICAMENTE O PROGRAMA DE ÓRGANOS, 768 TÉCNICAS ANATÓMICAS PROGRAMABLES (APR). LA SOLUCIÓN PROPUESTA DISPONE DE 768 TÉCNICAS ANATÓMICAS PROGRAMABLES, MEDIANTE LAS CUALES ES POSIBLE CONFIGURAR Y ALMACENAR LOS PARÁMETROS CORRESPONDIENTES A LOS DIFERENTES ESTUDIOS Y REGIONES ANATÓMICAS, PERMITIENDO AL OPERADOR SELECCIONAR PREVIAMENTE LAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS RADIOGRÁFICOS. EL NÚMERO DE PROGRAMAS ANATÓMICOS CONSTITUYE PRINCIPALMENTE UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y SELECCIÓN DE TÉCNICAS PRECONFIGURADAS. POR ELLO, CONSIDERAMOS QUE LA EQUIVALENCIA DEBE VALORARSE CONSIDERANDO QUÉ PARÁMETROS PUEDEN CONFIGURARSE, ALMACENARSE Y RECUPERARSE MEDIANTE CADA PROGRAMA, ASÍ COMO LA CAPACIDAD DEL SISTEMA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS REQUERIDOS, Y NO EXCLUSIVAMENTE POR EL NÚMERO NOMINAL DE POSICIONES DISPONIBLES. EN PARTICULAR, SI LAS 768 TÉCNICAS PROGRAMABLES PERMITEN CONFIGURAR LOS PARÁMETROS RADIOGRÁFICOS REQUERIDOS PARA LOS DIFERENTES ESTUDIOS Y REGIONES ANATÓMICAS, LA DIFERENCIA DE 32 POSICIONES NO LIMITA LA CAPACIDAD DEL EQUIPO PARA GENERAR LAS EXPOSICIONES NECESARIAS NI MODIFICA EL PRINCIPIO	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			DE OPERACIÓN DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?		
107	RADAMES VARGAS ORTEGA	NUMERO DE PREGUNTA NO.41 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DEL PUNTO 1.4.3. DE UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE. MI REPRESENTADA SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFERTAR DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE LA COLUMNA DE 185 CM CON FRENADO ELECTROMAGNÉTICO. DIFERENCIA MENOR AL 10% QUE NO AFECTA EL USO CORRECTO DEL EQUIPO. ADICIONALMENTE EL FRENADO FERROMAGNÉTICO PROPORCIONA UN MECANISMO DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA POSICIÓN DE LA COLUMNA, PERMITIENDO MANTENER EL POSICIONAMIENTO SELECCIONADO DE MANERA ESTABLE Y CONTROLADA DURANTE LA PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. LA FINALIDAD DEL DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE LA COLUMNA ES PROPORCIONAR AL OPERADOR LA POSIBILIDAD DE POSICIONAR ADECUADAMENTE EL TUBO DE RAYOS X RESPECTO DEL PACIENTE, MESA, RECEPTOR DE IMAGEN Y/O BUCKY MURAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES ESTUDIOS RADIOGRÁFICOS. EN ESTE SENTIDO, LA EQUIVALENCIA DE LA PROPUESTA CUMPLE CON LA FINALIDAD TÉCNICA. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
108	RADAMES VARGAS ORTEGA	NUMERO DE PREGUNTA NO. 57 DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION MEDICA, S.A. DE C.V.	DEL PUNTO 1.4.1.4 DE LÁMPARA OBSTETRICA (LED). MI REPRESENTADA SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR SELECCIONABLE ENTRE 3500 A 5000 KELVIN. RANGO USADO CUMUNMENTE	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			EN SALAS QUIRÚRGICAS. POR CORRESPONDER A UNA ILUMINACIÓN BLANCA NEUTRA A FRÍA ADECUADA PARA APLICACIONES CLÍNICAS, SIEMPRE QUE ADICIONALMENTE SE CUMPLAN LOS NIVELES DE ILUMINANCIA, REPRODUCCIÓN CROMÁTICA Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?		
109	RADAMES VARGAS ORTEGA	NUMERO DE PREGUNTA NO. 57 DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION MEDICA, S.A. DE C.V.	DEL PUNTO 2.1 DE LÁMPARA OBSTETRICA (LED). MI REPRESENTADA SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFERTAR ESTE NUMERAL CON LA CARACTERÍSTICA PROPIA O PROPUESTA DE CADA FABRICA. SIN AFECTAR EL USO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
110	RADAMES VARGAS ORTEGA	NUMERO DE PREGUNTA NO.16 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DEL PUNTO 1.2.10.2. DE CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. (CUATRO CAMAS). MI REPRESENTADA SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFERTAR CONEXIÓN EN RED POR VÍA ALÁMBRICA O VÍA ETHERNET. CONSIDERANDO QUE LA CONEXIÓN MEDIANTE RED ALÁMBRICA NO REPRESENTA UNA SOLUCIÓN DE CARACTERÍSTICAS INFERIORES NI IMPLICA UNA DISMINUCIÓN EN LA FUNCIONALIDAD, DESEMPEÑO O DISPONIBILIDAD DE LOS MONITORES, SINO ÚNICAMENTE UNA MODALIDAD DISTINTA DE COMUNICACIÓN DE DATOS. UNA CONEXIÓN ALÁMBRICA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA DE RED PUEDE PROPORCIONAR, ENTRE OTRAS CARACTERÍSTICAS, MAYOR ESTABILIDAD DE COMUNICACIÓN, MENOR SUSCEPTIBILIDAD A INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS O SATURACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, MAYOR PREDICTIBILIDAD EN LA TRANSMISIÓN	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			DE DATOS Y UNA CONEXIÓN FÍSICA DEDICADA, MANTENIENDO LA MISMA FINALIDAD DE INTERCONECTAR LOS MONITORES CON LA CENTRAL DE MONITOREO. ASIMISMO, SOLICITAMOS SE CONSIDERE PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE PROPUESTAS QUE, SIN MENOSCABAR LAS FUNCIONALIDADES, CAPACIDADES, SEGURIDAD, DISPONIBILIDAD Y DESEMPEÑO REQUERIDOS, UTILICEN CONEXIÓN ALÁMBRICA COMO MEDIO DE INTERCONEXIÓN DE LOS MONITORES. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?		
111	RADAMES VARGAS ORTEGA	NUMERO DE PREGUNTA NO.17 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DEL PUNTO 1.3.16 AL 1.3.16.3. DE CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. (CUATRO CAMAS). MI REPRESENTADA SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFERTAR UN MÓDULO DE BATERÍA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS 1 HORA CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO Y SISTEMA DE FIJACIÓN FÍSICA EN CADA MONITOR. EL OBJETIVO DE UNA BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON UNA DURACIÓN MÍNIMA DE UNA HORA ES GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE OPERACIÓN DEL MONITOR ANTE UNA INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO. BAJO ESTE SUPUESTO, CONSIDERAMOS QUE LA UBICACIÓN FÍSICA DE LA BATERÍA INTERNA O EXTERNA, NO CONSTITUYE POR SÍ MISMA UNA DIFERENCIA DE DESEMPEÑO, SIEMPRE QUE LA SOLUCIÓN OFERTADA GARANTICE COMO MÍNIMO LA AUTONOMÍA, DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD DE OPERACIÓN REQUERIDAS. UNA SOLUCIÓN MEDIANTE UN MÓDULO DE BATERÍA EXTERNO DEDICADO PUEDE PROPORCIONAR LA ENERGÍA DE RESPALDO NECESARIA PARA MANTENER	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			EL MONITOR EN OPERACIÓN DURANTE AL MENOS UNA HORA, ADEMÁS DE PERMITIR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS SISTEMAS DE RESPALDO ELÉCTRICO, TALES COMO REGULACIÓN/PROTECCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ANTE UNA INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?		
112	RADAMES VARGAS ORTEGA	NUMERO DE PREGUNTA NO.21 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DEL PUNTO 2.1.2. DE CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. (CUATRO CAMAS). MI REPRESENTADA SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE ACLARE SI DEBEN DE OFERTARSE CUATRO (4) CABLES Y SENSORES REUSABLES LIBRE DE LÁTEX PARA PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO PARA EL TOTAL DE MONITORES QUE INTEGRAN LA CENTRAL DE MONITOREO Y SI DEBERÁ DE ESPECIFICARSE LA CANTIDAD EN LA PROPUESTA.	SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE SU PROPUESTA DEBE ESPECIFICAR LA CANTIDAD OFERTADA, CONFORME LO SIGUIENTE: 2.1.2 CUATRO CABLES Y CUATRO SENSORES SUAVES REUSABLES LIBRES DE LÁTEX, PARA PACIENTE ADULTO/PEDIATRICO, COMPATIBLES CON LA TECNOLOGÍA OFERTADA, QUE PERMITA LA MEDICIÓN DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO EN PACIENTES EN MOVIMIENTO Y BAJOS NIVELES DE PERFUSIÓN. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE).	ÁREA TÉCNICA
113	RADAMES VARGAS ORTEGA	NUMERO DE PREGUNTA NO.21 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DEL PUNTO 2.1.2. DE CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. (CUATRO CAMAS). MI REPRESENTADA SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFERTAR CABLE Y SENSOR DEDAL REUSABLE LIBRE DE LÁTEX, CUATRO PARA PACIENTE ADULTO Y CUATRO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, EN CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, COMPATIBLE CON LA TECNOLOGÍA OFERTADA, QUE PERMITA LA MEDICIÓN DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO EN PACIENTES EN MOVIMIENTO Y BAJOS NIVELES DE PERFUSIÓN. CONSIDERAMOS IMPORTANTE PRECISAR QUE, DESDE EL PUNTO DE VISTA FUNCIONAL, EL PROPÓSITO DEL SENSOR DE SPO2 ES PERMITIR LA MEDICIÓN NO INVASIVA DE	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			LA SATURACIÓN DE OXÍGENO Y FRECUENCIA DE PULSO EN EL PACIENTE, POR LO QUE LA CARACTERÍSTICA "SUAVE" CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A UNA CARACTERÍSTICA CONSTRUCTIVA O DE CONTACTO DEL SENSOR, Y NO NECESARIAMENTE DETERMINA POR SÍ MISMA SU CAPACIDAD DE MEDICIÓN, PRECISIÓN, COMPATIBILIDAD O DESEMPEÑO CLÍNICO. EL SENSOR TIPO DEDAL PROPUESTO CONSTITUYE UNA ALTERNATIVA DE TECNOLOGÍA DE CONTACTO PARA SPO2 Y, UNO PARA PACIENTE ADULTO Y UNO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, PUEDE PROPORCIONAR LA FUNCIONALIDAD DE MONITORIZACIÓN DE SPO2 REQUERIDA, SIN MODIFICAR EL PRINCIPIO DE MEDICIÓN NI LAS VARIABLES FISIOLÓGICAS QUE SERÁN MONITORIZADAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?		
114	RADAMES VARGAS ORTEGA	NUMERO DE PREGUNTA NO.25 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DEL PUNTO 1.3.16 AL 1.3.16.3. DE CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. (OCHO CAMAS). MI REPRESENTADA SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFERTAR UN MÓDULO DE BATERÍA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS 1 HORA CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO Y SISTEMA DE FIJACIÓN FÍSICA EN CADA MONITOR. EL OBJETIVO DE UNA BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON UNA DURACIÓN MÍNIMA DE UNA HORA ES GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE OPERACIÓN DEL MONITOR ANTE UNA INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO. BAJO ESTE SUPUESTO, CONSIDERAMOS QUE LA UBICACIÓN FÍSICA DE LA BATERÍA INTERNA O EXTERNA, NO CONSTITUYE POR SÍ MISMA UNA DIFERENCIA DE DESEMPEÑO, SIEMPRE QUE LA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			SOLUCIÓN OFERTADA GARANTICE COMO MÍNIMO LA AUTONOMÍA, DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD DE OPERACIÓN REQUERIDAS. UNA SOLUCIÓN MEDIANTE UN MÓDULO DE BATERÍA EXTERNO DEDICADO PUEDE PROPORCIONAR LA ENERGÍA DE RESPALDO NECESARIA PARA MANTENER EL MONITOR EN OPERACIÓN DURANTE AL MENOS UNA HORA, ADEMÁS DE PERMITIR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS SISTEMAS DE RESPALDO ELÉCTRICO, TALES COMO REGULACIÓN/PROTECCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ANTE UNA INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?		
115	RADAMES VARGAS ORTEGA	NUMERO DE PREGUNTA NO.29 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DEL PUNTO 2.1.2. DE CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. (OCHO CAMAS). MI REPRESENTADA SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFERTAR CABLE Y SENSOR DEDAL REUSABLE LIBRE DE LÁTEX, OCHO PARA PACIENTE ADULTO Y OCHO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, EN CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, COMPATIBLE CON LA TECNOLOGÍA OFERTADA, QUE PERMITA LA MEDICIÓN DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO EN PACIENTES EN MOVIMIENTO Y BAJOS NIVELES DE PERFUSIÓN. CONSIDERAMOS IMPORTANTE PRECISAR QUE, DESDE EL PUNTO DE VISTA FUNCIONAL, EL PROPÓSITO DEL SENSOR DE SPO2 ES PERMITIR LA MEDICIÓN NO INVASIVA DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO Y FRECUENCIA DE PULSO EN EL PACIENTE, POR LO QUE LA CARACTERÍSTICA "SUAVE" CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A UNA CARACTERÍSTICA CONSTRUCTIVA O DE CONTACTO DEL SENSOR, Y NO NECESARIAMENTE DETERMINA POR SÍ	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			MISMA SU CAPACIDAD DE MEDICIÓN, PRECISIÓN, COMPATIBILIDAD O DESEMPEÑO CLÍNICO. EL SENSOR TIPO DEDAL PROPUESTO CONSTITUYE UNA ALTERNATIVA DE TECNOLOGÍA DE CONTACTO PARA SPO2 Y, UNO PARA PACIENTE ADULTO Y UNO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, PUEDE PROPORCIONAR LA FUNCIONALIDAD DE MONITORIZACIÓN DE SPO2 REQUERIDA, SIN MODIFICAR EL PRINCIPIO DE MEDICIÓN NI LAS VARIABLES FISIOLÓGICAS QUE SERÁN MONITORIZADAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?		
116	RADAMES VARGAS ORTEGA	NUMERO DE PREGUNTA NO.77 DE MEDIXSA, S.A. DE C.V.	DEL PUNTO 1.15.6 DE LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED. MI REPRESENTADA SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFERTAR ESTE NUMERAL CON LA CARACTERÍSTICA PROPIA O PROPUESTA DE CADA FABRICA. SIN AFECTAR EL USO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
117	RADAMES VARGAS ORTEGA	NUMERO DE PREGUNTA NO.48 DE INFRAESTRUCTURA Y PLENEACIÓN MEDICA, S.A. DE C.V.	DEL PUNTO 1.4 DE LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED. MI REPRESENTADA SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFERTAR AJUSTE DE ALTURA DE +/-45°C, CON GIRO DE LA CÚPULA EN 360°. ESTA CONFIGURACIÓN PROPORCIONA UN AMPLIO RANGO DE MOVILIDAD Y ORIENTACIÓN DE LA CÚPULA, PERMITIENDO AL USUARIO POSICIONAR Y ORIENTAR EL CAMPO LUMINOSO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO. LA DIFERENCIA RESPECTO DEL RANGO SOLICITADO DE 45° A -50° CORRESPONDE ÚNICAMENTE A 5° ADICIONALES EN UNO DE LOS EXTREMOS DEL RECORRIDO ANGULAR, SIN QUE DICHA DIFERENCIA IMPLIQUE NECESARIAMENTE UNA DISMINUCIÓN DE	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			LA CAPACIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA, PARTICULARMENTE CONSIDERANDO QUE LA CÚPULA DISPONE ADICIONALMENTE DE UN GIRO DE 360° SOBRE SU EJE. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?		
118	RADAMES VARGAS ORTEGA	NUMERO DE PREGUNTA NO.33 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DEL PUNTO 1.3.16 AL 1.3.16.3. DE CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. (NEONATAL CUATRO CAMAS). MI REPRESENTADA SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFERTAR UN MÓDULO DE BATERÍA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS 1 HORA CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO Y SISTEMA DE FIJACIÓN FÍSICA EN CADA MONITOR. EL OBJETIVO DE UNA BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON UNA DURACIÓN MÍNIMA DE UNA HORA ES GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE OPERACIÓN DEL MONITOR ANTE UNA INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO. BAJO ESTE SUPUESTO, CONSIDERAMOS QUE LA UBICACIÓN FÍSICA DE LA BATERÍA INTERNA O EXTERNA, NO CONSTITUYE POR SÍ MISMA UNA DIFERENCIA DE DESEMPEÑO, SIEMPRE QUE LA SOLUCIÓN OFERTADA GARANTICE COMO MÍNIMO LA AUTONOMÍA, DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD DE OPERACIÓN REQUERIDAS. UNA SOLUCIÓN MEDIANTE UN MÓDULO DE BATERÍA EXTERNO DEDICADO PUEDE PROPORCIONAR LA ENERGÍA DE RESPALDO NECESARIA PARA MANTENER EL MONITOR EN OPERACIÓN DURANTE AL MENOS UNA HORA, ADEMÁS DE PERMITIR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS SISTEMAS DE RESPALDO ELÉCTRICO, TALES COMO REGULACIÓN/PROTECCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ANTE UNA INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
119	RADAMES VARGAS ORTEGA	NUMERO DE PREGUNTA NO.37 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DEL PUNTO 2.1.2. DE CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. (NEONATAL CUATRO CAMAS). MI REPRESENTADA SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFERTAR CABLE Y SENSOR MULTISITIO REUSABLE CON ENVOLTURA DE FIJACIÓN CUATRO (4) PARA PACIENTE NEONATAL. LA ALTERNATIVA PROPUESTA MANTIENE LOS ELEMENTOS FUNCIONALES ESENCIALES DEL REQUERIMIENTO, AL TRATARSE DE UN SENSOR REUSABLE DESTINADO A LA MONITORIZACIÓN DE SPO2 EN PACIENTE NEONATAL, INTEGRADO POR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN Y FIJACIÓN MEDIANTE ENVOLTURA, EN UNA CONFIGURACIÓN DE CUATRO PIEZAS. LA CARACTERÍSTICA DE SER UN SENSOR MULTISITIO SE REFIERE A SU POSIBILIDAD DE UTILIZARSE EN DISTINTOS SITIOS ANATÓMICOS DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE Y NO IMPLICA, POR SÍ MISMA, UNA DISMINUCIÓN EN LA CAPACIDAD DE REALIZAR LA MEDICIÓN DE SPO2 EN PACIENTES NEONATALES. POR EL CONTRARIO, ESTA CARACTERÍSTICA PUEDE PROPORCIONAR FLEXIBILIDAD EN LA SELECCIÓN DEL SITIO DE MEDICIÓN, SIEMPRE QUE SE UTILICE CONFORME A LAS INDICACIONES, COMPATIBILIDAD Y CONDICIONES DE USO ESTABLECIDAS POR EL FABRICANTE. ASIMISMO, LA SOLUCIÓN PROPUESTA CONSERVA EL CONCEPTO DE FIJACIÓN MEDIANTE ENVOLTURA, POR LO QUE EL SENSOR PUEDE MANTENERSE COLOCADO SOBRE EL SITIO DE MEDICIÓN DURANTE LA MONITORIZACIÓN, SIN QUE LA CONFIGURACIÓN MULTISITIO MODIFIQUE LA FINALIDAD DEL	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA



2026 año de Margarita Maza

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			ACCESORIO NI LAS VARIABLES FISIOLÓGICAS QUE SERÁN MONITORIZADAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?		
120	RADAMES VARGAS ORTEGA	NUMERO DE PREGUNTA NO.38 DE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	DEL PUNTO 2.3.1 Y 2.3.2. DE CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. (NEONATAL CUATRO CAMAS). MI REPRESENTADA SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFERTAR TREINTA (30) BRAZALETES DESECHABLES NEONATALES POR CADA BRAZALETE REUSABLE REQUERIDO. NUESTRA PROPUESTA CONSISTE EN SUMINISTRAR 30 BRAZALETES NEONATALES DESECHABLES POR CADA UNIDAD REUSABLE SOLICITADA, DE MANERA QUE SE PROPORCIONE UNA CANTIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR EN TÉRMINOS DE DISPONIBILIDAD DE USO DURANTE LA VIDA OPERATIVA DEL EQUIPO. LA ALTERNATIVA DESECHABLE PROPUESTA PRESENTA ADEMÁS CARACTERÍSTICAS PROPIAS QUE PUEDEN RESULTAR FAVORABLES EN EL ENTORNO NEONATAL, EVITANDO LOS PROCESOS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y REUTILIZACIÓN DEL ACCESORIO, ASÍ COMO EL POSIBLE DETERIORO DEL MATERIAL DERIVADO DE CICLOS REPETIDOS DE USO. LA PROPUESTA NO PRETENDE MODIFICAR LA FUNCIONALIDAD DEL MONITOR NI LA FINALIDAD DEL BRAZALETE, SINO PROPORCIONAR UNA ALTERNATIVA DE SUMINISTRO QUE GARANTICE LA DISPONIBILIDAD PERMANENTE DE BRAZALETES ADECUADOS PARA PACIENTE NEONATAL, MEDIANTE UNA CANTIDAD DE UNIDADES DESECHABLES SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR A LA CANTIDAD DE UNIDADES REUTILIZABLES ORIGINALMENTE SOLICITADA. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
121	ESCALA BIOMEDICA SA DE CV	PREGUNTA NO. 201 DEL LICITANTE ESCALA BIOMÉDICA SA DE CV	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR LAS ADECUACIONES DE OBRA CIVIL QUE TENDRÁ QUE CUBRIR EL LICITANTE ADJUDICADO Y CUÁLES LE CORRESPONDERÁN A LA CONVOCANTE PARA LAS PARTIDAS 1, 4 Y 5.	NO ES NEGATIVA LA RESPUESTA, FAVOR DE REMITIRSE A LO ESTIPULADO EN ACTA DE 2DA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026, TRANSMITIDA EN PLATAFORMA, EN SU ANEXO III MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
122	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	JUNTA DE ACLARACIONES 2 PREGUNTA NO.192 DEL LICITANTE ESCALA BIOMEDICA SA DE CV	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA ASEGURAR LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NOS INDIQUE LAS ESPECIFICACIONES DEL ÁREA ASÍ COMO INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD RADIOGRÁFICA 500 MA Y UNIDAD FLUROSCÓPICA CON TELEMANDO. FAVOR DE PRONUCNIARSE AL RESPECTO.	FAVOR DE REMITIRSE A LO ESTIPULADO EN ACTA DE 2DA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026, TRANSMITIDA EN PLATAFORMA, EN SU ANEXO III MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
123	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	JUNTA DE ACLARACIONES 2 PREGUNTA NO.145 DEL LICITANTE NUDOMI SA DE CV	CONSIDERANDO QUE LA CONFIGURACIÓN DUAL CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A UNA CARACTERÍSTICA DE DISEÑO Y OPERACIÓN DEL EQUIPO, Y NO NECESARIAMENTE A UNA CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA OBTENER UNA ADECUADA OPACIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ANATÓMICAS, REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS FLUOROSCÓPICOS CONTEMPLADOS Y MANTENER LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, SIEMPRE QUE EL INYECTOR PERMITA ADMINISTRAR EL MEDIO DE CONTRASTE DE MANERA CONTROLADA Y REPRODUCIBLE CONFORME A LOS PROTOCOLOS CLÍNICOS ESTABLECIDOS. ASIMISMO, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE FUNCIONALIDAD CLÍNICA Y DESEMPEÑO, LA CAPACIDAD DE DISPONER DE UNO O DOS SISTEMAS DE INYECCIÓN NO DETERMINA POR SÍ MISMA LA CALIDAD O	EL LICITANTE PODRA OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES, NO OBSTANTE EL LICITANTE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO. SE VERIFICARÁ LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE, LA CUAL DEBERÁ SER LEGIBLE, AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS.	ÁREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
			SEGURIDAD DEL PROCEDIMIENTO, SIENDO CLÍNICAMENTE RELEVANTES LA PRECISIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN, LA PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE INYECCIÓN, EL CONTROL DE PRESIÓN Y FLUJO, ASÍ COMO LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD DEL EQUIPO. SOLICITAMOS A LACONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN INYECTOR SIN CONFIGURACIÓN DUAL, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA TOTALIDAD DE LAS FUNCIONES CLÍNICAS, PARÁMETROS DE PRECISIÓN, CONTROL, PROGRAMACIÓN Y SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE FLUOROSCOPIA ¿SE ACEPTA?		
124	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	JUNTA DE ACLARACIONES 2 PREGUNTA NO.41 DEL LICITANTE INNOVACION MEDICA Y TECNOLOGIAS PARA LA SALUD MX SA DE CV	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE ±10% RESPECTO DE LA MEDIDA SOLICITADA, CONSIDERANDO QUE EL DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DEL EQUIPO CUBRE ADECUADAMENTE LA MEDIA DE LA POBLACIÓN Y PERMITE ATENDER DE MANERA EFECTIVA LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS, SIN AFECTAR LA FUNCIONALIDAD NI EL DESEMPEÑO REQUERIDO. ¿ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	ÁREA TÉCNICA
125	PRODUCTOS STANTON SA DE CV	JUNTA DE ACLARACIONES 2 PREGUNTA NO.112 DEL LICITANTE NUDOMI SA DE CV	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE ±10% RESPECTO DE LA MEDIDA SOLICITADA, CONSIDERANDO QUE EL DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DEL EQUIPO CUBRE ADECUADAMENTE LA MEDIA DE LA POBLACIÓN Y PERMITE ATENDER DE MANERA EFECTIVA LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS, SIN AFECTAR LA FUNCIONALIDAD NI EL DESEMPEÑO REQUERIDO. ¿ACEPTA?	NO SE DA RESPUESTA, TODA VEZ QUE NO EXISTE RELACIÓN ENTRE LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NUMERO 112 Y EL NUEVO CUESTIONAMIENTO.	ÁREA TÉCNICA
126	PRODUCTOS	JUNTA DE	ENTENDEMOS QUE AL TENER UN	NO SE DA RESPUESTA, TODA VEZ QUE NO	ÁREA TÉCNICA

ANEXO II
RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX:
LA-50-GYR-050GYR003-T-130-2026

"EQUIPO ASOCIADO A OBRA - EQUIPAMIENTO MÉDICO (CON INSTALACIÓN) PARA EL EJERCICIO 2026"

NO.	LICITANTE	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA	ÁREA RESPONSABLE DE EMITIR LA RESPUESTA
	STANTON SA DE CV	ACLARACIONES 2 PREGUNTA NO.112 DEL LICITANTE NUDOMI SA DE CV	TABLERO DE MESA DE 2400X800 MM SE DA CUMPLIENTO A ESTE PUNTO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EXISTE RELACIÓN ENTRE LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NUMERO 112 Y EL NUEVO CUESTIONAMIENTO.	