



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA.

No. LA-050GYR006-E359-2022

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE; IMAGENOLÓGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.

En la Ciudad de Puebla, Pue siendo **las 16:00 horas, del día 28 de Septiembre del 2022**, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en calle 5 de Febrero Oriente No. 107, Col. San Felipe Hueyotlipan C.P. 72030, Puebla, Pue se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la contestación a las repreguntas presentadas a la Junta de aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación Pública indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 46 del Reglamento de la Ley.

Este acto es presidido por la **CP Diliam Montaña Hernández, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**, servidor público designado por la convocante, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con fundamento en el artículo 47 segundo párrafo del Reglamento de la Ley y con fundamento en el punto 5.3.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, quien hace constar que se presentaron solicitudes de aclaración sobre las respuestas otorgadas por el Instituto en la Junta de Aclaraciones, dentro del término concedido en el Acta de Junta de Aclaraciones de fecha **27 de Septiembre del 2022**, a través de CompraNet, de los siguientes licitantes:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS	No. De HOJAS
1	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ELECTRONICA	21 (VEINTIUNO)	4 (CUATRO)
2	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	ELECTRONICA	6 (SEIS)	4 (CUATRO)
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	ELECTRONICA	7 (SIETE)	4 (CUATRO)





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA.

No. LA-050GYR006-E359-2022

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE; IMAGENOLOGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS	No. De HOJAS
4	ANDERS BAUPRE SA DE CV	ELECTRONICA	2 (DOS)	2 (DOS)
5	VIASIS OTE SA DE CV	ELECTRONICA	1 (UNO)	1 (UNO)
6	SERVICIOS BIOMÉDICOS BAZAFI, SA DE CV	ELECTRONICA	1 (UNO)	2 (DOS)
7	CARL ZEISS DE MÉXICO SA DE CV	ELECTRONICA	7 (SIETE)	3 (TRES)
8	CYBER ROBOTIC SOLUTIONS SA DE CV	ELECTRONICA	2 (DOS)	3 (TRES)
TOTAL			47	23

El Presidente del acto, fue asistido por el Ing. Alberto Agustin Candia Villalobos.- Ing. Biomédico Delegacional quien respondió las preguntas de carácter técnico.

Se adjunta copia de la pantalla de Compranet constatándose que se recibieron Ocho solicitudes de aclaración sobre las respuestas otorgadas por el Instituto en la Junta de Aclaraciones, por parte de los licitantes por este medio de las empresas mencionadas con anterioridad.



2022 Flores
Año de Magón
HURECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

(Handwritten blue marks: a curved line at the top, a long vertical line, and an 'X' at the bottom)



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA.
No. LA-050GYR006-E359-2022**

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE; IMAGENOLOGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.

Procedimiento: 1112881 - LA-050GYR006-E359-2022 ADQ. MOB. Y EQUIP. MED. PARA HGZ 5 METEPEC

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1 DHB BIOMED CONSULTANT GROUP SA DE CV	27/09/2022 09:28 p.m.	REPREGUNTAS			
2 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS	27/09/2022 08:31 p.m.	Repreguntas Siemens			
3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV	27/09/2022 08:30 p.m.	Re-preguntas procedimiento LA-050GYR006-E359-2022			
4 ANDERS BAUPRE SA DE CV	27/09/2022 06:37 p.m.	Preguntas de Respuestas LPI LA-050GYR006-E359-2022			
5 VIASIS OTE SA DE CV	27/09/2022 06:16 p.m.	Repreguntas a las respuestas de la JA			
6 SERVICIOS BIOMEDICOS BAZAFI SA DE CV	27/09/2022 06:05 p.m.	REPREGUNTA			
7 CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	27/09/2022 06:04 p.m.	ANEXO 15 Y ACREDITACIÓN E359			
9 CYBER ROBOTIC SOLUTIONS SA DE CV	27/09/2022 05:46 p.m.	repreguntas			



Handwritten blue marks on the right side of the page, including a curved line at the top and a large 'X' at the bottom.



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA.

No. LA-050GYR006-E359-2022

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE; IMAGENOLOGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.

A continuación se detalla que se deberán tomar en cuenta las siguientes **Consideraciones Generales** a la convocatoria de la Licitación Pública, en apego al Artículo 33 de la Ley, que a la letra dice:

"Cualquier modificación a la Convocatoria de la Licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la Convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición."

**No existen Consideraciones Generales a las bases de la convocatoria de la Licitación Pública con Carácter Internacional Bajo la Cobertura de Tratados
No. LA-050GYR006-E359-2022**

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas como se indica a continuación:

Preguntas efectuadas por: **DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.**

NÚM	Preguntas	Respuestas
1	Pregunta 7, Página 13 Considerando que el término Bidimensional es equivalente al término 2D y que la cadencia o frecuencia puede ser en cuadros por segundo o Hertz (Hz), solicitamos se reconsidere su respuesta debido a que lo solicitado es solo para cuestiones de referenciación nos permita ofertar como 2D: 6667 Hz, que representa una mejor cadencia de adquisición a lo solicitado. ¿Se acepta?	No se acepta su propuesta, para el numeral 1.4.1 de la Cédula de Descripción del Artículo correspondiente a la partida 63 PREI 16417, podrá ofertar Bidimensional con modo M simultáneo con 6667 Hz, sin ser obligatorio para los demás participantes.





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA.

No. LA-050GYR006-E359-2022

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE; IMAGENOLOGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.

NÚM	Preguntas	Respuestas
2	Pregunta 10, página 14 Solicitamos se reconsidere la amplitud de vision del transductor intracavitario, lo cual representa un beneficio clinico en la exploración al contar conun campo de visión de al menos 200° ¿Se acepta?	No se acepta su propuesta, para el numeral 1.33.4 de la Cédula de Descripción del Artículo correspondiente a la partida 63 PREI 16417 podrá ofertar transductor intracavitario con el rango de 4Mhz o menor a 9Mhz o mayor, con campo de visión de 200° o mayor, con frecuencias armónicas, incluir guía de biopsia reusable (incluir número de parte o modelo). Lo anterior, sin ser obligatorio para los demás participantes.
3	Pregunta 32, página 24 Solicitamos se recosidera su respuesta en el sentido que el movimeinto total de giro es de 80l, sin embargo por motivo de referenciación, se muestra como 40° en cada lado, siendo en total 80°. ¿Se acepta?	Se acepta su propuesta de referenciar, sin ser obligatorio para los demás participantes.
4	Pregunta 1 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOTTICS S DE RL DE CV PP.- 69. La convocante aclara que es un equipo de nueva adquisición, en el sentido de equipo nuevo: La convocante solicita una unidad de "TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES" sin embargo en la cédula 17035 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES" no si incluye ninguna "CAMILLA DE TRASLADO" lac ual en indispensable se a solicitud junto con la unidad de tomografía, ya que esta reúne las características espeeificas para traladar al paciente a la unicac de tomografía y retirarlo de la misma, so solicita a la convocante considere anexar a la cédua como un accesorios una "CAMILLA DE TRASLADO" ¿Se acepta nuestra propuesta?	Se acepta su propuesta, podrá incluir en su propuesta una camilla de traslado, sin ser obligatorio para los demás participantes.



(Handwritten blue ink marks and a large 'X' on the right margin)



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA.
No. LA-050GYR006-E359-2022**

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE; IMAGENOLOGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.

NÚM	Preguntas	Respuestas
5	1.5 Ventilador microprocesado interconstruido o integrado de la misma marca que la maquina de anestesia. PREGUNTA: se entiende que debe ofertarse un ventilador microprocesado, interconstruido o integrado de la misma marca que la maquina de anestesia que asegure el funcionamiento continuo de la ventilacion durante situaciones de emergencia como ausencia de gases o de corriente electrica ¿Es correcta la apreciación?	La pregunta no versa sobre alguna respuesta dada por la convocante en la junta de aclaraciones, por lo que no se da respuesta de acuerdo al Art. 46 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6	Partida 27. Ventilador neonatal para cuidados intensivos. Punto 1.4.6. Ventilación en dos niveles de presión para el modo de ventilación No Invasiva (VNI). Pregunta: Entendemos que la terapia de alto flujo de oxígeno se considera dentro de la modalidad de ventilación no invasiva, por lo que el equipo ofertado deberá contar con esta tecnología. ¿Es correcto?	La pregunta no versa sobre alguna respuesta dada por la convocante en la junta de aclaraciones, por lo que no se da respuesta de acuerdo al Art. 46 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
7	Partida 27. Ventilador neonatal para cuidados intensivos. Punto 1.4.8. Ventilación controlada por presión en neonatos, ciclada por tiempo y limitada en presión o TCPLV. Pregunta: Debido a que en pacientes neonatales es necesario controlar siempre el limite de presión y garantizar el volumen para evitar daños pulmonares, el equipo ofertado deberá contar con principio de funcionamiento ciclado por tiempo y limitado en presión que aplique para todos sus modos ventilatorios, con el fin de garantizar la protección pulmonar. ¿Es correcto?	La pregunta no versa sobre alguna respuesta dada por la convocante en la junta de aclaraciones, por lo que no se da respuesta de acuerdo al Art. 46 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
8	Partida 27. Ventilador neonatal para cuidados intensivos. Punto 1.5.16. Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias de al menos 24 horas.	La pregunta no versa sobre alguna respuesta dada por la convocante en la junta de aclaraciones, por lo que no se da respuesta de acuerdo al Art. 46 fracción IV del Reglamento de



(Handwritten blue marks: a large vertical bracket on the right side of the table, and a large 'X' mark at the bottom right of the page.)



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA.

No. LA-050GYR006-E359-2022

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE; IMAGENOLÓGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.

NÚM	Preguntas	Respuestas
	Pregunta: Para obtener información más confiable, fidedigna y que muestre la evolución real del neonato, el equipo a ofertar deberá contar con almacenamiento de tendencias de al menos 31 días. Esto para que el personal clínico pueda ver el panorama real de la evolución de la terapia ventilatoria y puedan tomar decisiones adecuadas para el tratamiento, ya que cada día el bebé crece, gana peso y con ello los parámetros deben ajustarse para poder apoyar a su crecimiento ¿Es correcto?	la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
9	PREGUNTA NO.13 - REPREGUNTA Conforme a la respuesta otorgada por la Convocante a la pregunta número 16 del licitante DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V., solicitamos a la Convocante reconsiderar su respuesta, Dado que durante la estancia del paciente en la Terapia de Cuidados Intensivos Neonatales, el seguimiento de las tendencias de ventilación del paciente deben compararse durante toda su estancia junto con el peso del paciente y el resto de parámetros monitorizados y valores de laboratorio para asegurar que el tratamiento es el adecuado para el bebé, por lo que entendemos que el ventilador deberá contar con tendencias gráficas y numéricas de al menos 30 días. ¿Es correcto?	La pregunta no va relacionada a la respuesta a la pregunta 16 del licitante DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A DE C.V. dada por la convocante en la junta de aclaraciones, por lo que no se da respuesta de acuerdo al Art. 46 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
10	Punto 1.7.3. Sensor de flujo proximal o equivalente, de acuerdo a la tecnología del fabricante. Pregunta: El volumen corriente que debe considerarse para un neonato, sobretodo un prematuro, es extremadamente pequeño, llegando a casos de 2 ml para los pacientes más pequeños. Con el fin de obtener mediciones exactas y que no se pierdan en el espacio muerto del circuito respiratorio, es necesario que el equipo ofertado cuente con un sensor de flujo proximal que se conecte al tubo endotraqueal del paciente, y así poder obtener mediciones correctas para poder dar una terapia ventilatoria correcta. ¿Es correcto?	La pregunta no versa sobre alguna respuesta dada por la convocante en la junta de aclaraciones, por lo que no se da respuesta de acuerdo al Art. 46 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
11	Punto 1.7.9. Nebulizador sincrónico para aerosolterapia de tecnología ultrasónica o equivalente,	La pregunta no versa sobre alguna respuesta dada por la



2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA.

No. LA-050GYR006-E359-2022

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE; IMAGENOLOGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.

NÚM	Preguntas	Respuestas
	con cámara de acoplamiento con transductor en caso de que la tecnología lo requiera, con capacidad de generación de partículas de 5 µm o menor, flujo de salida regulable en ml/h. Pregunta. Solicitamos a la Convocante permita ofertar este punto con nebulizador con flujo de salida regulable en ml/min. ¿Se acepta?	convocante en la junta de aclaraciones, por lo que no se da respuesta de acuerdo al Art. 46 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
12	Punto 3.1.1.1. Dos (2) juegos de puntas nasales desechables libres de látex para ventilación no invasiva de uso neonatal, de los siguientes tamaños: XS, S, M y L o su equivalente. Pregunta: Solicitamos a la Convocante permita ofertar el tamaño L con la nomenclatura del fabricante, que es No 3. Y que es equivalente al tamaño L. ¿Se acepta?	La pregunta no versa sobre alguna respuesta dada por la convocante en la junta de aclaraciones, por lo que no se da respuesta de acuerdo al Art. 46 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
13	PREGUNTA NO. 16 - REPREGUNTA Conforme a la respuesta otorgada por la Convocante a la pregunta número 16 del licitante DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V., solicitamos a la Convocante reconsiderar su respuesta, dado que, debido a la variedad de marcas y fabricantes en el mercado, existen diferentes nomenclaturas para el mismo producto, por lo que solicitamos permita ofertar el tamaño L con la nomenclatura del fabricante, que es No 3. Y que es equivalente al tamaño L. ¿Se acepta?	No es correcta su apreciación, para el numeral 3.1.1.1 de la Cédula de Descripción del Artículo correspondiente a la partida 27 PREI 12188 podrá ofertar dos (2) juegos de puntas nasales desechables y libres de latex para ventilación no invasiva de uso neonatal, de los siguientes tamaños: XS, S, M y L o No.3. Lo anterior, sin ser obligatorio para los demás participantes
14	Punto 3.1.1.3. Dos (2) juegos de bonetes neonatales para ventilación no invasiva, de los siguientes tamaños: XS, S, M y L o su equivalente. Pregunta: Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar doce (12) arneses neonatales en tamaños XXS, XS y S con el fin de cumplir este punto, pues son los tamaños y nomenclaturas que maneja el fabricante. ¿Se acepta?	La pregunta no versa sobre alguna respuesta dada por la convocante en la junta de aclaraciones, por lo que no se da respuesta de acuerdo al Art. 46 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector



Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin.



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA.
No. LA-050GYR006-E359-2022

**OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE;
IMAGENOLOGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR
NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.**

NÚM	Preguntas	Respuestas
		Público
15	PREGUNTA NO. 18 - REPREGUNTA Conforme a la respuesta otorgada por la Convocante a la pregunta número 18 del licitante DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V., solicitamos a la Convocante reconsiderar su respuesta, dado que, debido a la variedad de marcas y fabricantes en el mercado, existen diferentes nomenclaturas para el mismo producto, por lo que solicitamos permita ofertar doce (12) arneses neonatales en tamaños XXS, XS y S con el fin de cumplir este punto, pues son los tamaños y nomenclaturas que maneja el fabricante. ¿Se acepta?	No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo solicitado en el numeral 3.1.1.3 de la Cédula de Descripción del Artículo correspondiente a la partida 27 PREI 12188
16	Partida 29. Ventilador adulto – pediátrico. Punto 1.4.6. Ventilación no invasiva para los dos tipos de paciente (adulto y pediátrico). Pregunta: Entendemos que la terapia de alto flujo de oxígeno se considera dentro de la modalidad de ventilación no invasiva, por lo que el equipo ofertado deberá contar con esta tecnología. ¿Es correcto?	La pregunta no versa sobre alguna respuesta dada por la convocante en la junta de aclaraciones, por lo que no se da respuesta de acuerdo al Art. 46 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
17	PREGUNTA NO. 19 - REPREGUNTA Conforme a la respuesta otorgada por la Convocante a la pregunta número 18 del licitante DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V., solicitamos a la Convocante considere requerir este punto como obligatorio, ya que con la pandemia de COVID-19, se han demostrado los beneficios de incorporar esta terapia ventilatoria en el tratamiento de los pacientes, pues reduce el tiempo de estancia hospitalaria, ayuda a retrasar la intubación del paciente o eliminarla por completo en algunos casos, lo cual representa una mejora para la atención de los derechohabientes. ¿Se acepta?	La pregunta no va relacionada a la respuesta a la pregunta 18 del licitante DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A DE C.V. dada por la convocante en la junta de aclaraciones, por lo que no se da respuesta de acuerdo al Art. 46 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
18	Punto 1.4.6. Ventilación no invasiva para los dos tipos de paciente (adulto y pediátrico). Pregunta: Con el fin de dar una terapia ventilatoria adecuada para cada paciente y su condición,	La pregunta no versa sobre alguna respuesta dada por la



Handwritten blue ink marks: a large vertical line with a hook at the top, and a large 'X' at the bottom right.



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA.

No. LA-050GYR006-E359-2022

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE; IMAGENOLOGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.

NÚM	Preguntas	Respuestas
	entendemos que el equipo ofertado deberá ser capaz de dar ventilación no invasiva con los mismos modos ventilatorios disponibles para ventilación invasiva. ¿Es correcto?	convocante en la junta de aclaraciones, por lo que no se da respuesta de acuerdo al Art. 46 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
19	Sin punto. Pregunta: Para complementar la terapia ventilatoria, mejorar el reclutamiento alveolar y reducir el tiempo de estancia de los pacientes, entendemos que el equipo a ofertar deberá cumplir con la función de programación de suspiros, lo que ayuda a evitar el colapso alveolar, incrementar la oxigenación y con ello mejorar la protección pulmonar. ¿Es correcto?	La pregunta no versa sobre alguna respuesta dada por la convocante en la junta de aclaraciones, por lo que no se da respuesta de acuerdo al Art. 46 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
20	1.5.20. Cálculo o medición de puntos de inflexión en el lazo de volumen vs presión. Pregunta: El lazo de volumen presión deberá construirse o registrarse como una curva o lazo estático para que se reflejen de manera real las propiedades mecánicas de los pulmones, específicamente de elasticidad, que es la propiedad que necesita medirse para obtener los puntos de inflexión superior e inferior necesarios para ajustar la PEEP y la presión meseta o volumen corriente necesarios para dar una ventilación protectora. Es por ello que entendemos que el ventilador ofertado deberá contar con un lazo presión-volumen o volumen vs presión que registre una curva estática para poder cumplir con este punto. ¿Es correcto?	La pregunta no versa sobre alguna respuesta dada por la convocante en la junta de aclaraciones, por lo que no se da respuesta de acuerdo al Art. 46 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
21	Punto 1.5.22. Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias de al menos 24 horas. Pregunta: Para obtener información más confiable, fidedigna y que muestre la evolución real del paciente conectado al ventilador, el equipo a ofertar deberá contar con almacenamiento de tendencias de al menos 31 días. Esto para que el personal clínico pueda ver el panorama real de la evolución de la terapia ventilatoria y puedan tomar decisiones adecuadas para el tratamiento. ¿Es	La pregunta no versa sobre alguna respuesta dada por la convocante en la junta de aclaraciones, por lo que no se da respuesta de acuerdo al Art. 46 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público



Ricardo Flores
Año de Magón
HISCUERPO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Handwritten blue ink marks on the right side of the page, including a curved line and a large 'X' at the bottom.



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA.

No. LA-050GYR006-E359-2022

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE; IMAGENOLOGÍA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.

NÚM	Preguntas	Respuestas
	correcto?	

Preguntas efectuadas por: **SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV**

NÚM	Preguntas	Respuestas
1	<p>Consecutivo 12 ULTRASONOGRAFO. (INTERMEDIO). Dice: Punto 1.7. Imagen en 3D en tiempo real o 4D de 30 volúmenes por segundo o mayor. Se solicita amablemente a la convocante nos permita referenciar este punto con nuestra propia tecnología y así permitir la libre participación de todos los demás licitantes con 20 volúmenes por segundo, lo cual no difiere en el alcance clínico del software, ya que se tiene una función "MultiSlice" que permite al usuario elegir el rango, espacio entre cortes y despliegue de ellos. ¿Se Acepta?</p> <p>RESPUESTA NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.7 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 63 PREI 16417</p> <p>REPREGUNTA Dado que la aplicación clínica del equipo está dirigido a la evaluación obstétrica del feto, considerando que el mayor movimiento que podría registrarse es del corazón fetal a máximo 180 latidos por minuto, lo cual equivale a una frecuencia de 180 latidos / 60 segundos, es decir 3Hz (ciclos por segundo); el adquirir 19 volúmenes por segundo, es decir 19 Hz ciclos por segundo) para el software 3D/4D cubre por completo con más de 6 veces la frecuencia de movimiento de la anatomía, evitando así pérdida de información importante. Con esta consideración, podemos saber que el alcance clínico del equipo esta cubierto con el software ofertado. ¿Se Acepta?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.7 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 78 PREI 17035</p>



Handwritten blue ink marks on the right side of the page, including a curved arrow pointing left, a vertical line, and a large 'X' mark.



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA.

No. LA-050GYR006-E359-2022

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE; IMAGENOLOGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.

NÚM	Preguntas	Respuestas
2	<p>Consecutivo 12 ULTRASONOGRAFO. (INTERMEDIO). Dice: Punto 1.7. Imagen en 3D en tiempo real o 4D de 30 volúmenes por segundo o mayor. Se solicita amablemente a la convocante nos permita referenciar este punto con nuestra propia tecnología y así permitir la libre participación de todos los demás licitantes con 20 volúmenes por segundo, lo cual no difiere en el alcance clínico del software, ya que se tiene una función "MultiSlice" que permite al usuario elegir el rango, espacio entre cortes y despliegue de ellos. ¿Se Acepta?</p> <p>RESPUESTA NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.7 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 63 PREI 16417</p> <p>REPREGUNTA En caso de que la pregunta anterior sea negativa</p> <p>Dado que "desde el punto de vista médico, el 3D o 4D no aporta información diagnóstica alguna"(1) adicional a la adquirida por los estudios realizados con el transductor convexo 2D, mientras que "muchas entidades privadas ofrecen a los padres la posibilidad de obtener imágenes 3D de su hijo en gestación [...]. Esta actividad no está aprobada por las sociedades científicas o entidades legales."(2) Ya que incluso en este sentido, la "FDA ha emitido una alerta acerca de los ultrasonidos 3D"(3). Y además "mientras que el 3D puede ofrecer una bonita foto del exterior del bebé, el ultrasonido 2D es realmente el estándar que ha sido desarrollado por expertos para identificar anomalías en el desarrollo y crecimiento del bebé."(4) Razones por las que solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar equipo tope de línea con transductor abdominal profundo que permite realizar estudios a pacientes con alto índice de masa corporal (obesidad), además del transductor convexo convencional, lo que será de mayor utilidad para las unidades médicas, sin ser limitativo para el resto de licitantes, ¿se acepta?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.7 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 78 PREI 17035</p>



Handwritten blue ink marks on the right side of the page, including a curved line, a vertical line, and a large 'X' mark.



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA.

No. LA-050GYR006-E359-2022

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE; IMAGENOLOGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.

NÚM	Preguntas	Respuestas
	<p>[1] Watts G. (2007). First picturesOne for the album. BMJ (Clinical research ed.), 334(7587), 232-233. https://doi.org/10.1136/bmj.39106.494931.94</p> <p>[2] Abramowicz J.S. (2020). Obstetric ultrasound: where are we and where are we going? (Ultrasonography); 40(1): 57-74. Korean Society of Ultrasound in Medicine (KSUM) https://doi.org/10.14366/usg.20088</p> <p>[3] Kropff, A. (2015). FDA warns about 3D ultrasounds. Tampa Bay 10. https://www.wtsp.com/article/news/health/fda-warns-about-3d-ultrasounds/67-236691119</p> <p>[4] Horsager-Boehrer, R. (2016). Why to avoid 'keepsake' 3D and 4D ultrasounds. UT Southwestern Medical Center. https://utswmed.org/medblog/3d-4d-ultrasound/</p>	
3	<p>16 UNIDAD DE TOMOGRAFÍA</p> <p>Se solicita de la manera más atenta a la convocante nos permita utilizar en la referenciación acrónimos y frases propias de nuestra casa comercial en caso de no poder citar textualmente los puntos solicitados, en el entendido de que se hace referencia a un resultado igual o equivalente ¿Se acepta?</p> <p>RESPUESTA SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPA CON LA TOTALIDAD DE LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO CORRESPONDIENTE A LA PARTIDAD 78 PREI 17035, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>



Handwritten blue ink marks on the right margin, including a large vertical line and an 'X' at the bottom.



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA.

No. LA-050GYR006-E359-2022

**OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE;
IMAGENOLÓGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR
NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.**

NÚM	Preguntas	Respuestas
	<p>REPREGUNTA En relación a la respuesta otorgada a la empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S. DE RL. DE CV Solicitamos a la convocante nos permita referenciar para el Punto 1.13.1 de la cedula del tomógrafo acorde a la bibliografía de nuestra tecnología que expresa la tasa máxima de reconstrucción como 23 fps (frames per second) para FBP (retroproyección filtrada) , 20 fps (frames per second) para IR (reconstrucción iterativa) con Ultra - Fast IRS considerando que es una tecnología superior y equivalente ¿se acepta?</p>	
4	<p>16</p> <p>UNIDAD DE TOMOGRAFÍA Se solicita de la manera más atenta a la convocante nos permita utilizar en la referenciación acrónimos y frases propias de nuestra casa comercial en caso de no poder citar textualmente los puntos solicitados, en el entendido de que se hace referencia a un resultado igual o equivalente ¿Se acepta?</p> <p>RESPUESTA SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPA CON LA TOTALIDAD DE LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO CORRESPONDIENTE A LA PARTIDAD 78 PREI 17035, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES</p> <p>REPREGUNTA En relación a la respuesta otorgada a la empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S. DE RL. DE CV . Solicitamos a la convocante nos permita referenciar para el Punto 1.13.2 de la cedula del tomógrafo acorde a la bibliografía de nuestra tecnología que expresa una resolución de alto contraste</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.13.2 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 78 PREI 17035</p>



Handwritten blue ink marks on the right side of the page, including a curved arrow pointing left and a large vertical scribble.



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA.

No. LA-050GYR006-E359-2022

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE; IMAGENOLÓGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.

NÚM	Preguntas	Respuestas
	<p>AI 2% MTF 15.1 lp/cm (± 10%) AI 10% MTF 14.6 lp/cm (± 10%) AI 50% MTF 12.0 lp/cm (± 10%)</p> <p>En el entendido de que así se demuestra esta característica en nuestros folletos y bibliografía de fábrica ¿se acepta?</p>	
5	<p>16 UNIDAD DE TOMOGRAFÍA Se solicita de la manera más atenta a la convocante nos permita utilizar en la referenciación acrónimos y frases propias de nuestra casa comercial en caso de no poder citar textualmente los puntos solicitados, en el entendido de que se hace referencia a un resultado igual o equivalente ¿Se acepta?</p> <p>RESPUESTA SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPA CON LA TOTALIDAD DE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO CORRESPONDIENTE A LA PARTIDAD 78 PREI 17035, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES</p> <p>REPREGUNTA En relación a la respuesta otorgada a la empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S. DE RL. DE CV Solicitamos amablemente a la convocante nos permita referenciar la característica del Punto 1.14.21 de la cedula del tomógrafo acorde a nuestros catálogos debido a que si aparece en nuestra bibliografía y se cumple cabalmente con el alcance solicitado. Texto en catálogos "Conexión de red La comunicación de red está restringida a los nodos DICOM clínicamente relevantes (por ejemplo, PACS y RIS) . Transferencia de imágenes / Redes Interfaz para la transferencia de imágenes e información médica utilizando el estándar</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>



Handwritten blue ink marks on the right margin, including a curved line at the top, a vertical line, and a large 'X' at the bottom.



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA.

No. LA-050GYR006-E359-2022

**OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE;
IMAGENOLÓGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR
NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.**

NÚM	Preguntas	Respuestas
	<p>DICOM. Facilita la comunicación con dispositivos de diferentes fabricantes. · DICOM Almacenamiento (enviar / recibir) · DICOM Consulta / recuperación · DICOM Impresión básica · DICOM Obtención de lista de trabajo (HIS/RIS) · DICOM SR visor · DICOM Compromiso de almacenamiento · DICOM visor en CD/DVD · DICOM MPPS" ¿se acepta?</p>	
6	<p>16 UNIDAD DE TOMOGRAFÍA Se solicita de la manera más atenta a la convocante nos permita utilizar en la referenciación acrónimos y frases propias de nuestra casa comercial en caso de no poder citar textualmente los puntos solicitados, en el entendido de que se hace referencia a un resultado igual o equivalente ¿Se acepta?</p> <p>RESPUESTA SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPA CON LA TOTALIDAD DE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 78 PREI 17035, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</p> <p>REPREGUNTA UNIDAD DE TOMOGRAFÍA En relación a la respuesta otorgada a la empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S. DE RL. DE CV Solicitamos amablemente a la convocante nos permita referenciar para el Punto 2.1.23 de la cedula del tomógrafo acorde a nuestros catálogos debido a que si aparece en nuestra bibliografía y se cumple cabalmente con el alcance solicitado. Texto en catálogos "Conexión de red La comunicación de red está restringida a los nodos DICOM clínicamente relevantes (por ejemplo, PACS y RIS) · Transferencia de imágenes / Redes Interfaz para la transferencia de imágenes e información médica utilizando el estándar DICOM. Facilita la comunicación con dispositivos de diferentes fabricantes. · DICOM Almacenamiento (enviar / recibir) · DICOM Consulta / recuperación · DICOM Impresión básica · DICOM Obtención de lista de</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES</p>



Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin.



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA.

No. LA-050GYR006-E359-2022

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE; IMAGENOLOGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.

NÚM	Preguntas	Respuestas
	trabajo (HIS/RIS) · DICOM SR visor · DICOM Compromiso de almacenamiento · DICOM visor en CD/DVD · DICOM MPPS" ¿se acepta?	

Preguntas efectuadas por: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.**

NÚM	Preguntas	Respuestas
1	PREGUNTA NÚM. 1 EFECTUADA POR CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES RE-PREGUNTA: PARTIDA N° 18, MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOCIRUGIA. Punto 1.2.1 Dice: Primer brazo, brazo de soporte o brazo móvil (del eje de conexión con el estativo al eje de conexión con el segundo brazo). El microscopio propuesto cuenta con un brazo denominado brazo del estativo del eje 1, el cual, conecta el estativo con el primer brazo del microscopio. Entendemos que, para este punto, se cubre con lo solicitado por la convocante. ¿es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación, sin ser obligatorio para los demás participantes.
2	PREGUNTA NÚM. 2 EFECTUADA POR CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES RE-PREGUNTA: PARTIDA N° 18, MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOCIRUGIA. Punto 1.2.2 Dice: Segundo brazo, brazo basculante o brazo autocompensado (del eje de	Es correcta su apreciación, sin ser obligatorio para los demás participantes.



(Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin)



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA.

No. LA-050GYR006-E359-2022

**OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE;
IMAGENOLOGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR
NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.**

	<p>conexión con el primer brazo al eje de conexión con el eje óptico). El microscopio propuesto cuenta con un brazo denominado brazo saliente, del eje 6, el cual, conecta el primer brazo con el eje de la óptica, entendemos que, para este punto, se cubre con lo solicitado por la convocante. ¿es correcta nuestra apreciación?</p>	
<p>3</p>	<p>PREGUNTA NÚM. 3 EFECTUADA POR CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES RE-PREGUNTA: PARTIDA N° 18, MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOCIRUGIA. Punto 1.2.7 Dice: Sistema de movimiento XY motorizado, con botón de puesta a cero y/o precentrado automático. De al menos 30 mm en X y 30 mm en Y. El microscopio propuesto cuenta con la función MOTRICIDAD XY, la cual, se controla mediante un botón Joystick) localizado en la empuñadura o en el conmutador de pedal (panel de mando de pedal). Esta función permite realizar movimientos de giro, de inclinación o de rotación del microscopio con velocidad constante a la dirección seleccionada en el Joystick de 30 mm en el plano XY. Además, cuenta con una función de Enlace de zoom a la velocidad de desplazamiento XY para mejorar la visualización y es posible regular la velocidad de desplazamiento de 0 a 100%. Nuestra tecnología ofrece funciones adicionales de lo solicitado por la convocante que mejorarán el trabajo de los usuarios. ¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>Se acepta su propuesta, siempre y cuando cumpla con la totalidad de características solicitadas en el numeral 1.2.7 de la Cédula de Descripción del Artículo correspondiente a la partida 18 PREI 12049</p>
<p>4</p>	<p>PREGUNTA NÚM. 4 EFECTUADA POR CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES RE-PREGUNTA: PARTIDA N° 18, MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOCIRUGIA.</p>	<p>Es correcta su apreciación siempre y cuando la interfaz sea a través de una pantalla táctil, sin ser obligatorio para los demás participantes.</p>



2022 Flores
Ricardo
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

(Handwritten blue ink marks: a curved line at the top, a vertical line in the middle, and an 'X' at the bottom)



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA.

No. LA-050GYR006-E359-2022

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE; IMAGENOLOGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.

	<p>Punto 1.2.10 Dice: Pantalla táctil LCD o LED para control motorizado y despliegue de las siguientes funciones: 1.2.10.1 Magnificación (zoom) 1.2.10.2 Regulación de la intensidad luminosa. 1.2.10.3 Desplazamiento XY. 1.2.10.4 Enfoque El microscopio propuesto permite el acceso desde la interfaz de usuario a las funciones de magnificación y enfoque, mediante la cual, es posible controlar la velocidad de ésta de manera motorizada, así como también, muestra el factor de magnificación y enfoque que se tenga en un momento determinado; también se tiene acceso a un botón para el control de intensidad de luz de manera motorizada; y finalmente un botón para regular la velocidad del movimiento fino XY. Entendemos que estas características cubren lo solicitado e incluso ofrece funciones superiores de lo solicitado por la convocante. ¿es correcta nuestra apreciación?</p>	
<p>5</p>	<p>PREGUNTA NÚM. 5 EFECTUADA POR CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES RE-PREGUNTA: PARTIDA N° 18, MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOCIRUGIA. Punto 1.4.4 Dice: Con divisor de haz de luz 80%:20% o 70%: 30% que permita mantener observación simultanea entre observador principal y ca-observador El microscopio propuesto cuenta con un sistema de última generación que incluye un divisor integrado dentro del microscopio, que se puede configurar en la pantalla táctil o en el microscopio, mediante un espejo giratorio para utilizarlo</p>	<p>Se acepta su propuesta, siempre y cuando cumpla con la totalidad de características solicitadas en el numeral 1.4.4 de la Cédula de Descripción del Artículo correspondiente a la partida 18 PREI 12049</p>



2022 Ricardo Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

(Handwritten blue marks and signatures on the right margin)



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA.

No. LA-050GYR006-E359-2022

**OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE;
IMAGENOLOGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR
NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.**

	en la posición opuesta como sistema óptico simétrico u observación cara a cara o para la coobservación y documentaciones laterales, con las mismas características para el usuario principal y asistente. Entendemos que para este punto el equipo propuesto cubre con lo solicitado por la convocante. ¿es correcta nuestra apreciación?	
6	PREGUNTA NÚM. 6 EFECTUADA POR CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES RE-PREGUNTA: PARTIDA N° 18, MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOCIRUGIA. Punto 2.1.1 Dice: Sensor HD CMOS progresivo de 1/3 pulgadas El sistema propuesto cuenta con un paquete de video: una cámara de video HD integrada de 3-CCD. Entendemos que nuestra tecnología cumple con lo solicitado por la convocante. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Se acepta su propuesta, siempre y cuando cumpla con la totalidad de características solicitadas en el numeral 2.1.1 de la Cédula de Descripción del Artículo correspondiente a la partida 18 PREI 12049
7	PREGUNTA NÚM. 7 EFECTUADA POR CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES RE-PREGUNTA: PARTIDA N° 18, MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOCIRUGIA. Punto 2.3.2 Dice: Con accesorio para montaje del monitor al estativo del microscopio. El microscopio propuesto incluye ya un monitor de 22" integrado en el cuerpo del microscopio (en el estativo). por lo que ya no es necesario un accesorio para montaje. ¿es correcta nuestra apreciación?	Se acepta su propuesta, sin ser obligatorio para los demás participantes.



Handwritten blue ink marks, including a large vertical line and a cross-like symbol at the bottom right.



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA.

No. LA-050GYR006-E359-2022

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE; IMAGENOLOGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.

Preguntas efectuadas por: **ANDERS BAUPRE, S.A. DE C.V.**

NÚM	Preguntas	Respuestas
1.	Pregunta número 3 del licitante Anders Baupre S.A. de C.V., Se preguntó si se acepta presentar certificado de calidad de alguna de las normas de calidad ISO 9001 o bien ISO 13485, a o que la convocante contestó que no es correcta nuestra apreciación, pero no contesta en forma concisa si aceptan presentar el certificado de calidad ISO 9001 o bien el ISO 13485 para cumplir con el numeral 2.1 Calidad, favor de contestar si aceptan presentar el certificado de calidad ISO 9001 o ISO 13485, considerando que la norma ISO 13485 es un sistema de gestión de calidad aplicable para dispositivos médicos la cual se deriva de la norma ISO 9001, solo que la norma ISO 13485 se enfoca en características sanitarias que deben cumplir los equipos médicos, derivado de lo anterior solicitamos de la manera más atenta nos respondan si aceptan presentar ISO 9001 y/o ISO 13485, ¿se acepta?	No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo solicitado en la convocatoria numeral 2.1 y 2.2.
2.	Pregunta número 5 y 11 del licitante grupo Reinet, S.A. de C.V. en ambas preguntas el licitante pregunta: "Entendemos que se deberá ofertar un control remoto de mano alámbrico, el cual debe de mostrar en su pantalla símbolos de los movimientos que se están realizando. ¿es correcto?" a lo que la convocante contesto: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA..., sin embargo, enseguida la convocante dice: PARA EL NUMERAL 1.12 DE LA CEDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 17 PREI 20662 DEBERÁ OFERTAR MOVIMIENTOS ELECTROHIDRÁULICOS CON CONTROL REMOTO DE MANO ALÁMBRICO QUE MUESTRE EN PANTALLA SÍMBOLOS DE MOVIMIENTOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO. Definitivamente la segunda parte de la respuesta de la convocante corresponde a lo entendido (solicitado) por el licitante Grupo Reinet S.A. de C.V., esto genera confusión ya que primero dicen que no se acepta y enseguida solicitan que se oferte lo solicitado por el licitante Grupo Reinet S.A. de C.V., por lo que solicitamos de la manera más atenta se aclare en forma concisa si aceptan o no las preguntas número 5 y 11 del licitante	Para el numeral 1.12 de la Cédula de Descripción del Artículo correspondiente a la partida 17 PREI 20662 deberá ofertar Movimientos electrohídricos con control remoto de mano alámbrico que muestre en pantalla símbolos de movimientos que se están realizando.



(Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin)



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA.

No. LA-050GYR006-E359-2022

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE; IMAGENOLOGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.

NÚM	Preguntas	Respuestas
	grupo Reinet, S.A. de C.V.	

Preguntas efectuadas por: **VIASIS OTE S.A. DE C.V.**

NÚM	REPREGUNTA	Respuestas
1	En relación a la respuesta otorgada a las empresas: Anders Baupre SA de CV (su pregunta 3), Comercializadora Sarhua SA de CV (su pregunta 1) y Servicios Biomédicos BAZAFI (su Pregunta 1), al ser este un evento de aclaración de dudas, solicitamos atentamente a la convocante nos aclare la finalidad de solicitar el Certificado de Calidad ISO 9001:2015 a nombre del fabricante de equipo médico. Favor de Aclarar.	Se requiere toda vez que se comprobará la congruencia entre la descripción técnica del licitante, indicada en el "Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados", incluyendo marca(s), modelo(s) y fabricante(s) y los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos en los numerales 2.1 y 2.2.

Preguntas efectuadas por: **SERVICIOS BIOMÉDICOS BAZAFI, SA DE CV**

NÚM.	Preguntas	Respuestas
1	<p>2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.</p> <p>SEGUNDO PUNTO</p> <ul style="list-style-type: none"> Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001:2015 e ISO-13485:2016 o JIS o MDSAP, vigente, a nombre del fabricante de los bienes, en el que se deberá identificar: 	<p>EL CERTIFICADO ISO 13485 ES ACTUALMENTE EL QUE ES ESPECIAL PARA LOS FABRICANTES DE DIPOSITIVOS MEDICOS, POR LO QUE NUEVAMENTE SE PIDE A LA CONVOCANTE NO LIMITAR LA PARTICIPACION AL SOLICITAR FORZOSAMENTE LOS DOS ISO, EL 9001:2015 E ISO 13485</p> <p>Se solicita se permita entregar únicamente el ISO 13485</p> <p>Se acepta?</p>



(Handwritten blue marks and signatures on the right margin)



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA.
No. LA-050GYR006-E359-2022**

**OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE;
IMAGENOLOGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR
NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.**

	<ul style="list-style-type: none"> a) Tipo y número de certificado. b) Nombre y dirección de la empresa que se certifica. c) Alcance. <ul style="list-style-type: none"> 1. El alcance deberá amparar la fabricación de bienes de iguales o similares características a los solicitados. d) Fecha de emisión. e) Vigencia o fecha de vencimiento. f) Nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado. 	<p>No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo solicitado en la convocatoria.</p>
--	---	---

Preguntas efectuadas por: **CARL ZEISS DE MÉXICO S.A. DE C.V.**

NÚM	RESPUESTA OTORGADA	RE-Preguntas	Respuestas
1	NO ES POSIBLE DAR RESPUESTA, TODA VEZ QUE NO SE ESPECIFICA LA PARTIDA Y/O PARTE DE LA	Con base en la respuesta otorgada a mí representada, SE HACE REFERENCIA A LA PARTIDA 18 Microscopio de neurocirugía, por lo anterior mencionado Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si para el	Es correcta su apreciación, sin ser obligatorio para los demás participantes



(Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin)



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA.

No. LA-050GYR006-E359-2022

**OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE;
IMAGENOLOGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR
NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.**

NÚM.	RESPUESTA OTORGADA	RE-Preguntas	Respuestas
	CONVOCATORIA A LA CUAL HACE REFERENCIA	Punto 1.2.1 Dice: Primer brazo, brazo de soporte o brazo móvil (del eje de conexión con el estativo al eje de conexión con el segundo brazo). El microscopio propuesto cuenta con un brazo denominado brazo del estativo del eje 1, el cual, conecta el estativo con el primer brazo del microscopio. Entendemos que, para este punto, se cubre con lo solicitado por la convocante. ¿es correcta nuestra apreciación?	
2	NO ES POSIBLE DAR RESPUESTA, TODA VEZ QUE NO SE ESPECIFICA LA PARTIDA Y/O PARTE DE LA CONVOCATORIA A LA CUAL HACE REFERENCIA	Con base en la respuesta otorgada a mí representada, SE HACE REFERENCIA A LA PARTIDA 18 Microscopio de neurocirugía, por lo anterior mencionado Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si para el Punto 1.2.2 Dice: Segundo brazo, brazo basculante o brazo autocompensado (del eje de conexión con el primer brazo al eje de conexión con el eje óptico). El microscopio propuesto cuenta con un brazo denominado brazo saliente, del eje 6, el cual, conecta el primer brazo con el eje de la óptica, entendemos que, para este punto, se cubre con lo solicitado por la convocante. ¿es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación, sin ser obligatorio para los demás participantes
3	NO ES POSIBLE DAR RESPUESTA, TODA VEZ QUE NO SE ESPECIFICA LA PARTIDA Y/O PARTE DE LA CONVOCATORIA A LA CUAL HACE REFERENCIA	Con base en la respuesta otorgada a mí representada, SE HACE REFERENCIA A LA PARTIDA 18 Microscopio de neurocirugía, por lo anterior mencionado Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si para el Punto 1.2.7 Dice: Sistema de movimiento XY motorizado, con botón de puesta a cero y/o precentrado automático. De al menos 30 mm en X y 30 mm en Y.	Se acepta su propuesta, siempre y cuando cumpla con la totalidad de características solicitadas en el numeral 1.2.7 de la Cédula de Descripción del Artículo correspondiente a la partida 18 PREI 12049



Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page.



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA.
No. LA-050GYR006-E359-2022**

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE; IMAGENOLOGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.

NÚM	RESPUESTA OTORGADA	RE-Preguntas	Respuestas
		El microscopio propuesto cuenta con la función MOTRICIDAD XY, la cual, se controla mediante un botón (joystick) localizado en la empuñadura o en el conmutador de pedal (panel de mando de pedal). Esta función permite realizar movimientos de giro, de inclinación o de rotación del microscopio con velocidad constante a la dirección seleccionada en el Joystick de 30 mm en el plano XY. Además, cuenta con una función de Enlace de zoom a la velocidad de desplazamiento XY para mejorar la visualización y es posible regular la velocidad de desplazamiento de 0 a 100%. Nuestra tecnología ofrece funciones adicionales de lo solicitado por la convocante que mejorarán el trabajo de los usuarios. ¿Se acepta nuestra propuesta?	
4	NO ES POSIBLE DAR RESPUESTA, TODA VEZ QUE NO SE ESPECIFICA LA PARTIDA Y/O PARTE DE LA CONVOCATORIA A LA CUAL HACE REFERENCIA	Con base en la respuesta otorgada a mí representada, SE HACE REFERENCIA A LA PARTIDA 18 Microscopio de neurocirugía, por lo anterior mencionado Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si para el Punto 1.2.10 Dice: Pantalla táctil LCD o LED para control motorizado y despliegue de las siguientes funciones: 1.2.10.1 Magnificación (zoom) 1.2.10.2 Regulación de la intensidad luminosa. 1.2.10.3 Desplazamiento XY. 1.2.10.4 Enfoque El microscopio propuesto permite el acceso desde la interfaz de usuario a las funciones de magnificación y enfoque, mediante la cual, es posible controlar la velocidad de ésta de manera motorizada, así como también, muestra el factor	Es correcta su apreciación siempre y cuando la interfaz sea a través de una pantalla táctil, sin ser obligatorio para los demás participantes



(Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin)



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA.
No. LA-050GYR006-E359-2022

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE; IMAGENOLÓGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.

NÚM	RESPUESTA OTORGADA	RE-Preguntas	Respuestas
		de magnificación y enfoque que se tenga en un momento determinado; también se tiene acceso a un botón para el control de intensidad de luz de manera motorizada; y finalmente un botón para regular la velocidad del movimiento fino XY. Entendemos que estas características cubren lo solicitado e incluso ofrece funciones superiores de lo solicitado por la convocante. ¿es correcta nuestra apreciación?	
5	NO ES POSIBLE DAR RESPUESTA, TODA VEZ QUE NO SE ESPECIFICA LA PARTIDA Y/O PARTE DE LA CONVOCATORIA A LA CUAL HACE REFERENCIA	Con base en la respuesta otorgada a mí representada, SE HACE REFERENCIA A LA PARTIDA 18 Microscopio de neurocirugía, por lo anterior mencionado Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si para el Punto 1.4.4 Dice: Con divisor de haz de luz 80%:20% o 70%: 30% que permita mantener observación simultanea entre observador principal y ca-observador El microscopio propuesto cuenta con un sistema de última generación que incluye un divisor integrado dentro del microscopio, que se puede configurar en la pantalla táctil o en el microscopio, mediante un espejo giratorio para utilizarlo en la posición opuesta como sistema óptico simétrico u observación cara a cara o para la coobservación y documentaciones laterales, con las mismas características para el usuario principal y asistente. Entendemos que para este punto el equipo propuesto cubre con lo solicitado por la convocante. ¿es correcta nuestra apreciación?	Se acepta su propuesta, siempre y cuando cumpla con la totalidad de características solicitadas en el numeral 1.4.4 de la Cédula de Descripción del Artículo correspondiente a la partida 18 PREI 12049
6	NO ES POSIBLE DAR RESPUESTA, TODA VEZ QUE NO SE ESPECIFICA LA PARTIDA Y/O PARTE DE LA CONVOCATORIA A LA CUAL HACE	Con base en la respuesta otorgada a mí representada, SE HACE REFERENCIA A LA PARTIDA 18 Microscopio de neurocirugía, por lo anterior mencionado Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si para el	Se acepta su propuesta, siempre y cuando cumpla con la totalidad de características solicitadas en el numeral 2.1.1 de la Cédula de Descripción del Artículo correspondiente a la



(Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin)



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA.
No. LA-050GYR006-E359-2022

**OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE;
IMAGENOLOGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR
NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.**

NÚM	RESPUESTA OTORGADA	RE-Preguntas	Respuestas
	REFERENCIA	Punto 2.1.1 Dice: Sensor HD CMOS progresivo de 1/3 pulgadas El sistema propuesto cuenta con un paquete de vídeo: una cámara de video HD integrada de 3-CCD. Entendemos que nuestra tecnología cumple con lo solicitado por la convocante. ¿Es correcta nuestra apreciación?	partida 18 PREI 12049
7	NO ES POSIBLE DAR RESPUESTA, TODA VEZ QUE NO SE ESPECIFICA LA PARTIDA Y/O PARTE DE LA CONVOCATORIA A LA CUAL HACE REFERENCIA	Con base en la respuesta otorgada a mí representada, SE HACE REFERENCIA A LA PARTIDA 18 Microscopio de neurocirugía, por lo anterior mencionado Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si para el Punto 2.3.2 Dice: Con accesorio para montaje del monitor al estativo del microscopio. El microscopio propuesto incluye ya un monitor de 22" integrado en el cuerpo del microscopio (en el estativo), por lo que ya no es necesario un accesorio para montaje. ¿es correcta nuestra apreciación?	Se acepta su propuesta, sin ser obligatorio para los demás participantes

Preguntas efectuadas por: **CYBER ROBOTIC SOLUTIONS S.A. DE C.V.**

NÚM	Preguntas	Respuestas
1	PREGUNTA 1 DEL PARTICIPANTE SERVICIOS BIOMÉDICOS BAZAFI, S.A. DE C.V. 2.2 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS. SEGUNDO PUNTO	No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo solicitado en la convocatoria.





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA.

No. LA-050GYR006-E359-2022

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE; IMAGENOLOGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.

NÚM	Preguntas	Respuestas
	<p>COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO-9001:2015 E ISO-13485:2016 O JIS O MDSAP, VIGENTE A NOMBRE DEL FABRICANTE DE LOS BIENES.</p> <p>RESPUESTA DE LA CONVOCANTE: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.</p> <p>REPREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE LA SOLICITUD DEL CERTIFICADO ISO-9001:2015 DE FORMA OBLIGATORIA, YA QUE DE ACUERDO CON LA DEFINICIÓN DE LA PROPIA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTANDARIZACIÓN (ISO POR SUS SIGLAS EN INGLÉS https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html, https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001/) EL CERTIFICADO ISO 9001 ESTÁ ENFOCADO A PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE ATENCIÓN AL SERVICIO AL CLIENTE Y NO DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS. EN CAMBIO, EL CERTIFICADO ISO-13485 ESTÁ DIRIGIDO DIRECTAMENTE A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE EQUIPO MÉDICO BASADO EN EL ISO 9001, POR LO QUE SOLICITAR AMBOS CERTIFICADOS ES REDUNDANTE E INCLUSO, AL PRESENTAR SÓLO EL CERTIFICADO ISO 13485, SE ESTARÍA PRESENTANDO UNA CERTIFICACIÓN SUPERIOR A LA SOLICITADA EN EL ISO-9001, CON LO QUE SE CUMPLIRÍA CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, COMO EN LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 4 DEL PARTICIPANTE ANDERS BAUPRE, S.A. DE C.V., DONDE SE RATIFICA QUE PRESENTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS NO ES</p>	



2022 Ricardo Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

(Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin)



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA.

No. LA-050GYR006-E359-2022

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA **ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE; IMAGENOLOGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO"** QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL **ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.**

NÚM	Preguntas	Respuestas
	MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EN VIRTUD DE QUE SE OFRECEN PRODUCTOS DE MAYOR CALIDAD. ¿ES CORRECTO?	
	PREGUNTA 6 DEL PARTICIPANTE CYBER ROBOTIC SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	Es correcta su apreciación.
2	<p>PARTIDA 7.- UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA TRANSOPERATORIA.</p> <p>RESPUESTA DE LA CONVOCANTE: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ ABARCAR EL RANGO DE LAS FRECUENCIAS SOLICITADAS EN EL NUMERAL 1.20.4 DE LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 7 PREI 11784.</p> <p>REPREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE ESTÁ SOLICITANDO LA CANTIDAD DE 1 TRANSDUCTOR POR CADA PUNTO DESCRITO EN EL NUMERAL 1.20, POR LO QUE SE DEBEN OFERTAR EN TOTAL 5 TRANSDUCTORES QUE CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LOS PUNTOS 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4 Y 1.20.5. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	

No habiendo más preguntas que los licitantes hayan formulado respecto de las respuestas dadas por la convocante en la Junta de Aclaraciones, a sus solicitudes de aclaración remitidas por medios electrónicos dentro del término de seis horas, concedido en el Acta de Junta de Aclaraciones de fecha **27 de Septiembre del 2022**, publicada a las **15:43 horas** a través del portal de Compras Gubernamentales Compranet; de conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.



2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

[Handwritten signature in blue ink]



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA.

No. LA-050GYR006-E359-2022

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE; IMAGENOLÓGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO" QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes una copia de esta Acta en la dirección electrónica: www.compranet.hacienda.gob.mx.

Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día **05 de Octubre del 2022 a las 13:00 Horas**, el cual se llevará a cabo a través del sistema de compras gubernamentales Compra Net.

Por lo que se da por terminada esta **ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES**, siendo las **17:00 horas**, del día **28 de Septiembre del 2022**.

Esta Acta consta de **31** páginas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR EL INSTITUTO

Nombre	Área	Firma
CP Diliam Montaña Hernandez	Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento	



[Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin]



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



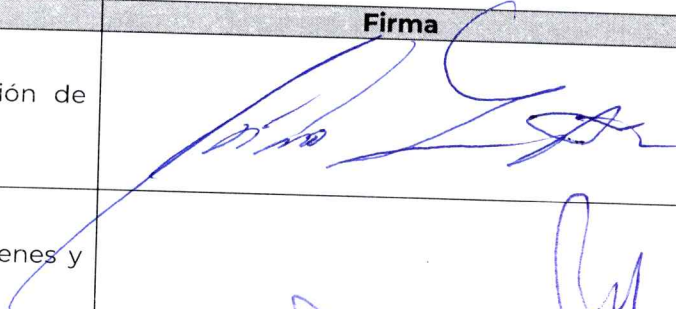

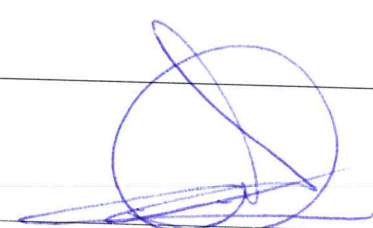
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS
EN PUEBLA**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

**ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA.

No. LA-050GYR006-E359-2022

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: PARA LA **ADQUISICIÓN DEL "MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, CEYE;
IMAGENOLOGIA Y URGENCIAS EN EL H.G.Z. NO. 5 METEPEC, ATLIXCO"** QUE EFECTÚA LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO PARA EL **ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA PARA CUBRIR
NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022.**

Nombre	Área	Firma
<u>CP Isidro Luna Arenas</u>	Jefe de Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
<u>Lic. Juan Pablo Guevara Aguilar</u>	Jefe de Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
<u>Lic. Maria Guadalupe Martínez Nieves</u>	Supervisor de Proyectos	

-----FIN DEL ACTA-----



2022 Ricardo Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA