



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA

LA-050-GYR-050GYR041-N-263-2023

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUA (TRRC) PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HGZ#1 TLAXCALA

En Tlaxcala, Tlaxcala, siendo las 12:00 horas, del día 08 de agosto de 2023, en la sala de juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, con con ubicación en Av. Libramiento Poniente I.P.N. S/N, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala. C.P. 90110; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento) así como del numeral 4 de la convocatoria a la licitación.

De conformidad con el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el acto es presidido por **Lic. Ángel Hebert Mejorado Torres**, en su carácter de Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, en términos del oficio no. 309001050100/537/2023; servidor público designado por la Convocante, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de CompraNet 2023, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El Presidente del acto, fue asistido por los representantes del área técnica, IBM. Carlos Joel Barrera Velazquez, Coordinador Biomédico Delegacional y Dr. Missael Vladimir Espinoza Villafuerte, Coordinador de Terapia Intensiva del H. G. Z. No 1, quienes solventaron las preguntas de carácter técnico y el representante del área contratante del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, Lic. Ángel Hebert Mejorado Torres en términos del oficio no. 309001050100/537/2023, el cual solventó las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de CompraNet 2023, de la siguiente persona:

FO
CON08/ 1



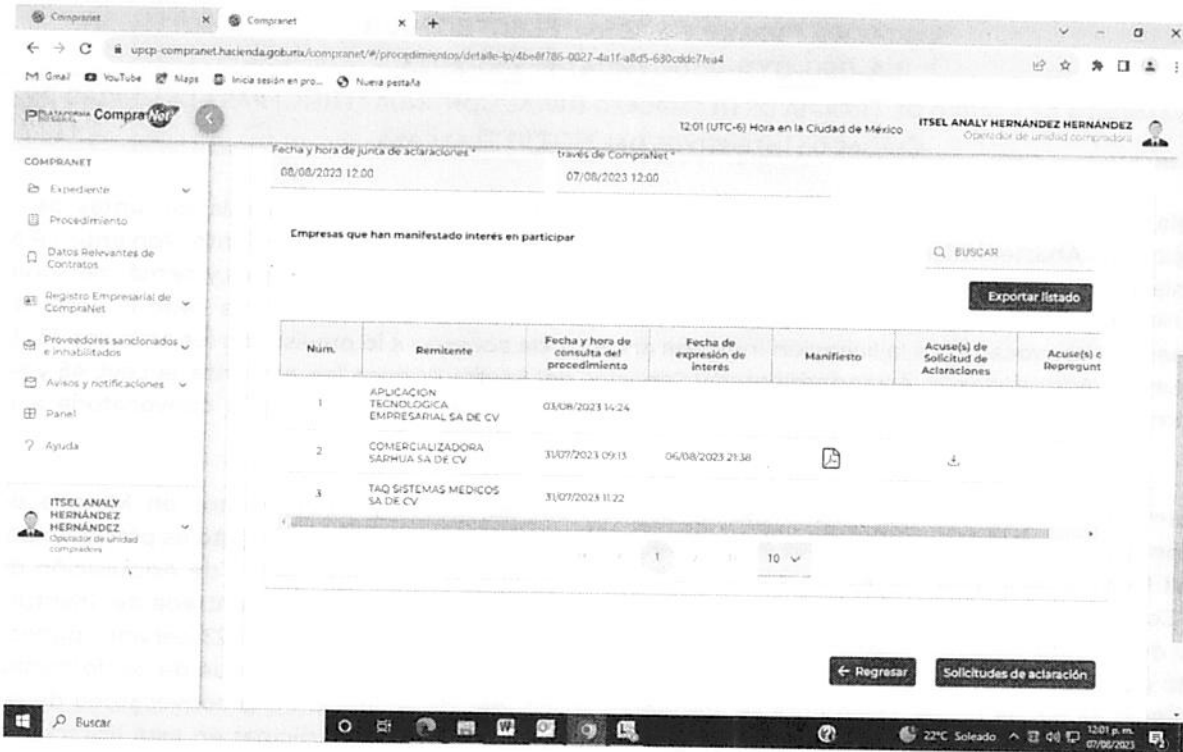


Table with 4 columns: No., NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL, FORMA DE PRESENTACIÓN, No. De PREGUNTAS. Row 1: 1, COMERCIALIZADORA SARHUA, S.A. DE C.V., Electrónica, 16

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

Licitante: COMERCIALIZADORA SARHUA, S.A. DE C.V.

Table with 4 columns: PREGUNTA, PUNTO O NUMERAL, ACLARACIÓN, RESPUESTA IMSS. Row 1: 1, ANEXO NÚMERO 1 (UNO), DICE: NUMERAL 5.2.- UMBRAL DE ALARMA DE SANGRE, PRESIÓN DE RETORNO POSITIVA O VENOSA FUERA DE ESCALA DE +15 A +350 MMHG. INCREMENTOS 5 MMHG. Se acepta su solicitud, lo anterior sin ser obligatorio para los demás licitantes.





		PROGRAMABLES EN PANTALLA" , TODA VEZ QUE ES UN INTERVALO ADECUADO Y ESTO PERMITE AL USUARIO SELECCIONAR A TRAVES DE ESTE MODO LOS INCREMENTOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES PROPIAS DE CADA PACIENTE LA PROGRAMACIÓN REQUERIDA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
2	ANEXO NÚMERO 1 (UNO). "DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".	DICE: NUMERAL 5.3.- UMBRAL DE ALARMA DE INFORMACIÓN, FILTRO COAGULADO DE +10 A +450 MMHG MAYOR QUE CAÍDA DE PRESIÓN INICIAL DEL FILTRO CON INCREMENTOS DE 10 MMHG. PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR "5.3.- UMBRAL DE ALARMA DE INFORMACIÓN, FILTRO COAGULADO DE +30 A +600 MMHG MAYOR QUE CAÍDA DE PRESIÓN INICIAL DEL FILTRO CON INCREMENTOS PROGRAMABLES EN LA PANTALLA DEL EQUIPO", ESTO PERMITE AL USUARIO SELECCIONAR A TRAVES DE ESTE MODO LOS INCREMENTOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES PROPIAS DE CADA PACIENTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Se acepta su solicitud, lo anterior sin ser obligatorio para los demás licitantes.
3	ANEXO NÚMERO 1 (UNO). "DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".	DICE: 5.1.- UMBRAL DE ALARMA DE SANGRE, PRESIÓN DE ENTRADA O ARTERIAL NEGATIVA FUERA DE ESCALA DE -10 A -250 MMHG CON INCREMENTOS DE 5 MMHG. PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "5.1.- UMBRAL DE ALARMA DE SANGRE, PRESIÓN DE ENTRADA O ARTERIAL NEGATIVA FUERA DE ESCALA DE -30 A +300 MMHG CON INCREMENTOS PROGRAMABLES EN PANTALLA" , TODA VEZ QUE ES UN INTERVALO ADECUADO Y ESTO PERMITE AL USUARIO SELECCIONAR A TRAVES DE ESTE MODO LOS INCREMENTOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES PROPIAS DE CADA PACIENTE LA PROGRAMACIÓN REQUERIDA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Se acepta su solicitud, lo anterior sin ser obligatorio para los demás licitantes.
4	ANEXO NÚMERO 1 (UNO). "DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".	DICE: NUMERAL 5.4.- LÍMITE DE SEGURIDAD DE EXCESO PÉRDIDA O GANANCIA DE LÍQUIDO DEL PACIENTE DENTRO DEL RANGO DE 50 A 400 ML CON INCREMENTO DE 10 ML. PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR "5.4.- LÍMITE DE SEGURIDAD DE EXCESO PÉRDIDA O GANANCIA DE LÍQUIDO DEL PACIENTE DENTRO DEL RANGO DE 130 A 400 ML CON INCREMENTO PROGRAMABLE EN LA PANTALLA DEL EQUIPO", ESTO PERMITE AL USUARIO SELECCIONAR A TRAVES DE ESTE MODO LOS INCREMENTOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES PROPIAS DE CADA PACIENTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Se acepta su solicitud, lo anterior sin ser obligatorio para los demás licitantes.
5	ANEXO NÚMERO 1 (UNO). "DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".	DICE: NUMERAL 5.7.- VOLUMEN DE SUMINISTRO DEL BOLO ANTICOAGULANTE DE 0,5 A 10.0 ML CON INCREMENTO DE 0,1 ML. PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO: "5.7.- VOLUMEN DE SUMINISTRO DEL BOLO ANTICOAGULANTE DE 0.1 A 20.0 ML, CON INCREMENTO	Se acepta su solicitud, lo anterior sin ser obligatorio para los demás licitantes.



Handwritten marks and signatures



		PROGRAMABLE EN LA PANTALLA DEL EQUIPO", ESTO PERMITE AL USUARIO SELECCIONAR A TRAVES DE ESTE MODO LOS INCREMENTOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES PROPIAS DE CADA PACIENTE ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
6	ANEXO NÚMERO 1 (UNO). "DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".	DICE: NUMERAL 5.10.- FLUJO DE LA SOLUCIÓN DE REINYECCIÓN EN CVVH, SCUF, CVVHD, CVVHF DENTRO DEL RANGO DE 0 A 8000 ML/H CON INCREMENTOS DE 10 A 50 ML/H O EQUIVALENTE EN MINUTOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO: "5.10 FLUJO DE LA SOLUCIÓN DE REINYECCIÓN EN CVVH, SCUF, CVVHD, CVVHF DENTRO DEL RANGO DE 0 A 4500 ML/H CON INCREMENTOS PROGRAMABLES EN LA PANTALLA DEL EQUIPO", ESTO PERMITE AL USUARIO SELECCIONAR A TRAVES DE ESTE MODO LOS INCREMENTOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES PROPIAS DE CADA PACIENTE ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Se acepta su solicitud, lo anterior sin ser obligatorio para los demás licitantes.
7	ANEXO NÚMERO 1 (UNO). "DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".	DICE: NUMERAL 5.11.- FLUJO DEL LÍQUIDO DE DIÁLISIS DENTRO DEL RANGO DE 0 A 8000 ML/H CON INCREMENTOS DE 50 ML/H O EQUIVALENTE EN MINUTOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO: "5.11.- FLUJO DEL LÍQUIDO DE DIÁLISIS DENTRO DEL RANGO DE 0 O 0.5 A 12 L/H CON INCREMENTOS PROGRAMABLES EN LA PANTALLA DEL EQUIPO", ESTO PERMITE AL USUARIO SELECCIONAR A TRAVES DE ESTE MODO LOS INCREMENTOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES PROPIAS DE CADA PACIENTE ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Se acepta su solicitud, lo anterior sin ser obligatorio para los demás licitantes.
8	ANEXO NÚMERO 1 (UNO). "DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".	DICE: NUMERAL 6.1.2.- INCREMENTOS DE FLUJO DENTRO DEL RANGO DE 2 A 10 ML/MIN. PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO: "6.1.2.- INCREMENTOS DE FLUJO PROGRAMABLES EN LA PANTALLA DEL EQUIPO", ESTO PERMITE AL USUARIO SELECCIONAR A TRAVES DE ESTE MODO LOS INCREMENTOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES PROPIAS DE CADA PACIENTE ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Se acepta su solicitud, lo anterior sin ser obligatorio para los demás licitantes.
9	ANEXO NÚMERO 1 (UNO). "DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".	DICE: NUMERAL 8.1.2.- INCREMENTOS DE FLUJO DE 0.1 ML/H. PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO: "8.1.2.- INCREMENTOS DE FLUJO PROGRAMABLES EN LA PANTALLA DEL EQUIPO", ESTO PERMITE AL USUARIO SELECCIONAR A TRAVES DE ESTE MODO LOS INCREMENTOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES PROPIAS DE CADA PACIENTE ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Se acepta su solicitud, lo anterior sin ser obligatorio para los demás licitantes.
10	ANEXO NÚMERO 1 (UNO). "DESCRIPCIÓN	DICE: NUMERAL 5.6.- FLUJO DE SUMINISTRO CONTINUO DE ANTICOAGULANTE DENTRO DEL RANGO DE 0,5 A 20 ML/H CON INCREMENTO DE 0,1 ML/H.	Se acepta su solicitud, lo anterior sin ser obligatorio para los demás licitantes.



	DETALLADA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".	PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO: "5.6.- FLUJO DE SUMINISTRO CONTINUO DE ANTICOAGULANTE DENTRO DEL RANGO DE 0,1 A 30 ML/H CON INCREMENTO PROGRAMABLE EN LA PANTALLA DEL EQUIPO", ESTO PERMITE AL USUARIO SELECCIONAR A TRAVES DE ESTE MODO LOS INCREMENTOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES PROPIAS DE CADA PACIENTE ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
11	ANEXO NÚMERO 1 (UNO). "DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".	DICE: NUMERAL 5.9.- FLUJO SANGUÍNEO DENTRO DEL RANGO DE 10 A 450 ML/MIN CON INCREMENTOS DE 2 A 19 ML/MIN. PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO: "5.9.- FLUJO SANGUÍNEO DENTRO DEL RANGO DE 30 A 450 ML/MIN CON INCREMENTOS PROGRAMABLES EN LA PANTALLA DEL EQUIPO", ESTO PERMITE AL USUARIO SELECCIONAR A TRAVES DE ESTE MODO LOS INCREMENTOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES PROPIAS DE CADA PACIENTE ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Se acepta su solicitud, lo anterior sin ser obligatorio para los demás licitantes.
12	ANEXO NÚMERO 1 (UNO). "DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".	DICE: NUMERAL 5.12.- FLUJO DE EXTRACCIÓN DE LÍQUIDOS DEL PACIENTE PARA CRRT (SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF) DENTRO DEL RANGO DE 0 A 2000 ML/H CON INCREMENTOS DE 5 A 10 ML/H O EQUIVALENTE EN MINUTOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO: "5.12.- FLUJO DE EXTRACCIÓN DE LÍQUIDOS DEL PACIENTE PARA CRRT (SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF) DENTRO DEL RANGO DE 0 A 2000 ML/H CON INCREMENTOS PROGRAMABLES EN LA PANTALLA DEL EQUIPO", ESTO PERMITE AL USUARIO SELECCIONAR A TRAVES DE ESTE MODO LOS INCREMENTOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES PROPIAS DE CADA PACIENTE ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Se acepta su solicitud, lo anterior sin ser obligatorio para los demás licitantes.
13	ANEXO NÚMERO 1 (UNO). "DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".	DICE: NUMERAL 6.2.2.- INCREMENTOS DE FLUJO DE 10 A 50 ML/H. PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO: "6.2.2.- INCREMENTOS DE FLUJO PROGRAMABLES EN LA PANTALLA DEL EQUIPO", ESTO PERMITE AL USUARIO SELECCIONAR A TRAVES DE ESTE MODO LOS INCREMENTOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES PROPIAS DE CADA PACIENTE ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?.	Se acepta su solicitud, lo anterior sin ser obligatorio para los demás licitantes.
14	ANEXO NÚMERO 1 (UNO). "DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".	DICE: NUMERAL 6.3.2.- INCREMENTOS DE FLUJO DE 50 ML/H PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO: "6.3.2.- INCREMENTOS DE FLUJO PROGRAMABLES EN LA PANTALLA DEL EQUIPO", ESTO PERMITE AL USUARIO SELECCIONAR A TRAVES DE ESTE MODO LOS INCREMENTOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES PROPIAS DE CADA PACIENTE ¿SE ACEPTA NUESTRA	Se acepta su solicitud, lo anterior sin ser obligatorio para los demás licitantes.

FO CON08/ 5





15	ANEXO NÚMERO 1 (UNO). "DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".	SOLICITUD? DICE: NUMERAL 6.4.3.- INCREMENTOS DE FLUJO DENTRO DEL RANGO DE 5 A 10 ML/H. PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO: "6.4.3.- INCREMENTOS DE FLUJO PROGRAMABLES EN LA PANTALLA DEL EQUIPO", ESTO PERMITE AL USUARIO SELECCIONAR A TRAVES DE ESTE MODO LOS INCREMENTOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES PROPIAS DE CADA PACIENTE ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Se acepta su solicitud, lo anterior sin ser obligatorio para los demás licitantes.
16	ANEXO NÚMERO 1 (UNO). "DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".	DICE: NUMERAL 7.3.- INCREMENTOS DE FLUJO DE 0.1 ML/H. PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO: "7.3.- INCREMENTOS DE FLUJO PROGRAMABLES EN LA PANTALLA DEL EQUIPO", ESTO PERMITE AL USUARIO SELECCIONAR A TRAVES DE ESTE MODO LOS INCREMENTOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES PROPIAS DE CADA PACIENTE ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Se acepta su solicitud, lo anterior sin ser obligatorio para los demás licitantes.

Se informa a los licitantes que cuentan con un plazo de 6 horas para formular y entregar por Compra Net 2023, las preguntas que considere necesarias en relación con las respuestas emitidas, contadas a partir de la publicación de la presente acta en el portal; mismas a las que se les dará contestación el día 09 de agosto del año 2023 a las 12:00 horas, en el portal CompraNet 2023.


En la Ciudad de Tlaxcala, Tlax, siendo las 12:00 horas, del día 09 de agosto de 2023, en la sala de juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, con ubicación en Av. Libramiento Poniente I.P.N. S/N, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala. C.P. 90110; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de continuar con la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro.

El acto es presidido por **Lic. Ángel Hebert Mejorado Torres**, en su carácter de Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, en términos del oficio no. 309001050100/537/2023

Se hace de conocimiento que el licitante **OBEA, SA. DE C.V** realizó repreguntas a la convocatoria; sin embargo al haber sido recibidas fuera del tiempo señalado, con fundamento en el artículo 33 Bis de la Ley, se consideran extemporáneas, lo que se advierte de la pantalla inserta a continuación en la que se puede corroborar la fecha y hora en que fue presentado el manifiesto de interés y sus repreguntas:

FO
CON08/ 6 8



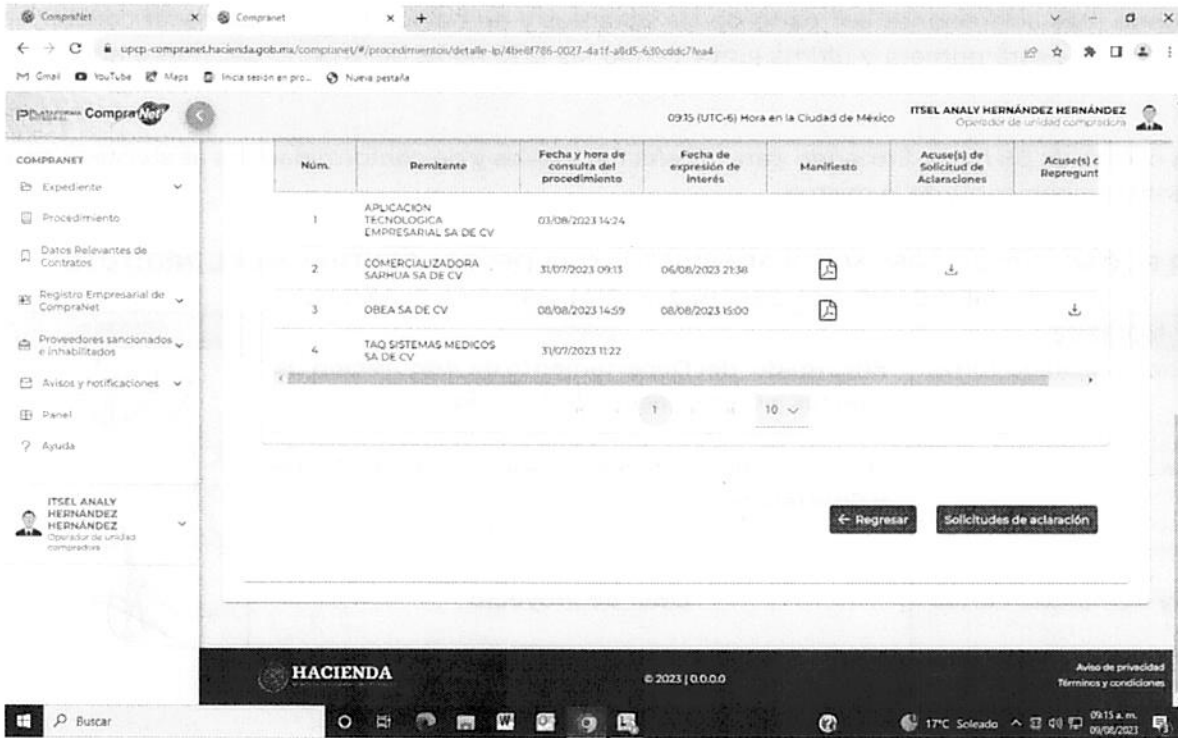

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, en este acto se da a conocer el calendario de los eventos subsecuentes de esta licitación, que a continuación se detalla:

EVENTO	FECHA	HORA
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	15 de agosto de 2023	12:00 hrs.
Comunicación y entrega de Fallo	23 de agosto de 2023	12:00 hrs.

Se hace constar en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx> para efectos de su notificación. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en: la en Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento con ubicación temporal en Salón El Telar del Centro Vacacional IMSS Trinidad, sito en Avenida del Trabajo S/N, Santa Cruz, Tlaxcala, C.P. 90640; un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

Handwritten signature and stamp: FO CONOB/7





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



**ÓRGANO DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL TLAXCALA**

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Depto. de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta primera y última junta siendo las 12:10 horas del mismo día, mes y año de su inicio.

Esta Acta consta de 08 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este acto quienes reciben copia de la misma.

**POR EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ESTATAL TLAXCALA**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Ángel Hebert Mejorado Torres	Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios , en términos del oficio no. 309001050100/537/2023.	
Gema José Mendoza	Encargada de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios , en términos del oficio no.309001050100/142 BIS/2023.	
Itsel Analy Hernández Cortés	Líder de Proyecto	

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
NO ASISTIO REPRESENTACIÓN**

**POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS
NO ASISTIO REPRESENTACIÓN**

----- FIN DEL ACTA -----

