



ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BTLC ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-050GYR055-E395-2022

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, 2022, REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE "SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. ANTONIO FRAGA MOURET" DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA CIUDAD DE MÉXICO DIRECCION DE LA U.M.A.E. DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO OFICINA DE ADQUISICIONES

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DIEZ HORAS, DEL DÍA SIETE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, EN LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. ANTONIO FRAGA MOURET" CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA CALLE DE SERIS Y ZAACHILA, SIN NÚMERO, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02990, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INDICADA AL RUBRO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY) Y 45 Y 46 FRACCIÓN II DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL NUMERAL (3.3) TRES PUNTO TRES DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

ESTE ACTO FUE PRESIDIDO POR EL C. GABRIEL HIDALGO JIMÉNEZ, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. ANTONIO FRAGA MOURET" CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA DEL TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, QUIEN AL INICIO DE ESTA JUNTA, COMUNICÓ QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, SOLAMENTE SE ATENDERÁN LAS PREGUNTAS EN RELACIÓN A LA ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO O SOLICITUD A TRAVÉS DE COMPRANET, DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO PARA ESTOS POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO.

1

EL ACTO, FUE ASISTIDO POR LOS REPRESENTANTES DEL ÁREA TÉCNICA, ING. JORGE RODRÍGUEZ CHÁVEZ, JEFE DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA, ADSCRITO A ESTA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, "DR. ANTONIO FRAGA MOURET", DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, DARÁ CONTESTACIÓN A LAS RESPUESTAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y EL LIC. VICTOR ALAÑA CASTRO, SOLVENTARÁ LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER LEGAL-ADMINISTRATIVO, EN CONJUNTO CON EL LIC. AUGUSTO ELÍAS PERALTA ÁLVAREZ, JEFE DE LA DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA UMAE, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE, DIÓ INICIO AL PRESENTE ACTO, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY Y 46 FRACCIÓN II DE SU REGLAMENTO, EN DONDE SE DARÁ RESPUESTAS A LOS LICITANTES QUE FORMULARÓN PREGUNTAS CON RESPECTO A LA CONVOCATORIA QUE RIGE ESTE EVENTO LICITATORIO, CONFORME A LO SIGUIENTE:

Handwritten signatures and initials in blue ink.






UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
'DR. ANTONIO FRAGA MOURET'
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BTLC ELECTRÓNICA,
NÚMERO LA-050GYR055-E395-2022

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, 2022, REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE 'SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL

Table with 4 columns: N°, NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL, PRESENTACIÓN, and NÚMERO DE PREGUNTAS. It lists 8 companies and their respective number of questions.

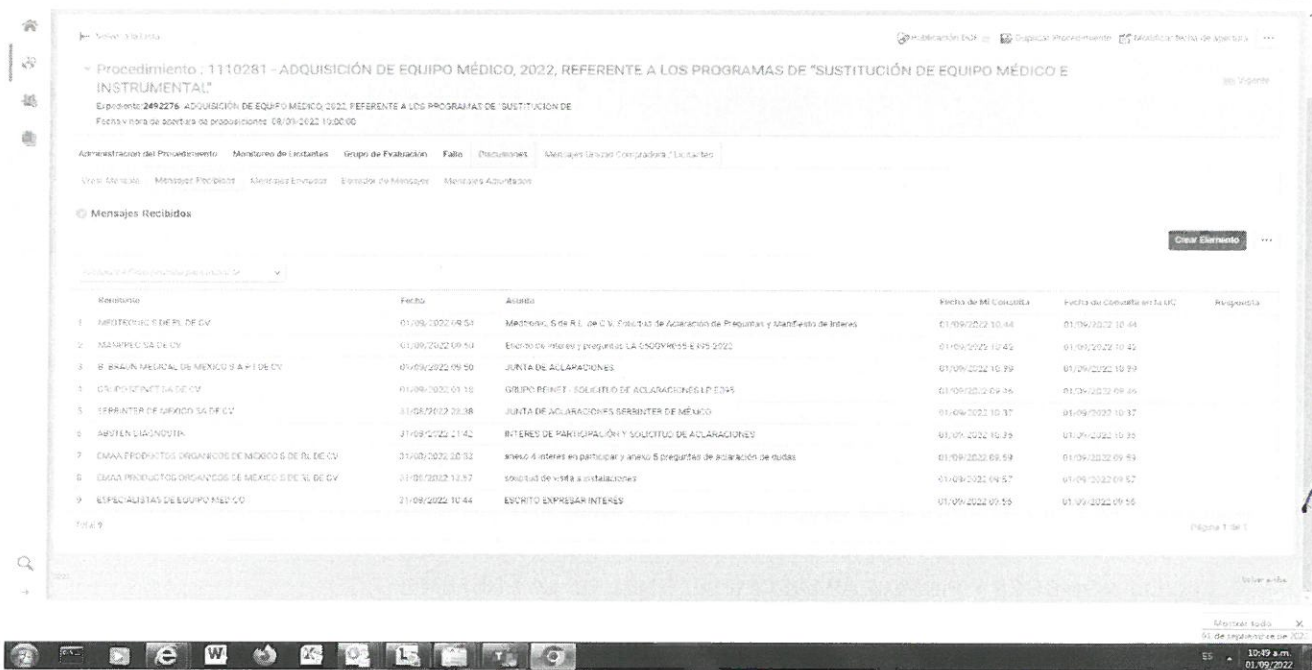

Handwritten blue mark resembling a stylized '2' or 'D'.

2

Handwritten blue scribble.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LAASSP, 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO, Y AL NUMERAL 3.3 (TRES PUNTO TRES) DE LA CONVOCATORIA, QUE RIGE ESTE EVENTO LICITATORIO, LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE LOS LICITANTES EN COMENTO, FUERON RECIBIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO 'COMPRANET', CONFORME AL PLAZO PREVISTO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A EMITIR LAS PRECISIONES DE LA CONVOCANTE, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS, CONFORME SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:





UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
DR. ANTONIO FRACA MOURET
DEL CENTRO MEDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MEXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES

[Handwritten signature]

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BTLC ELECTRONICA,
NUMERO LA-050GYR055-E395-2022
OBJETO DE LA CONTRATACION: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, 2022, REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE SUSTITUCION DE EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL

ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE

PRECISION N° 1.- DICE:

PARTIDA: 1. LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED.

PUNTO 1.15.5 ZOOM DE LA CAMARA EN CASO DE CONTAR CON ALGUNA.

DEBE DECIR:

PARTIDA 1 LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED

SE ELIMINA EL PUNTO 1.15.5.

PRECISION N° 2.- DICE:

PARTIDA: 3. CRANEOTOMO ELÉCTRICO.

PUNTO 1.6. PROTECTOR DE DURA

PUNTO 1.6.1. ADULTO.

PUNTO 1.6.2. PEDIÁTRICO.

PUNTO 1.7 CON CABEZAL DE:

PUNTO 1.7.1 PERFORACION

PUNTO 1.7.2 OSCILACION.

PUNTO 1.7.3 COLOCACION DE CLAVOS, AGUJAS Y FRESADO.

DEBE DECIR:

PRECISION N° 3: PARTIDA: 3. CRANEOTOMO ELÉCTRICO.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]





UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
DR. ANTONIO FRAGA MOURET
DEL CENTRO MEDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MEXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES

[Handwritten signature]

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BTLC ELECTRONICA,
NUMERO LA-050GYR055-E395-2022

OBJETO DE LA CONTRATACION: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, 2022, REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE SUSTITUCION DE EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL

PUNTO 1.6. PROTECTOR DE DURA

PUNTO 1.6.1. ADULTO.

PUNTO 1.6.2. SE ELIMINA ESTE PUNTO.

PUNTO 1.7 MOTOR DE BAJA VELOCIDAD O REDUCTOR DE VELOCIDAD O CABEZAL PARA:

PUNTO 1.7.1 PERFORACION O TREPANACION.

PUNTO 1.7.2 SE ELIMINA EL PUNTO.

PUNTO 1.7.3 SE ELIMINA EL PUNTO.

PRECISION N° 4.- Dice:

PARTIDA: 3. CRANEOTOMO ELÉCTRICO

PUNTO 2.4. PIEZA DE MANO CON ADAPTADOR HUDSON.

PUNTO 2.4.1 BROCA INICIADORA REUTILIZABLE (PARA TREPANACION), ESTERILIZABLE CON CUATRO PIEZAS DE: (INCLUIR MARCA, MODELO Y NUMERO DE PARTE).

PUNTO 2.4.1.1 DIAMETRO DE 15 MM.

PUNTO 2.4.1.2 DIAMETRO DE 12 MM.

PUNTO 2.4.1.3 DIAMETRO DE 9 MM.

PUNTO 2.4.1.4 DIAMETRO DE 6 MM.

PUNTO 2.4.2 MICROSIERRA OSCILANTE, CON ADPATADOR.

PUNTO 2.4.3 MICROSIERRA SAGITAL, CON ADPATADOR.

PUNTO 2.4.4 MICROSIERRA RECIPROCANTE, CON ADPATADOR.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]





UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
'DR. ANTONIO FRAGA MOURET'
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES

[Handwritten signature]

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BTLC ELECTRÓNICA,
NÚMERO LA-050GYR055-E395-2022

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO
MÉDICO, 2022, REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE
'SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL

Debe decir:

PARTIDA: 3. CRANEOTOMO ELÉCTRICO

PUNTO 2.4. SE ELIMINA EL PUNTO.

PUNTO 2.4.1 SE ELIMINA EL PUNTO.

PUNTO 2.4.1.1 SE ELIMINA EL PUNTO.

PUNTO 2.4.1.2 SE ELIMINA EL PUNTO.

PUNTO 2.4.1.3 SE ELIMINA EL PUNTO.

PUNTO 2.4.1.4 SE ELIMINA EL PUNTO.

PUNTO 2.4.2 SE ELIMINA EL PUNTO.

PUNTO 2.4.3 SE ELIMINA EL PUNTO.

PUNTO 2.4.4 SE ELIMINA EL PUNTO.

PUNTO 2.5 CHAROLA PARA ESTERILIZACIÓN.

PRECISIÓN N° 5: DICE:

PARTIDA: 3. CRANEOTOMO ELÉCTRICO

3.1 FRESAS CORTANTES ROSEN 3MM DE DIAMETRO, (10 PIEZAS).

3.2 FRESAS CORTANTES ROSEN 4MM DE DIAMETRO, (10 PIEZAS).

3.3 FRESAS CORTANTES ROSEN 5MM DE DIAMETRO, (10 PIEZAS).

3.4 FRESAS CORTANTES ROSEN 6MM DE DIAMETRO, (10 PIEZAS).

[Handwritten signature]





UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
DR. ANTONIO FRAGA MOURET
DEL CENTRO MEDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MEXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES

Handwritten signature

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BTLC ELECTRONICA,
NUMERO LA-050GYR055-E395-2022

OBJETO DE LA CONTRATACION: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, 2022, REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE SUSTITUCION DE EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL

3.5 FRESAS DE DIAMANTE 2MM, (10 PIEZAS).

3.6 FRESAS DE DIAMANTE 3MM, (10 PIEZAS).

3.7 FRESAS DE DIAMANTE 4MM, (10 PIEZAS).

3.8 FRESAS ESPIRAL DE 2MM DE DIAMTERO, (10 PIEZAS).

3.9 FRESAS ESPIRAL DE 3MM DE DIAMTERO, (10 PIEZAS).

DEBE DECIR:

PARTIDA: 3. CRANEOTOMO ELÉCTRICO

3.1 FRESAS CORTANTES ROSEN 3MM DE DIAMETRO, (10 PIEZAS).

3.2 SE ELIMINA EL PUNTO.

3.3 FRESAS CORTANTES ROSEN 5MM DE DIAMETRO, (10 PIEZAS).

3.4 SE ELIMINA EL PUNTO.

3.5 FRESAS DE DIAMANTE 2MM, (10 PIEZAS).

3.6 SE ELIMINA EL PUNTO.

3.7 FRESAS DE DIAMANTE 4MM, (10 PIEZAS).

3.8 SE ELIMINA EL PUNTO.

3.9 SE ELIMINA EL PUNTO.

3.10 SIERRAS DE CORTE LATERAL PARA PROTECTOR DE DURA ADULTO, (10 PIEZAS).

3.11 BROCA INICIADORA DESECHABLE PARA TREPANACION 12/15 MM (10 PIEZAS).

3.12 LUBRICANTE PARA PIEZAS DE MANO (5 PIEZAS).

Handwritten mark

Handwritten marks

Handwritten mark





UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
'DR. ANTONIO FRAGA MOURET'
DEL CENTRO MEDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MEXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES

[Handwritten signature]

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BTLC ELECTRONICA,
NUMERO LA-050GYR055-E395-2022

OBJETO DE LA CONTRATACION: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, 2022, REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE 'SUSTITUCION DE EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL

PRECISION N° 6: EL LICITANTE PARTICIPANTE DEBERA REQUISITAR EL SIGUIENTE FORMATO:

CARTA DE CONFLICTO DE INTERES

CIUDAD DE MEXICO A DE DE 2022

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, 'DR. ANTONIO FRAGA MOURET'
DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA
CIUDAD DE MEXICO
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES
PRESENTE

PROCEDIMIENTO NUMERO: XX-050GYR055-EXXX-20XX

C. xxxxxxxxxxxxxxxx, representante legal de xxxxxxxxxxxxxxxx, manifiesto bajo protesta de decir verdad que de conformidad con la fracción IX del artículo 49 de la LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, no desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público, y por lo tanto con la formalización de mi contrato correspondiente, no se actualiza un conflicto de interés.

Al estar constituido como persona moral manifestamos que ninguno de nuestros socios o accionistas se encuentran señalados en el artículo antes mencionado.

7

Asimismo, me comprometo a informar oportunamente a esta Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades 'Dr. Antonio Fraga Mouret', Centro Médico Nacional La Raza, Ciudad de México, cualquier impedimento o conflicto de intereses de tipo profesional o contractual derivado de esta declaración o cualquier otro que sea de mi conocimiento, y observar las instrucciones dadas por escrito para su atención, tramitación y resolución.

Acepto que esta declaración es un compromiso con la XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y conozco las disposiciones legales, reglamentarias y éticas que rigen el actuar de los servidores públicos. Así como los alcances y consecuencias de mi incumplimiento.

RELACION DE ACCIONISTAS:

- 1.
2.

PROTESTO LO NECESARIO
C.XXXXX XXXX XXXX
REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO LEGAL

NOTA: EL NO REQUISITARLO SERA CAUSAL DE DESCALIFICACION

[Handwritten signature]





UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
'DR. ANTONIO FRAGA MOURET'
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES

Handwritten signature

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BTLC ELECTRÓNICA,
NÚMERO LA-050GYR055-E395-2022

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO
MÉDICO, 2022, REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE
'SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL

CONTESTACIÓN LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES

NOMBRE DEL LICITANTE: EMAA PRODUCTOS ORGÁNICOS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Table with 4 columns: N°, PUNTO ESPECIFICO Y DESCRIPCIÓN, SOLICITUD DE ACLARACIÓN, and RESPUESTA. It contains 4 rows of questions and answers regarding importation requirements, sanitary registration, and warranty periods.

8





**ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BTLC ELECTRÓNICA,  
NÚMERO LA-050GYR055-E395-2022**

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO  
MÉDICO, 2022, REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE  
"SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL**

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA  
CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCION DE LA U.M.A.E.  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
OFICINA DE ADQUISICIONES

	MÉDICO			CORRECTIVOS INCLUIDOS.
		DICHA GARANTÍA A 42 O 48 MESES, MISMA QUE SERÁ EXIGIBLE POR EL INSTITUTO A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO Y HASTA EL CUMPLIMIENTO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE.	PORCENTAJES LA CUAL NO ES EL CASO DE ESTE PROCEDIMIENTO, CON EL FIN DE PRESENTAR UN PRECIO COMPETITIVO QUE CUBRA LAS GARANTÍAS DEL PRESENTE PROCESO.	
5	PARTIDA 1 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED 1.6	ENSAMBLADO DE LA CÚPULA DE POLICARBONATO RESISTENTE AL ALTO IMPACTO.	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENSAMBLADO DE LA CÚPULA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO RESISTENTE AL ALTO IMPACTO, LO CUAL ES SUPERIOR A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
6	PARTIDA 1 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED 1.7	TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE DE 4300°K O MENOR A 5500°K O MAYOR	PARA CONTAR CON LA MEJOR TECNOLOGÍA DE EQUIPOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE DE 3500 A 5000°K. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
7	PARTIDA 1 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED 1.11	IRRADIANCIA 500 W/M2	ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO PODREMOS OFERTAR IRRADIANCIA DE POR LO MENOS 500 W/M2, SIEMPRE Y CUANDO NO SOBREPASE LOS 600 W/M2. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO.
8	PARTIDA 1 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED 1.13	ILUMINACIÓN AMBIENTAL DE COLOR VERDE IGUAL O MENOR A 500 LX.	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ILUMINACIÓN AMBIENTAL DE COLOR BLANCO DE MÁXIMO 100 LUXES EN CADA CABEZAL CON CONTROL INDEPENDIENTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA.
9	PARTIDA 1 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED 1.14.5	CABEZAL CERRADO CON SUPERFICIE EXTERNA LISA, SIN BORDES, NI TORNILLOS, NI HENDIDURAS, PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CABEZALES COMPUESTO POR MÓDULOS CON 20 LEDS CADA UNO, CON SUPERFICIE EXTERNA LISA, SIN BORDES, NI TORNILLOS, NI HENDIDURAS, PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
10	PARTIDA 1 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED 1.15.3	AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE INTENSIDAD LUMINOSA EN RANGO DE 10 AL 100 POR CIENTO.	PEDIMOS AMABLEMENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO NOS PERMITA OFERTAR INTENSIDAD LUMINOSA REGULABLE EN 9 PASOS HASTA UN MÁXIMO DE 160,000 LUXES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
11	PARTIDA 1 LÁMPARA QUIRÚRGICA	UN DISEÑO DE SUPERFICIES LISAS PARA UNA HIGIENE PERFECTA COMPATIBLE CON FLUJO LAMINAR GENERANDO UNA	ESTA CARACTERÍSTICA ES PROPIA DE UN LICITANTE, POR LO QUE LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE	LA CARACTERISTICA NO ES PROPIA DE UN LICITANTE. SE ACEPTA CON DISEÑO DE SUPERFICIES LISAS PARA

9





ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BTLC ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-050GYR055-E395-2022

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, 2022, REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE "SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. ANTONIO FRAGA MOURET" DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA CIUDAD DE MÉXICO DIRECCION DE LA U.M.A.E. DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO OFICINA DE ADQUISICIONES

Handwritten signature

Table with 5 columns: Item ID, Description, Technical Specification, Question/Request, and Answer. Rows 12-18 detail technical specifications for surgical lamps and their responses.

10





**ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BTLC ELECTRÓNICA,  
NÚMERO LA-050GYR055-E395-2022**

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO  
MÉDICO, 2022, REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE  
"SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL**

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
"DR. ANTONIO FRACA MOURET"  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA  
CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCION DE LA U.M.A.E.  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
OFICINA DE ADQUISICIONES

*Handwritten signature*

	4.1.2		LÁMPARA PREVIAMENTE INSTALADA. FAVOR DE ACLARAR.	
19	PARTIDA 4 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA 1.5	LONGITUD TOTAL CON EXTENSIÓN DE CABECERA Y PIERNAS DE 210 CM + 20 CM.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA LONGITUD TOTAL CON UNA TOLERANCIA DE +/-5%. LO CUAL NO DEMERITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIN SER CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
20	PARTIDA 4 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA 1.10	MESA DIVIDIDA EN AL MENOS CINCO SECCIONES.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MESA DIVIDIDA EN CUATRO SECCIONES CON UN ELEVADOR DE RIÑÓN PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA COMO ACCESORIO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
21	PARTIDA 4 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA 1.10.3	CON ELEVADOR DE LA REGIÓN LUMBAR O DE RIÑÓN CON SISTEMA ARTICULAR PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR MESA DIVIDIDA EN CUATRO SECCIONES CON UN ELEVADOR DE RIÑÓN PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA COMO ACCESORIO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
22	PARTIDA 4 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA 1.12.1	ELEVACIÓN Y DESCENSO QUE CUBRA EL RANGO DE 70 A 110 CM. ±10 CM. CON RESPECTO AL PISO.	CON EL FIN DE LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ELEVACIÓN Y DESCENSO CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 96.5 CM, CON LO QUE SE ASEGURA UNA ALTURA ERGONÓMICA PARA QUE EL CIRUJANO OPERE DE FORMA CONFORTABLE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
23	PARTIDA 4 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA 1.13.1	DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DEL TABLERO DE 30 CM O MAYOR (HACIA LA SECCIÓN DE LA CABECERA) O.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE POR LO MENOS 23 CM CON LO QUE SE CUENTA UN ACCESO ÓPTIMO PARA LA TOMA DE RAYOS X. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
24	PARTIDA 4 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA 1.14.1	SISTEMA DE EMERGENCIA DE FORMA HIDRÁULICA (POR MEDIO DE BOMBEO), PARA AJUSTAR TODAS LAS POSICIONES DE LA MESA EN CASO DE FALLA DE BATERÍAS, FALLO ELÉCTRICO Y/O EL CONTROL DE MANDO.	DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBE OFERTAR UNO DE LOS SISTEMAS MENCIONADOS EN ESTE PUNTO Y EN EL PUNTO 1.14 Y EL NO OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE DEBE OFERTAR AL MENOS UNO DE LOS DOS SISTEMAS.
25	PARTIDA 4 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA 2.9	PIERNERAS ARTICULADAS TIPO GOEPEL, ACOJINADAS CON FIJADORES. (2 PIEZAS). (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO)	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN SOPORTE DE PIERNAS NEUMÁTICAS PARA LA POSICIÓN DE LITOTOMÍA, EL CUAL ES UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR AL PERMITIR LA MANIPULACIÓN DE LAS PIERNAS DEL PACIENTE SIN NINGÚN ESFUERZO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SE SOLICITA PIERNERAS ARTICULADAS TIPO GOEPEL, ACOJINADAS CON FIJADORES.
26	PARTIDA 4 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA	CHAROLA PORTA CHASIS DE 35 X 43 CM (14 X 17 PULGADAS). (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO).	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN SOPORTE PARA CHASIS CON FIJACIÓN AL RIEL LATERAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO PERMITA COLOCAR EL CHASIS DE 35X 43 (14 X 17 PULGADAS).





**ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BTLC ELECTRÓNICA,  
NÚMERO LA-050GYR055-E395-2022**

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO  
MÉDICO, 2022, REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE  
"SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL**

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA  
CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCION DE LA U.M.A.E.  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
OFICINA DE ADQUISICIONES

	2.10			
27	PARTIDA 4 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA 2.11	CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE 24, INCLUIDA EN LA MESA EN LA SECCIÓN DE PELVIS. ÚTIL PARA LA RECOLECCIÓN DE LÍQUIDOS DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, LA CUAL DEBE SER DESMONTABLE PARA SU DESCONTAMINACIÓN. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO).	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, NOS PERMITA REFERENCIAR SOLO COMO ACERO INOXIDABLE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?.	SE ACEPTA REFERENCIAR CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE SIEMPRE Y CUANDO SEA INCLUIDA EN LA MESA EN LA SECCIÓN DE PELVIS, ÚTIL PARA LA RECOLECCIÓN DE LÍQUIDOS DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, LA CUAL DEBE SER DESMONTABLE PARA SU DESCONTAMINACIÓN. (INCLUIR MARCA Y MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO).
28	3. CRANEOTOMO ELECTRICO 1.1	INSTRUMENTAL MÉDICO DE CORTE CRANEÓTOMO ELÉCTRICO QUE FUNCIONE, MEDIANTE CORRIENTE ELÉCTRICA O BATERÍAS. EQUIPO PARA TREPANOTOMÍA Y CRANEOTOMÍA.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CRANEOTOMO NEUMÁTICO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
29	3. CRANEOTOMO ELECTRICO 1.6, 1.6.1, 1.6.2	PROTECTOR DE DURAMADRE ADULTO Y PEDIÁTRICO.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA OFERTAR GUARDA DE NEURO, TAMAÑO MEDIANO Y PEQUEÑO, QUE ES DESCRIPCIÓN PROPIA DEL FABRICANTE, LO QUE NOS PERMITIRÍA UNA LIBRE PARTICIPACIÓN ENTRE EMPRESAS ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE CONSULTAR ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.
30	3. CRANEOTOMO ELECTRICO 1.7	CON CABEZAL DE:	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PIEZA DE MANO, YA QUE ES MAS DEDICADA QUE UN CABEZAL ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SE SOLICITA CABEZAL DE PERFORACIÓN DE BAJA VELOCIDAD.
31	3. CRANEOTOMO ELECTRICO 1.7.1	PERFORACIÓN	SE ENTIENDE QUE SE REFIERE A LA PIEZA DE MANO RECTA PARA CRANEOTOMÍA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE REFIERE AL MOTOR DE BAJA VELOCIDAD PARA BROCA INICIADORA.
32	3. CRANEOTOMO ELECTRICO 1.7.2	OSCILACIÓN	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA QUE ESTA PIEZA SEA OPCIONAL ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE CONSULTAR ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.
33	3. CRANEOTOMO ELECTRICO 1.7.3	COLOCACIÓN DE CLAVOS, AGUJAS Y FRESADO.	SE ENTIENDE QUE ESTOS ADAPTADORES NO SE REQUIEREN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	FAVOR DE CONSULTAR ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.
34	3. CRANEOTOMO ELECTRICO 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4	RECTA DE 115 MM. DE LONGITUD. RECTA DE 135 MM. DE LONGITUD. ANGULADA DE 125 MM. DE LONGITUD. ANGULADA DE 145 MM. DE LONGITUD.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MEDIDAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE, PARA QUE HAYA UNA LIBRE PARTICIPACIÓN ENTRE EMPRESAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR MEDIDAS SIMILARES PROPIAS DE CADA FABRICANTE.
35	3. CRANEOTOMO ELECTRICO 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4	RECTA DE 115 MM. DE LONGITUD. RECTA DE 135 MM. DE LONGITUD. ANGULADA DE 125 MM. DE LONGITUD. ANGULADA DE 145 MM. DE LONGITUD.	SE ENTIENDE QUE LAS MEDIDAS SOLICITADAS SE TOMAN DESDE LA PIEZA DE MANO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO.
36	3. CRANEOTOMO ELECTRICO 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4	RECTA DE 115 MM. DE LONGITUD. RECTA DE 135 MM. DE LONGITUD. ANGULADA DE 125 MM. DE LONGITUD. ANGULADA DE 145 MM. DE LONGITUD.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA UNA TOLERANCIA DEL 15% EN LAS MEDIDAS SOLICITADAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA. SIN SER CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
37	3. CRANEOTOMO ELECTRICO 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,	RECTA DE 115 MM. DE LONGITUD. RECTA DE 135 MM. DE LONGITUD. ANGULADA DE 125 MM. DE LONGITUD.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SOLO 2 ADAPTADORES DE LOS 4	NO SE ACEPTA.

12





ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BTLC ELECTRÓNICA,  
NÚMERO LA-050GYR055-E395-2022

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: **ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, 2022, REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE "SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL**

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA  
CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCION DE LA U.M.A.E.  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
OFICINA DE ADQUISICIONES

*[Handwritten signature]*

	2.3.4	ANGULADA DE 145 MM. DE LONGITUD.	SOLICITADOS ¿SE ACEPTA?	
38	3. CRANEOTOMO ELECTRICO 2.3.3. 2.3.4	ANGULADA DE 125 MM. DE LONGITUD. ANGULADA DE 145 MM. DE LONGITUD.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SOLO 1 ADAPTADOR DE LOS 2 SOLICITADOS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
39	3. CRANEOTOMO ELECTRICO 2.3.3. 2.3.4	ANGULADA DE 125 MM. DE LONGITUD. ANGULADA DE 145 MM. DE LONGITUD.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PIEZA DE MANO QUE PERMITE LA ANGULACIÓN EN SU CUERPO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SE DEBERAN ENTREGAR
40	3. CRANEOTOMO ELECTRICO 2.4.1	BROCA INICIADORA REUTILIZABLE (PARA TREPANACIÓN), ESTERILIZABLE CON CUATRO PIEZAS DE: (INCLUIR MARCA, MODELO Y NÚMERO DE PARTE).	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BROCA INICIADORA DESECHABLE, YA QUE NOS PERMITE UNA MENOR PROBABILIDAD DE INFECCIONES CRUZADAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA. CONSULTAR ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.
41	3. CRANEOTOMO ELECTRICO 2.4.1. 2.4.1.1. 2.4.1.2. 2.4.1.3. 2.4.1.4	BROCA INICIADORA REUTILIZABLE (PARA TREPANACIÓN), ESTERILIZABLE CON CUATRO PIEZAS DE: (INCLUIR MARCA, MODELO Y NÚMERO DE PARTE). DIÁMETRO DE 15 MM. DIÁMETRO DE 12 MM. DIÁMETRO DE 9 MM. DIÁMETRO DE 6 MM.	ENTENDEMOS QUE SOLICITAN UNA PIEZA DE CADA MEDIDA SOLICITADA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	CONSULTAR ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.
42	3. CRANEOTOMO ELECTRICO 2.4.1.1. 2.4.1.2.	DIÁMETRO DE 15 MM. DIÁMETRO DE 12 MM	SOLICITO AMABLEMENTE NOS PERMITA UNA TOLERANCIA DE +/- 1 MM DE TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS SOLICITADAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
43	3. CRANEOTOMO 2.4.1.4	DIÁMETRO DE 6 MM.	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA	SOLICITAR ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.
44	3. CRANEOTOMO ELECTRICO, 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4	MICROSIERRA OSCILANTE, CON ADAPTADOR. MICROSIERRA SAGITAL, CON ADAPTADOR. MICROSIERRA RECIPROCANTE, CON ADAPTADOR	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PIEZAS DE MANO, YA QUE SON MAS ESPECÍFICOS QUE LOS ADAPTADORES ¿SE ACEPTA?	CONSULTAR ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.
45	3. CRANEOTOMO ELECTRICO 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4	MICROSIERRA OSCILANTE, CON ADAPTADOR. MICROSIERRA SAGITAL, CON ADAPTADOR. MICROSIERRA RECIPROCANTE, CON ADAPTADOR	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SOLO 1 PIEZA DE MANO DE LOS 3 SOLICITADOS ¿SE ACEPTA?	CONSULTAR ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.
46	3. CRANEOTOMO ELECTRICO 2.4.2.	MICROSIERRA OSCILANTE, CON ADAPTADOR.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA SEA OPCIONAL ¿SE ACEPTA?	CONSULTAR ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.
47	3. CRANEOTOMO ELECTRICO 2.4.3.	MICROSIERRA SAGITAL, CON ADAPTADOR.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA SEA OPCIONAL ¿SE ACEPTA?	CONSULTAR ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.

13

**DEL LICITANTE: ABSTEN DISGNOSTIK, S.A. DE C.V.**

N°	NUMERAL ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	SOLICITUD DE ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	39.4.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL-	ENTENDEMOS QUE, AL OFERTAR BIENES DE IMPORTACIÓN, DEBEMOS PRESENTAR EL FORMATO NO. 8. Y QUE LOS FORMATOS NO. 6 Y NO.7 AL NO	SE ACEPTA





UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
DR. ANTONIO FRAGA MOURET
DEL CENTRO MEDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MEXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES

Handwritten signature

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BTLC ELECTRONICA,
NUMERO LA-050GYR055-E395-2022

OBJETO DE LA CONTRATACION: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, 2022, REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE SUSTITUCION DE EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL

Table with 4 columns: N°, NUMERAL ESPECIFICO DE LA CONVOCATORIA, SOLICITUD DE ACLARACION, and RESPUESTA. It contains 7 rows of questions and answers regarding procurement specifications.

14

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark





ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BTLC ELECTRÓNICA,  
NÚMERO LA-050GYR055-E395-2022

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: **ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, 2022, REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE "SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL**

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA  
CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCION DE LA U.M.A.E.  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
OFICINA DE ADQUISICIONES

*(Handwritten signature)*

			CÚPULA EN 360°.	¿SE ACEPTA?	
8	1 LAMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED	1.5.1	VIDA ÚTIL DEL LED DE 60,000 HORAS DE 90% O MAYOR.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UNA VIDA ÚTIL DEL LED DE 50,000 HORAS.	SE ACEPTA.
9	1 LAMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED	1.7	TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE DE 4300°K O MENOR A 5500°K O MAYOR.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UNA TEMPERATURA DE CALOR REGULABLE DE 4300 K O MENOR HASTA 5000 K. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.	SE ACEPTA.
10	1 LAMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED	1.11	IRRADIANCIA 500 W/M2.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UNA IRRADIANCIA DE 560 W/M2.	SE ACEPTA.
11	1 LAMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED	1.13	ILUMINACIÓN AMBIENTAL DE COLOR VERDE IGUAL O MENOR A 500 LX.	ENTENDEMOS QUE AL OFERTAR ILUMINACIÓN AMBIENTAL DE COLOR VERDE DE 10,000 HASTA 30,000 LX. NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, YA QUE ESTO ES UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR A LO SOLICITADO.	SE ACEPTA SIN SER CONDICIONATE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
12	1 LAMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED	1.15.3	AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE INTENSIDAD LUMINOSA EN RANGO DE 10 AL 100 POR CIENTO.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "FUNCIÓN AJUSTABLE DE ILUMINACIÓN POR MANDO EN CÚPULA", YA QUE EL RANGO DE EN PORCENTAJES ES DIFERENTE POR CADA CASA COMERCIAL.	SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
13	1 LAMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED	1.15.5	ZOOM DE LA CÁMARA EN CASO DE CONTAR CON ALGUNA.	ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ MOSTRAR LA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CÁMARA HD. MÁS NO SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PROPUESTA	NO ES CORRECTO. ESTA CARACTERISTICA NO SE SOLICITA. CONSULTAR ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.
14	4 MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA PARA UROLOGIA	1.10.4	PELVIS Y	DERIVADO DE LA TERMINOLOGÍA DEL EQUIPO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR ESTE PUNTO COMO SEAT REFIRIÉNDOSE A PELVIS.	SE ACEPTA SIN SER CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
15	4 MESA QUIRURGICA	1.12.3	QUE PERMITA DAR	DERIVADO DE LA TERMINOLOGÍA DEL	SE ACEPTA SIN SER

15





ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BTLC ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-050GYR055-E395-2022

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, 2022, REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE "SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. ANTONIO FRAGA MOURET" DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA CIUDAD DE MÉXICO DIRECCION DE LA U.M.A.E. DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO OFICINA DE ADQUISICIONES

[Handwritten signature]

Table with 4 columns: Description of equipment (UNIVERSAL AVANZADA PARA UROLOGIA), Position (POSICIÓN DE KRASKE O DE NAVAJA SEVILLANA), Request (EQUIPO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR ESTE PUNTO CON FLEX/REFLEX...), and Response (CONDICIONANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES).

NOMBRE DEL LICITANTE: SERBINTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Table with 4 columns: N°, NUMERAL ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA, SOLICITUD DE ACLARACIÓN, and RESPUESTA. Contains 3 rows of clarification requests and answers.

16

NOMBRE DEL LICITANTE: GRUPO REINET, S.A. DE C.V.

Table with 5 columns: N°, PARTIDA/EQUIPO, NUMERAL ESPECÍFICO DE LA CÉDULA (PUNTO, DESCRIPCIÓN), SOLICITUD DE ACLARACIÓN, and RESPUESTA. Contains 2 rows of clarification requests and answers.





**ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BTLC ELECTRÓNICA,  
NÚMERO LA-050GYR055-E395-2022**

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO  
MÉDICO, 2022, REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE  
"SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL**

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA  
CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCION DE LA U.M.A.E.  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
OFICINA DE ADQUISICIONES

*Handwritten mark*

				¿ES CORRECTO?	
3	PARTIDA 1 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED	PUNTO 1.10	PROFUNDIDAD DEL VOLUMEN DE LUZ DE 105 CM O MAYOR.	PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN SIN REENFOQUE L1+L2 CON 60% EC (CM) DE 65 CM.  ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE SOLICITA PROFUNDIDAD DEL VOLUMEN DE LUZ DE 105 CM O MAYOR.
4	PARTIDA 1 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED	PUNTO: 1.11	IRRADIANCIA 500 W/M2.	PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA IRRADIACIÓN < 600 W/M2 ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA IRRADIANCIA DE 500 W/M2 O MAYOR.
5	PARTIDA 1 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED	PUNTO: 1.13	ILUMINACIÓN AMBIENTAL DE COLOR VERDE IGUAL O MENOR A 500 LX.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL OFERTAR EL MODO DE ENDOSCOPIA, DONDE LA ZONA INTERIOR SE ILUMINA EN VERDE PARA UNA VISUALIZACIÓN DE MAYOR CONTRASTE EN EL MONITOR. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SIN SER CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
6	PARTIDA 1 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED	PUNTO: 1.15.3	AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE INTENSIDAD LUMINOSA EN RANGO DE 10 AL 100 POR CIENTO	PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN AJUSTE DE LA ILUMINANCIA 25 - 100%. ESTA CARACTERÍSTICA NO AFECTA LA PRÁCTICA CLÍNICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA AJUSTE DE ILUMINACIÓN DE 25 A 100 %.
7	PARTIDA 1 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED	PUNTO: 1.15.5	ZOOM DE LA CÁMARA EN CASO DE CONTAR CON ALGUNA	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO SE PODRÁ ENTREGAR CON CÁMARA DE FORMA OPCIONAL.  ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO. NO SE SOLICITA CAMARA, CONSULTAR ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE
8	PARTIDA 1 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED	PUNTO: 1.15.6	UN DISEÑO DE SUPERFICIES LISAS PARA UNA HIGIENE PERFECTA COMPATIBLE CON FLUJO LAMINAR GENERANDO UNA TURBULENCIA MENOR AL 20 % CONFORME NORMATIVA DIN 1946-4.	PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CONSTRUCCIÓN LIGERA DE CARCASA DE ALUMINIO CON FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.  ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA DISEÑO DE SUPERFICIES LISAS PARA FACILITAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
9	PARTIDA 1 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED	PUNTO: 1.15.7 CON	SISTEMA ELECTRÓNICO INTELIGENTE PARA AUMENTAR LA CORRIENTE Y MANTENER ILUMINACIÓN	PREGUNTA: CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE. PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE MANERA OPCIONAL.  ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA.

17





UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA  
CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCION DE LA U.M.A.E.  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
OFICINA DE ADQUISICIONES

*Handwritten mark*

**ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BTLC ELECTRÓNICA,  
NÚMERO LA-050GYR055-E395-2022**

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO  
MÉDICO, 2022, REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE  
"SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL**

			CONSTANTE DURANTE TODO EL PROCEDIMIENTO.		
10	PARTIDA 1 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED	2.2.2.3.	PUNTOS: 2.2 ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIA DE BATERÍAS. 2.3 AUTONOMÍA DE 3 HORAS. 2.3 TIEMPO DE CARGA 14 HORAS.	PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR ESTOS PUNTOS DE MANERA OPCIONAL.  ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
11	PARTIDA 1 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED	2.4	CÁMARA HD	PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE MANERA OPCIONAL.  ¿SE ACEPTA?	NO SE SOLICITA EL PUNTO 2.4. CÁMARA HD.
12	PARTIDA: 4 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA. (PARA UROLOGÍA).	PUNTO: 1.3.	QUE SOPORTE UN PESO DE 220 KG O MAYOR	PREGUNTA: CON EL FIN DE AMPLIAR EL TIPO DE PACIENTE QUE PODRÁN UTILIZAR LA MESA INCLUYENDO PACIENTES CON OBESIDAD, SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE SE DEBA OFERTAR UN SOPORTE MÍNIMO DE PESO DEL PACIENTE DE 400 KG.  ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER CONDICIONANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
13	PARTIDA: 4 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA. (PARA UROLOGÍA).	PUNTO: 1.5.	LONGITUD TOTAL CON EXTENSIÓN DE CABECERA Y PIERNAS DE 210 CM + 20 CM.	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN OFERTAR UNA LONGITUD DE LA MESA CON EXTENSIÓN DE CABECERA Y PIERNAS DE 210 CM +/- 10 CM, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, LAS DIMENSIONES NO LIMITAN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.  ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA.
14	PARTIDA: 4 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA. (PARA UROLOGÍA).	PUNTOS: 1.9	SUPERFICIE RADIOTRANSARENTE AL MENOS EN LA REGIÓN PÉLVICA	PREGUNTA: SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA MESA DEBA CONTAR CON TODO EL TABLERO O SECCIONES DE LA MESA RADIOTRANSARENTES PARA PODER UTILIZARLA DE MANERA ADECUADA CON EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL O ARCO EN C.  ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA. SUPERFICIE RADIOTRANSARENTE EN TODAS LAS SECCIONES DE LA MESA.
15	PARTIDA: 4 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA. (PARA UROLOGÍA).	PUNTOS: 1.13.1 1.13.2	1.13.1 DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DEL TABLERO DE 30 CM O MAYOR (HACIA LA SECCIÓN DE LA CABECERA) O 1.13.2 CAMBIO DE LAS SECCIONES DEL TABLERO DE LA MESA QUE	PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ OFERTAR LO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.13.1 Ó 1.13.2, YA QUE AMBOS TIENEN EL MISMO PROPÓSITO.  ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO.

18



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BTLC ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-050GYR055-E395-2022

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, 2022, REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE "SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. ANTONIO FRACA MOURET" DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA CIUDAD DE MÉXICO DIRECCION DE LA U.M.A.E. DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO OFICINA DE ADQUISICIONES

Handwritten signature

Table with 6 columns: Item ID, Description, Points, Question, Answer, and Status. Contains items 16, 17, and 18 regarding medical table specifications.

19



Handwritten signature and initials



UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
DR. ANTONIO FRAGA MOURET
DEL CENTRO MEDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MEXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BTLC ELECTRONICA,
NUMERO LA-050GYR055-E395-2022

OBJETO DE LA CONTRATACION: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, 2022, REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE SUSTITUCION DE EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL

Handwritten signature in blue ink.

Table with 5 columns: Item Number, Description, Points, Catalogue, Question, and Answer. Contains items 19 through 23 regarding microscope specifications and technical requirements.

Handwritten mark in blue ink.

20

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.





ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BTLC ELECTRÓNICA, NÚMERO LA-050GYR055-E395-2022

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, 2022, REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE "SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. ANTONIO FRAGA MOURET" DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA CIUDAD DE MÉXICO DIRECCION DE LA U.M.A.E. DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO OFICINA DE ADQUISICIONES

Handwritten mark resembling a stylized 'P' or 'Q'.

Table with 6 columns: NO., PARTIDA/EQUIPO, PUNTO, DESCRIPCIÓN, SOLICITUD DE ACLARACIÓN, RESPUESTA. Row 24 details a request for 5-degree angulation for a microtome.

LICITANTE: BRAUN MEDICAL DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V..

FORMATO RELATIVO AL ENVÍO DE PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA "CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO

Main table with 6 columns: NO., PARTIDA/EQUIPO, PUNTO, DESCRIPCIÓN, SOLICITUD DE ACLARACIÓN, RESPUESTA. Contains 6 rows of clarification requests and responses regarding craneotome accessories.





**ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BTLC ELECTRÓNICA,  
NÚMERO LA-050GYR055-E395-2022**

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO  
MÉDICO, 2022, REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE  
"SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL**

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA  
CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCION DE LA U.M.A.E.  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
OFICINA DE ADQUISICIONES

NO.	PARTIDA/EQUIPO	NUMERAL ESPECÍFICO DE LA CÉDULA		SOLICITUD DE ACLARACIÓN	RESPUESTA
		PUNTO	DESCRIPCIÓN		
		TREPANACIÓN), ESTERILIZABLE CON CUATRO PIEZAS DE: PUNTO 2.4.1.3.			
7	PARTIDA 3 - CRANEOTOMO ELECTRICO.	PUNTO 2 ACCESORIOS: 2.4.1 BROCA INICIADORA REUTILIZABLE (PARA TREPANACIÓN), ESTERILIZABLE CON CUATRO PIEZAS DE: PUNTO 2.4.1.4	DIÁMETRO DE 6 MM.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TRÉPANO CRANEAL DIÁMETRO DE 6MM/9MM REUTILIZABLE ¿SE ACEPTA?	CONSULTAR ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.
8	PARTIDA 3 - CRANEOTOMO ELECTRICO.	CEDULA DE DESCRIPCION = PUNTO 3 CONSUMIBLES: PUNTO 3.8	FRESA ESPIRAL DE 2 MM DE DIÁMETRO. (10 PIEZAS).	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BROCA ESPIRAL DE DIAMETRO 1,5 MM ¿SE ACEPTA?	CONSULTAR ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.
9	PARTIDA 3 - CRANEOTOMO ELECTRICO.	PUNTO 3 CONSUMIBLES: PUNTO 3.9	FRESA ESPIRAL DE 3 MM DE DIÁMETRO. (10 PIEZAS).	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BROCA ESPIRAL DE DIAMETRO 2.0 MM ¿SE ACEPTA?	CONSULTAR ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.
10	PARTIDA 3 - CRANEOTOMO ELECTRICO.		CEDULA DE DESCRIPCION	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LOS CONSUMIBLES QUE SON REQUERIDOS PARA MANTENER LA LUBRICACIÓN DE LOS EQUIPOS, QUE PERMITAN GARANTIZAR LA VIDA ÚTIL ASÍ COMO SISTEMA DE EMBALAJE RÍGIDO QUE PERMITA ALMACENAR, TRANSPORTAR, PROTEGER Y ESTERILIZAR EL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	CONSULTAR ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.

**LICITANTE: MANPREC, S.A. DE C.V.**

N°	NUMERAL ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	SOLICITUD DE ACLARACIÓN	
1	63_ANEXO NO. 2_F) VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES. DONDE SE SUMINISTRARÁN O COLOCARÁN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS, EN SU CASO.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REALIZAR LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS HASTA UN DIA HÁBIL ANTES DE LA APERTURA DE LA PROPUESTA, CON LA FINALIDAD DE QUE SE PUEDA REALIZAR UN LEVANTAMIENTO FÍSICO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ESPECÍFICOS Y ECONÓMICOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
2	63_ANEXO NO. 2_F) VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES. DONDE SE SUMINISTRARÁN O COLOCARÁN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS, EN SU CASO.	EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE LA VISITA PARA LA PARTIDA 1 SEA OPCIONAL Y NO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.





**ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BTLC ELECTRÓNICA,  
NÚMERO LA-050GYR055-E395-2022**

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO  
MÉDICO, 2022, REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE  
"SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL**

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
"DR. ANTONIO FRAGA MOURET"  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL, LA RAZA  
CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCION DE LA U.M.A.E.  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
OFICINA DE ADQUISICIONES

*[Handwritten signature]*

N°	NUMERAL ESPECÍFICO DE LA CONVOCATORIA	SOLICITUD DE ACLARACIÓN	
3	58_ANEXO NO. 2_B) PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA NATURAL SIGUIENTE AL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.

*[Handwritten signature]*

**LICITANTE: MEDTRONIC, S. DE R. L. DE C.V.**

N°	PARTIDA EQUIPO	NUMERAL ESPECÍFICO DE LA CÉDULA		SOLICITUD DE ACLARACIÓN	RESPUESTAS
		PUNTO	DESCRIPCIÓN		
1.	3		2.3.1	CON RELACIÓN A LA PARTIDA 2.3.1 "ADAPTADOR PARA FRESADO RECTO DE 115 MM. DE LONGITUD Y FOMENTANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN ADAPTADOR PARA FRESADO RECTO DE 100 MM. DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER CONDICIONATE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
2.	3		2.3.2	CON RELACIÓN A LA PARTIDA 2.3.2 "ADAPTADOR PARA FRESADO RECTO DE 135 MM. DE LONGITUD Y FOMENTANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN ADAPTADOR PARA FRESADO RECTO DE 140 MM. DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER CONDICIONATE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
3.	3		2.3.2	CON RELACIÓN A LA PARTIDA 2.3.2 "ADAPTADOR PARA FRESADO ANGULADO DE 135 MM. DE LONGITUD Y FOMENTANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN ADAPTADOR PARA FRESADO RECTO DE 100 MM. DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER CONDICIONATE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
4.	3		2.3.4	CON RELACIÓN A LA PARTIDA 2.3.4 "ADAPTADOR PARA FRESADO ANGULADO DE 145 MM. DE LONGITUD Y FOMENTANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN ADAPTADOR PARA FRESADO RECTO DE 140 MM. DE LONGITUD. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER CONDICIONATE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
5.	3		2.4.2, 2.4.3 Y 2.4.4	CON RELACIÓN A LOS PUNTOS 2.4.2 "MICOSIERRA OSCILANTE, CON ADAPTADOR", 2.4.3 "MICOSIERRA SAGITAL CON ADAPTADOR", 2.4.4 "MICOSIERRA RECIPROCANTE, CON ADAPTADOR" Y ENTENDIENDO QUE EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA USA DICHAS PARTIDAS CON UNA MÍNIMA FRECUENCIA, ADEMÁS DE ENCARECER EL EQUIPO; SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE MANERA RESPETUOSA PRESCINDIR DE DICHAS PARTIDAS. ¿SE ACEPTA?	CONSULTAR ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.
6.	3		2.4	CON RELACIÓN A LA PARTIDA 2.4 "CABLE DE CORRIENTE DE 3 MTS DE LONGITUD O MAYOR" Y FOMENTANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN CABLE DE CORRIENTE DE AL MENOS 1.5 MTS SIN QUE ESTO AFECTE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA.

*[Handwritten signature]*





UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
DR. ANTONIO FRAGA MOURET
DEL CENTRO MEDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MEXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BTLC ELECTRONICA,
NUMERO LA-050GYR055-E395-2022

OBJETO DE LA CONTRATACION: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, 2022, REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE SUSTITUCION DE EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL

Table with 5 columns: Item number (7), Quantity (3), Unit (2.2.1), Description (CON RELACION A LA PARTIDA 3, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE QUE TODOS LOS CONSUMIBLES SE DEBERAN ENTREGAR NUEVOS Y EN EMPAQUE ORIGINAL PARA GARANTIZAR QUE LOS CONSUMIBLES SEAN USADOS UNA SOLA VEZ...), and Remarks (CONSULTAR ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE).

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, (LAASSP) ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA.

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACION Y EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 37 BIS DE LA LAASSP, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICION DE LOS LICITANTES EN EL PORTAL DE COMPRANET EN LA DIRECCION ELECTRONICA: www.compranet.hacienda.gob.mx

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 46 FRACCION II, SEGUNDO PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, EL PLAZO PARA RECIBIR PREGUNTAS EN RELACION A LAS RESPUESTAS REMITIDAS SERA EL DIA OCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, A LAS CATORCE HORAS, EN CASO DE NO EXISTIR ALGUNA OTRA PREGUNTA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO ANTES MENCIONADO; ESTA ACTA SE CIERRA CON LAS PRECISIONES ESTABLECIDAS, SIN LA NECESIDAD DE REALIZAR OTRO ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES.

FINALMENTE, SE MENCIONA QUE EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARA A CABO EL DIA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE AÑO DOS MIL VEINTIDOS, A LAS DOCE HORAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 26 BIS, FRACCION II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO DE INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO COMPRANET, SIENDO UN ACTO FORMAL QUE DARÁ INICIO PUNTUALMENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

SE DIO POR TERMINADA ESTA JUNTA, SIENDO LAS DIEZ HORAS, DEL DIA SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.

ESTA ACTA CONSTA DE 026 (VEINTISEIS) HOJAS, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.





UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
DR. ANTONIO FRAGA MOURET
DEL CENTRO MEDICO NACIONAL, LA RAZA
CIUDAD DE MEXICO
DIRECCION DE LA U.M.A.E.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BTLC ELECTRONICA,
NUMERO LA-050GYR055-E395-2022

OBJETO DE LA CONTRATACION: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, 2022, REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE SUSTITUCION DE EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

Table with 3 columns: NOMBRE, AREA, FIRMA. Rows include L.C. GABRIEL HIDALGO JIMENEZ, LIC. VICTOR ALAÑA CASTRO, DR. MARIO HERNANDEZ SANCHEZ, ING. JORGE RODRIGUEZ CHAVEZ, LIC. AUGUSTO ELIAS PERALTA ALVAREZ.

POR EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL.

Table with 2 columns: NOMBRE, FIRMA. Row includes L.C. RAQUEL CABRERA CARRILLO.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA BTLC NUMERO LA-050GYR055-E395-2022, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, 2022, REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE SUSTITUCION DE EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL...



