



# Biotecnología

## y Comercializadora en Equipo Médico, S.A. de C.V.

### ORDEN DE SERVICIO

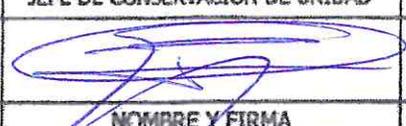
CONTRATO No. \_\_\_\_\_

DATOS GENERALES		ORDEN DE SERVICIO	
HGSZ+MF No. 26	EQUIPO: VENTILADOR VOLUMÉTRICO	No. 14149	PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>
LOCALIDAD: CABO SAN LUCAS	MARCA: AEOMED		CORRECTIVO <input type="checkbox"/>
DIRECCIÓN: CARRETERA ESTATAL 19 CABO SAN LUCAS	MODELO: VG70		
TODOS LOS SANTOS KM 2.5 S/N COL. BRISAS DEL PACIFICO, LOS CABOS.	SERIE: (U)XZZS30338	FECHA: 08-MARZO-2024	

DATOS DEL SERVICIO	
No. DE REPORTE: _____	FECHA DE REPORTE: _____
FECHA DE INICIO: 08 MARZO 2024	FECHA DE TERMINO: 08 MARZO 2024
DESCRIPCIÓN BREVE DEL SERVICIO:	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRIMERA VISITA	

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO (ESPECÍFICO)
PRUEBAS DE OPERACIÓN, DESTAPE DE PARTES ELECTRÓNICAS, ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS. LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO SECO ESPECIAL, PARA PARTES ELECTRÓNICAS. AJUSTE, LUBRICACIÓN Y CALIBRACIÓN, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, FUENTE DE PODER, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO (TRNSDUCTORES, FUGAS, FLUJO, FIOI, ETC.) REVISIÓN DE BATERÍAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, REVISIÓN DE RED, ALARMAS, TARJETA DE DATOS, CONFIGURACIÓN DE MONITOR, TENDENCIAS GRÁFICAS Y DE REGISTROS DE PRESIÓN. VERIFICACIÓN DE LA PRESIÓN DE ENTRADA DE OXÍGENO ENTRE 40 Y 80 PSI, FILTROS DE NYLON Y VÁLVULAS CHECK DE ENTRADA DE GAS, FILTRO DE ENTRADA DE GAS AMBIENTAL, FILTRO DE VENTILACIÓN DE FAN, FILTROS INTERNOS, REGULADOR INTERNO DE ENTRADA DE GAS, BATERÍA DE RESPALDO, TURBINA, CONTROLES MANUALES DE SOLENOIDES DE BLENDER

REFACCIONES UTILIZADAS		
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	PZA	x

RECIBÍ DE CONFORMIDAD (RESPONSABLE DEL ÁREA DE SERVICIO)	JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD	TÉCNICO RESPONSABLE ENCARGADO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
 99032243		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

PAFNUNCIO PADILLA 26, DESPACHO 307 PISO 3, CIUDAD SATÉLITE, C.P. 53100 NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO

Teléfono: (55) 10569090    WhatsApp 5536770380    e-Mail: bicem2010@hotmail.com    www.bicem.com.mx



# Biotecnología

## y Comercializadora en Equipo Médico, S.A. de C.V.

### ORDEN DE SERVICIO

CONTRATO No. \_\_\_\_\_

DATOS GENERALES		ORDEN DE SERVICIO	
HGSZ+MF No. 26	EQUIPO: VENTILADOR VOLUMÉTRICO	No. 14146	PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>
LOCALIDAD: CABO SAN LUCAS	MARCA: AEOMED		CORRECTIVO <input type="checkbox"/>
DIRECCIÓN: CARRETERA ESTATAL 19 CABO SAN LUCAS	MODELO: VG70		
TODOS LOS SANTOS KM 2.5 S/N COL. BRISAS DEL PACIFICO, LOS CABUS.	SERIE: (U)XZZS30322	FECHA: 05-MARZO-2024	

DATOS DEL SERVICIO	
No. DE REPORTE:	FECHA DE REPORTE:
FECHA DE INICIO: 05 MARZO 2024	FECHA DE TERMINO: 05 MARZO 2024
DESCRIPCIÓN BREVE DEL SERVICIO:	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRIMERA VISITA	

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO (ESPECÍFICO)
PRUEBAS DE OPERACION, DESTAPE DE PARTES ELECTRONICAS, ELECTRICAS Y MECANICAS. LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO SECO ESPECIAL, PARA PARTES ELECTRONICAS. AJUSTE, LUBRICACION Y CALIBRACION, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, FUENTE DE PODER, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO (TRNSDUCTORES, FUGAS, FLUJO, FIOI, ETC.) REVISION DE BATERIAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, REVISION DE RED, ALARMAS, TARJETA DE DATOS, CONFIGURACION DE MONITOR, TENDENCIAS GRAFICAS Y DE REGISTROS DE PRESION. VERIFICACION DE LA PRESION DE ENTRADA DE OXIGENO ENTRE 40 Y 80 PSI, FILTROS DE NYLON Y VALVULAS CHECK DE ENTRADA DE GAS, FILTRO DE ENTRADA DE GAS AMBIENTAL, FILTRO DE VENTILACION DE FAN, FILTROS INTERNOS, REGULADOR INTERNO DE ENTRADA DE GAS, BATERIA DE RESPALDO, TURBINA, CONTROLES MANUALES DE SOLENOIDES DE BLENDER

REFACCIONES UTILIZADAS		
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	PZA	x

RECIBI DE CONFORMIDAD (RESPONSABLE DEL AREA DE SERVICIO)	JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD	TÉCNICO RESPONSABLE ENCARGADO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

PAFNUNCIO PADILLA 26, DESPACHO 307 PISO 3, CIUDAD SATÉLITE, C.P. 53100 NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO

Teléfono: (55) 10569090    WhatsApp 5536770380    e-Mail: bicem2010@hotmail.com    www.bicem.com.mx



# Bioteconología

## y Comercializadora en Equipo Médico, S.A. de C.V.

### ORDEN DE SERVICIO

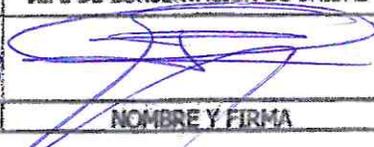
CONTRATO No. \_\_\_\_\_

DATOS GENERALES		ORDEN DE SERVICIO	
HGSZ+MF No. 26	EQUIPO: VENTILADOR VOLUMÉTRICO	No. 14148	PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/>
LOCALIDAD: CABO SAN LUCAS	MARCA: AEOMED		CORRECTIVO <input type="checkbox"/>
DIRECCIÓN: CARRETERA ESTATAL 19 CABO SAN LUCAS	MODELO: VG70		
TODOS LOS SANTOS KM 2.5 S/N COL. BRISAS DEL PACIFICO, LOS CABOS.	SERIE: (U)XZS33379	FECHA: 08-MARZO-2024	

DATOS DEL SERVICIO	
No. DE REPORTE:	FECHA DE REPORTE:
FECHA DE INICIO: 08 MARZO 2024	FECHA DE TERMINO: 08 MARZO 2024
DESCRIPCIÓN BREVE DEL SERVICIO:	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRIMERA VISITA	

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO (ESPECÍFICO)
PRUEBAS DE OPERACION, DESTAPE DE PARTES ELECTRONICAS, ELECTRICAS Y MECANICAS. LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO SECO ESPECIAL, PARA PARTES ELECTRONICAS. AJUSTE, LUBRICACION Y CALIBRACION, LIMPIEZA DE TARIJETAS ELECTRONICAS, FUENTE DE PODER, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO (TRNSDUCTORES, FUGAS, FLUJO, FIOI, ETC.) REVISION DE BATERIAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, REVISION DE RED, ALARMAS, TARIETA DE DATOS, CONFIGURACION DE MONITOR, TENDENCIAS GRAFICAS Y DE REGISTROS DE PRESION. VERIFICACION DE LA PRESION DE ENTRADA DE OXIGENO ENTRE 40 Y 80 PSI, FILTROS DE NYLON Y VALVULAS CHECK DE ENTRADA DE GAS, FILTRO DE ENTRADA DE GAS AMBIENTAL, FILTRO DE VENTILACION DE FAN, FILTROS INTERNOS, REGULADOR INTERNO DE ENTRADA DE GAS, BATERIA DE RESPALDO, TURBINA, CONTROLES MANUALES DE SOLENOIDES DE BLENDER

REFACCIONES UTILIZADAS		
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	PZA	X

RECIBÍ DE CONFORMIDAD (RESPONSABLE DEL AREA DE SERVICIO)	JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD	TÉCNICO RESPONSABLE ENCARGADO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
 99032243		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

PAFNUNCIO PADILLA 26, DESPACHO 307 PISO 3, CIUDAD SATÉLITE, C.P. 53100 NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO

Teléfono: (55) 10569090    WhatsApp 5536770380    e-Mail: bicem2010@hotmail.com    www.bicem.com.mx